


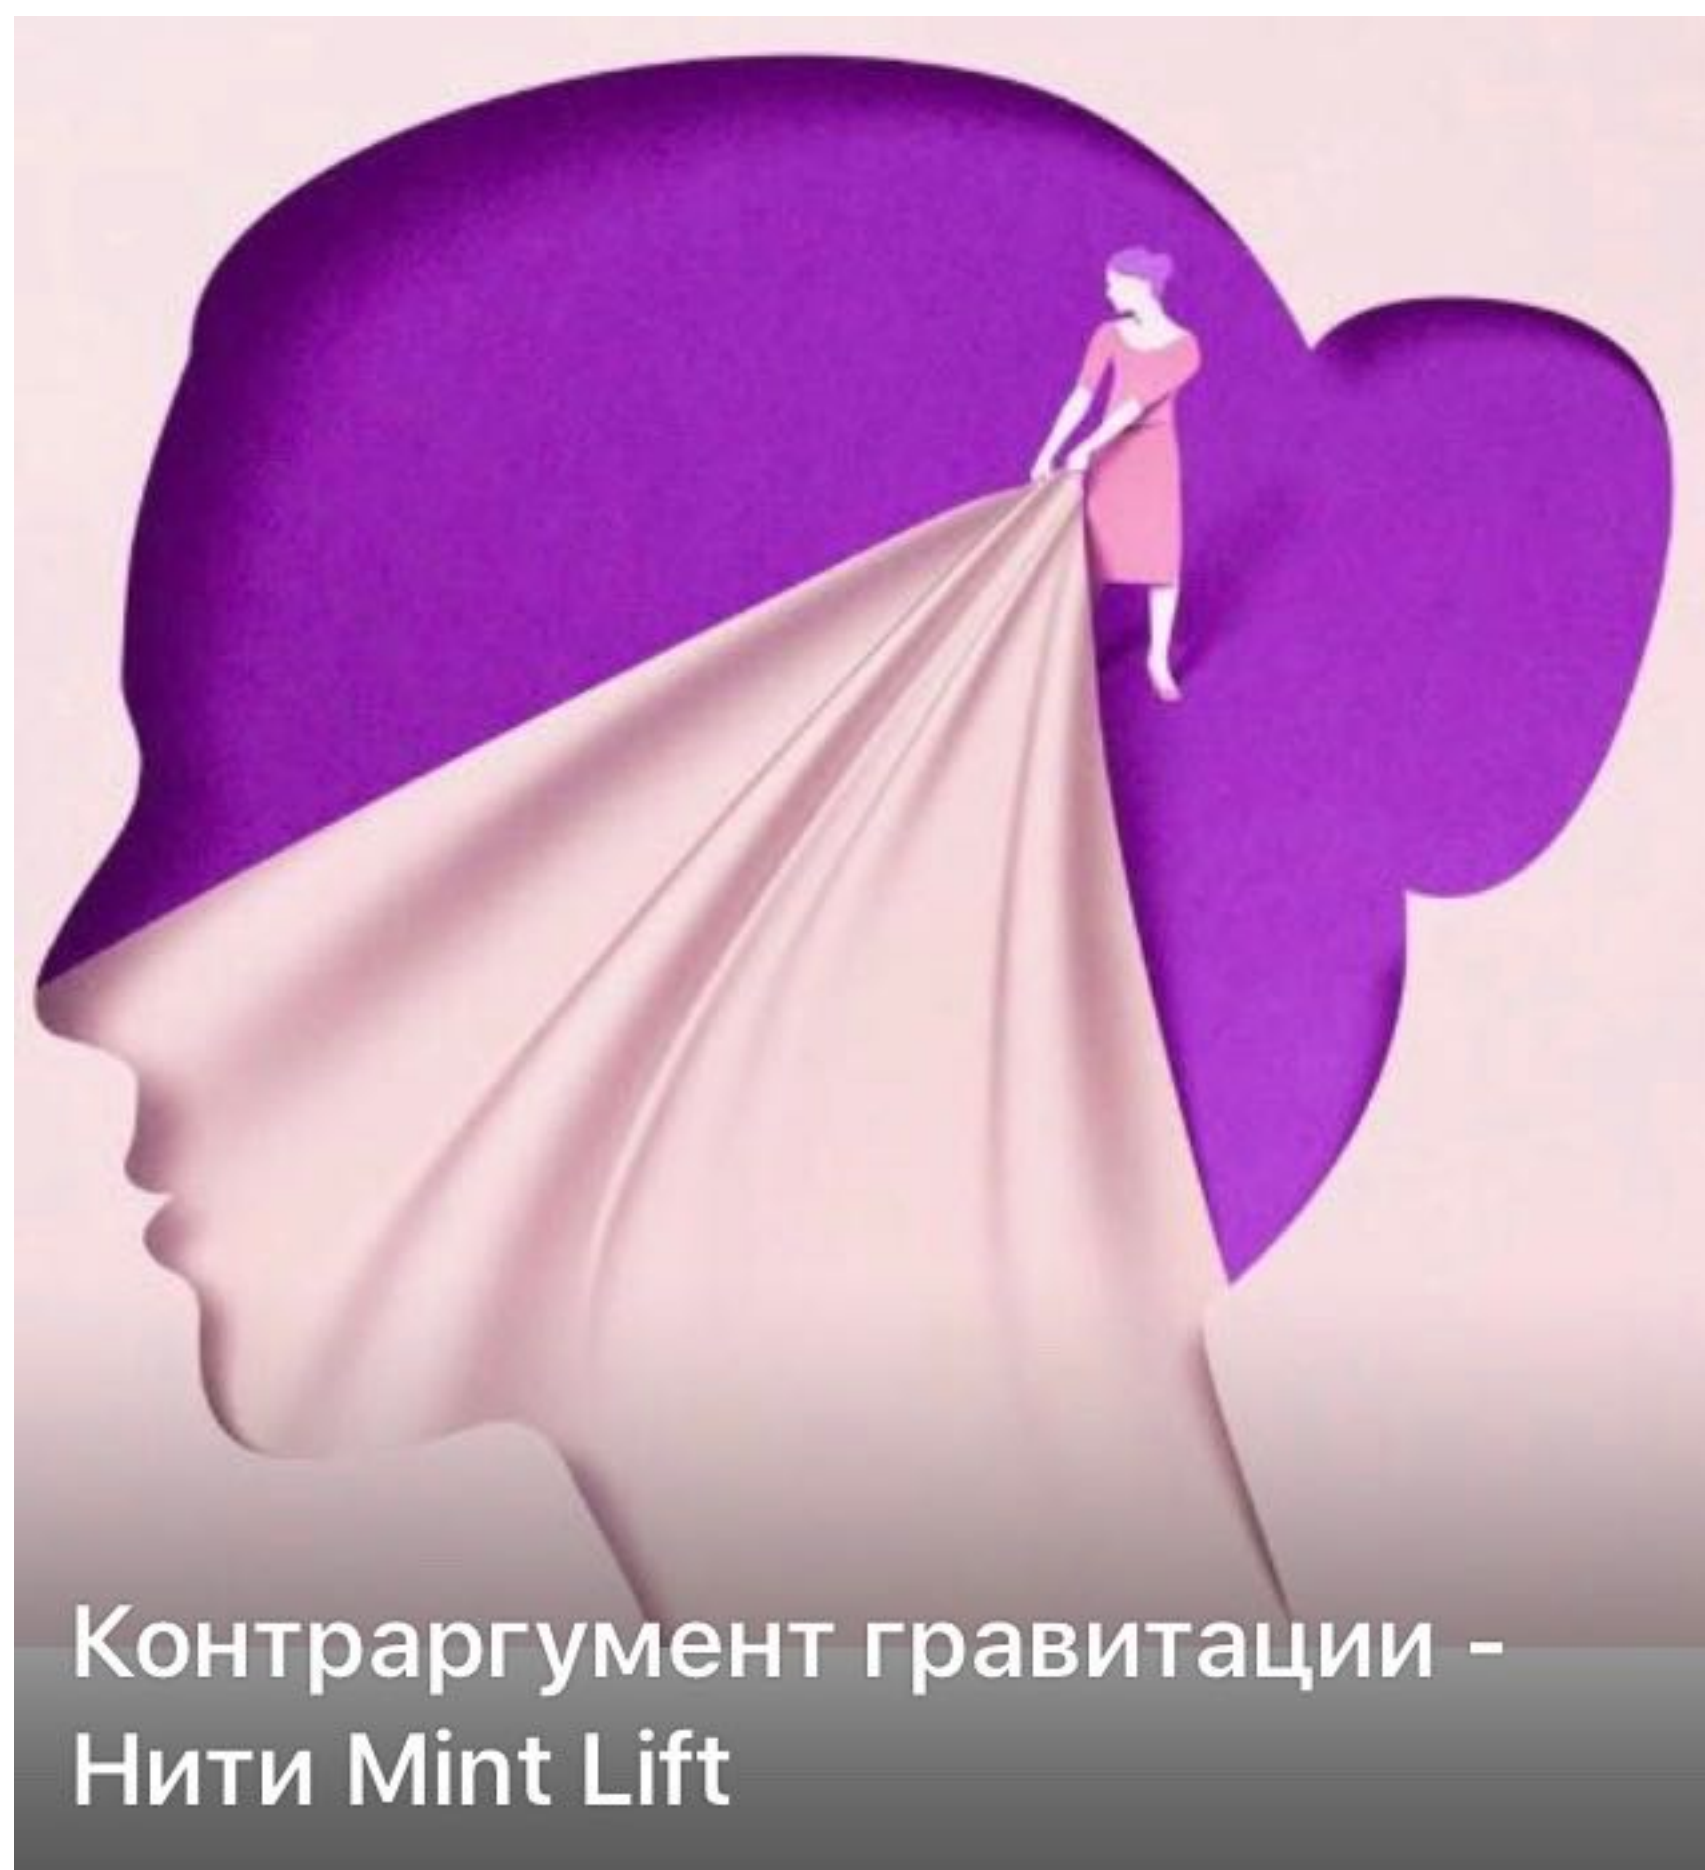

Секреты успешного тредлифтинга

Minimally Invasive Non-surgical Thread

MINT *Lift*®

Канжа Екатерина Анатольевна. Medical director Beauty Solutions.

ТРЕДЛИФТИНГ СЕГОДНЯ



MINT Lift
Minimally Invasive Non-Surgical Thread



КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ИНВАЛЮТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛИЦА

- Гравитационный птоз
- Статические и динамические морщины
- Нарушение рельефа
- Микроциркуляторные нарушения
- Гипо и гипер пигментации



Изменение
формы груди и
ягодиц

Утрата тонуса
отдельных мышц
и мышечных
групп

Гравитационный
птоз

БРОВИ

ЩЕКИ

КОНТУР
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

ШЕЯ

Лечение боли и спазмов

Дряблость и
сниженный тургор
кожи

Все виды
морщин

Неровный
рельеф кожи
лица и тела

Хирургия или тредлифтинг





КЛАССИФИКАЦИЯ НИТЕЙ



Классификация нитей по эстетическому эффекту



АРМИРУЮЩИЕ НИТИ

БИОСТИМУЛИРУЮЩИЕ НИТИ

ЛИФТИНГОВЫЕ НИТИ

ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ НИТИ

КЛАССИФИКАЦИЯ НИТЕЙ ПО ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ЭФФЕКТУ

Биостимулирующий

Биоревитализирующий эффект

Армирующий

Коллагеностимуляция

Объёмоформирующий


**Изменение форм и
объёмов мягких тканей**

Лифтинговый

**Перемещение и фиксация
мягких тканей**

Виды армирующих нитей

- Линейные
- Спиральные
- Твинскрю
- Косички
- Игольчатые

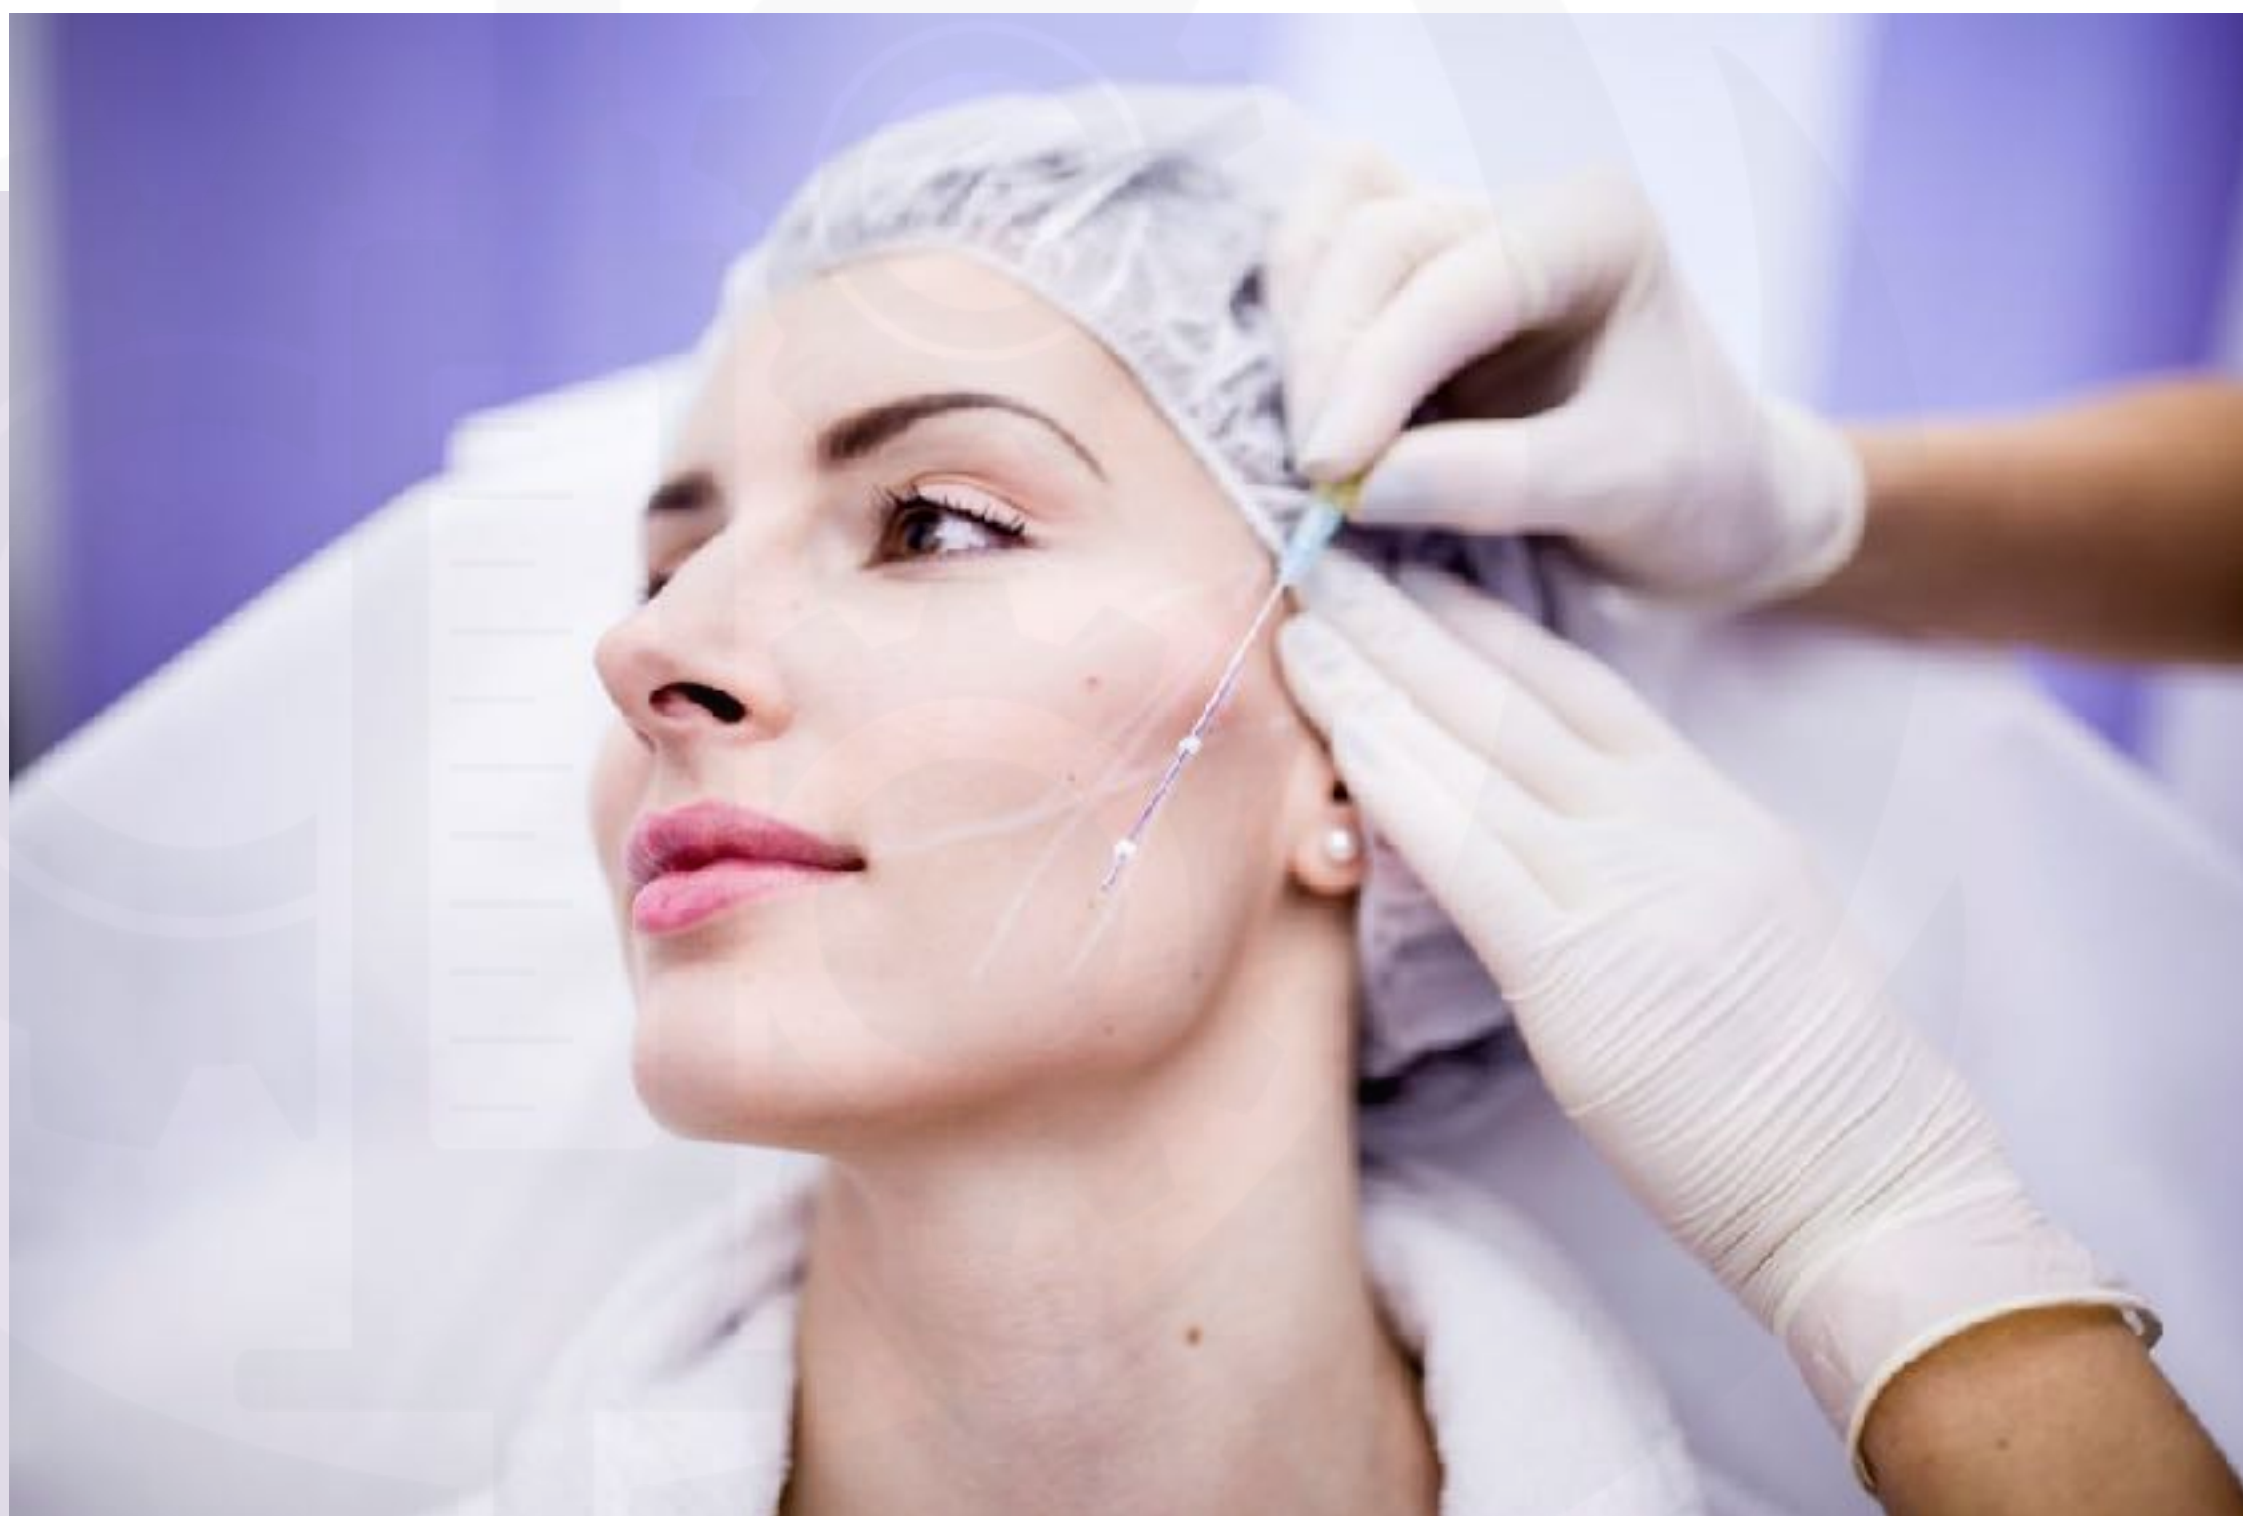

Виды армирующих нитей

Mono –
гладкая нить,
стимулирует
выработку
коллагена




Длина нити (mm)

Thread Length (mm)



Monoscrew –
гладкая нить,
которая намотана
на спираль,
что стимулирует
окружающие
мягкие ткани
эффективно
регенерировать
коллаген для
придания
объема
в коже

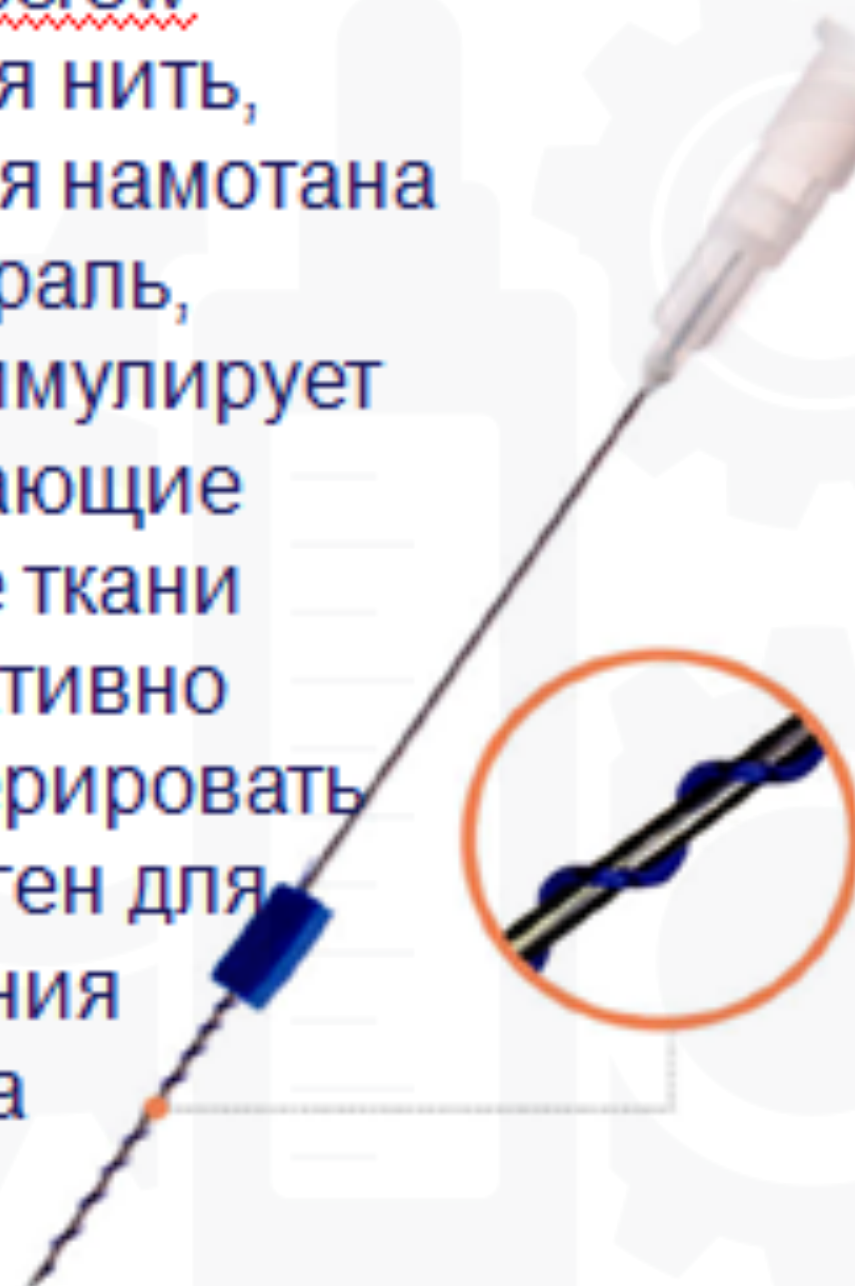

Длина нити (mm)


Thread Length (mm)




Диаметр иглы (G)	Длина иглы (мм)	Длина нити (мм)	Диаметр Нити (USP)
27 G	36 mm	50 mm	5-0
	60 mm	90 mm	

Виды армирующих нитей

Twın состоит из 2-х нитей Mint Mono, которые скручены вместе, что значительно увеличивает синтез коллагена, создавая больший объём, омолаживая кожу

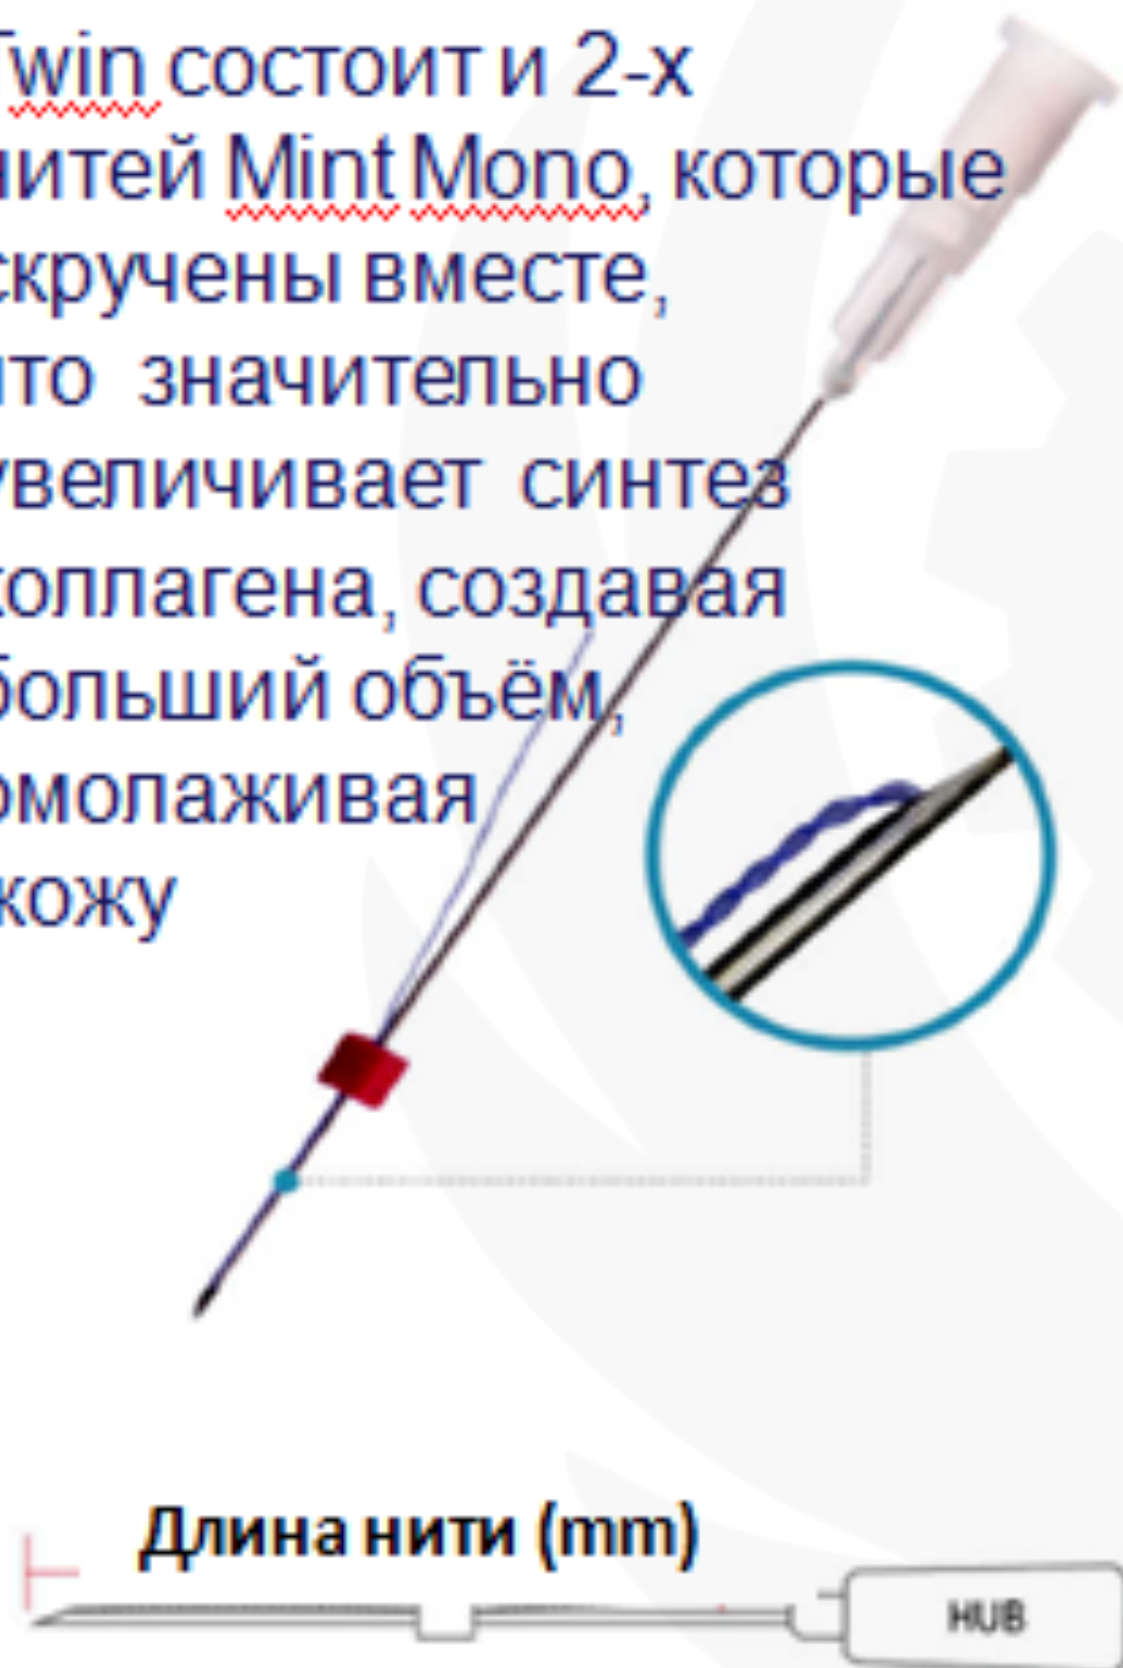


Twinscrew состоит из 2-х переплетённых Mint Monoscrew, которые уже являются спиралями

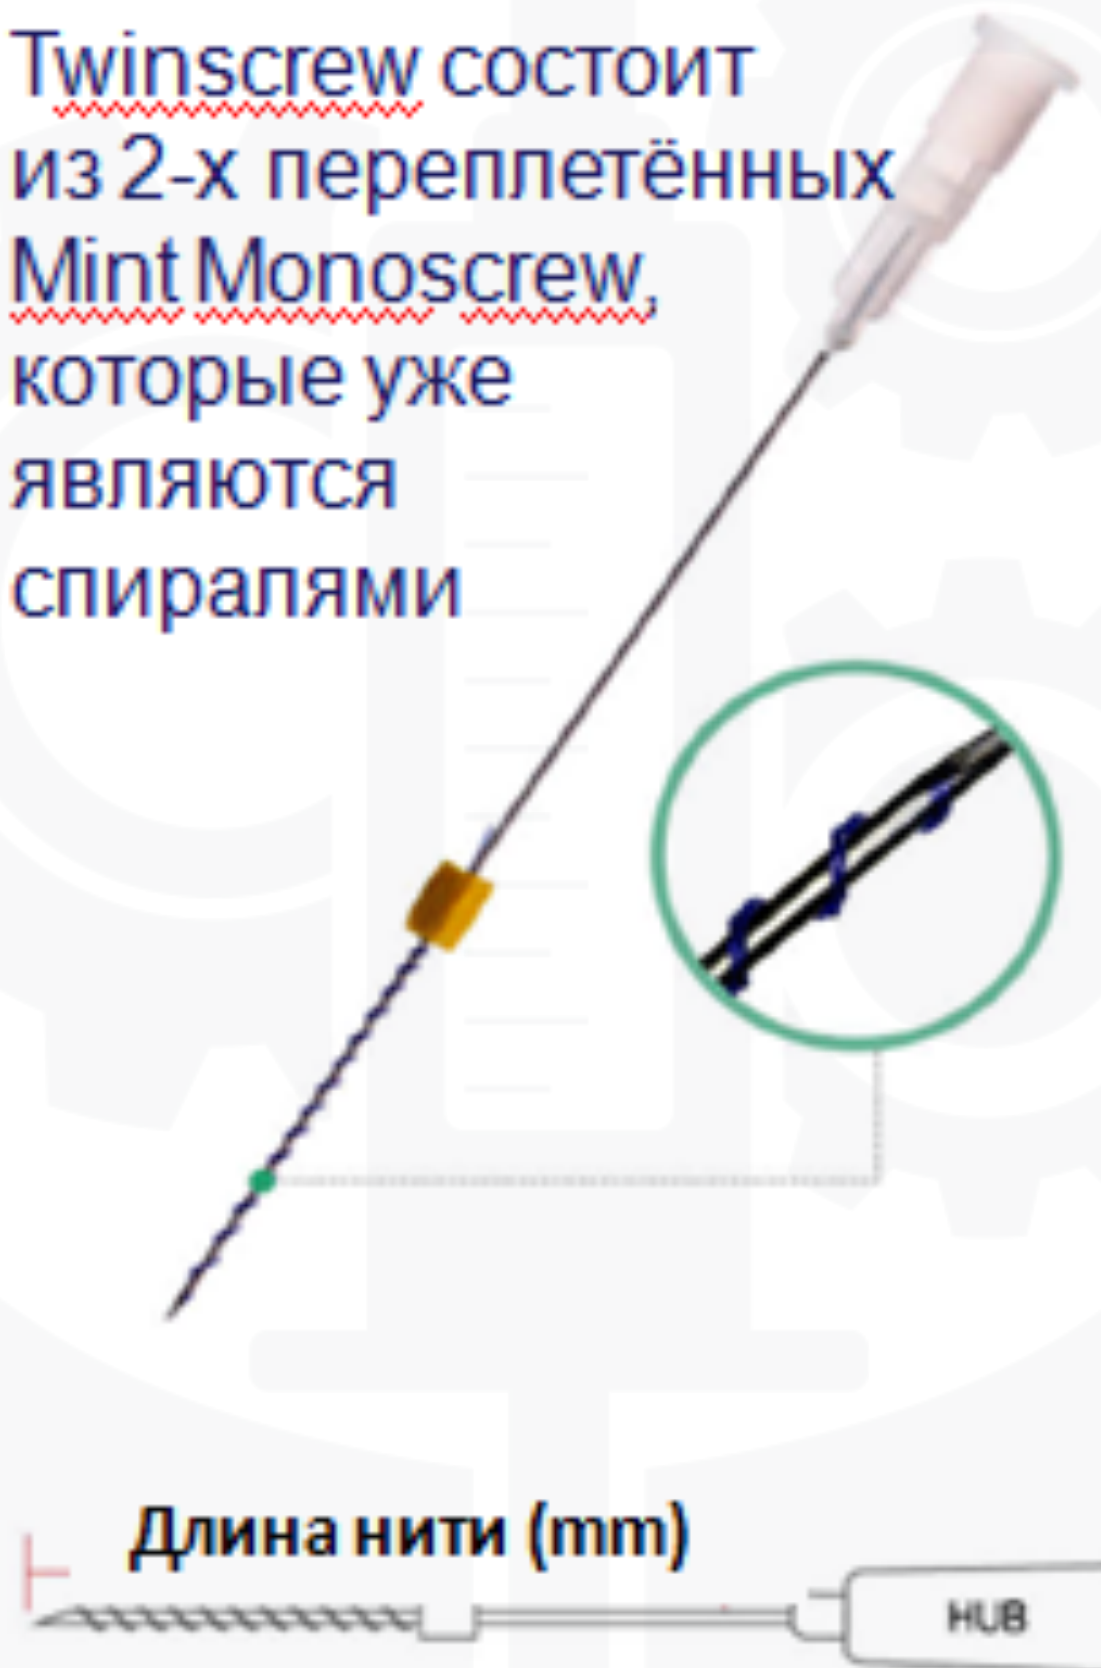

Диаметр иглы (G)	Длина иглы (мм)	Длина нити (мм)	Диаметр Нити (USP)
27 G	36 mm	50 mm	7-0 x 2
	60 mm	90 mm	

КЛАССИФИКАЦИЯ НИТЕЙ ПО МОДИФИКАЦИИ

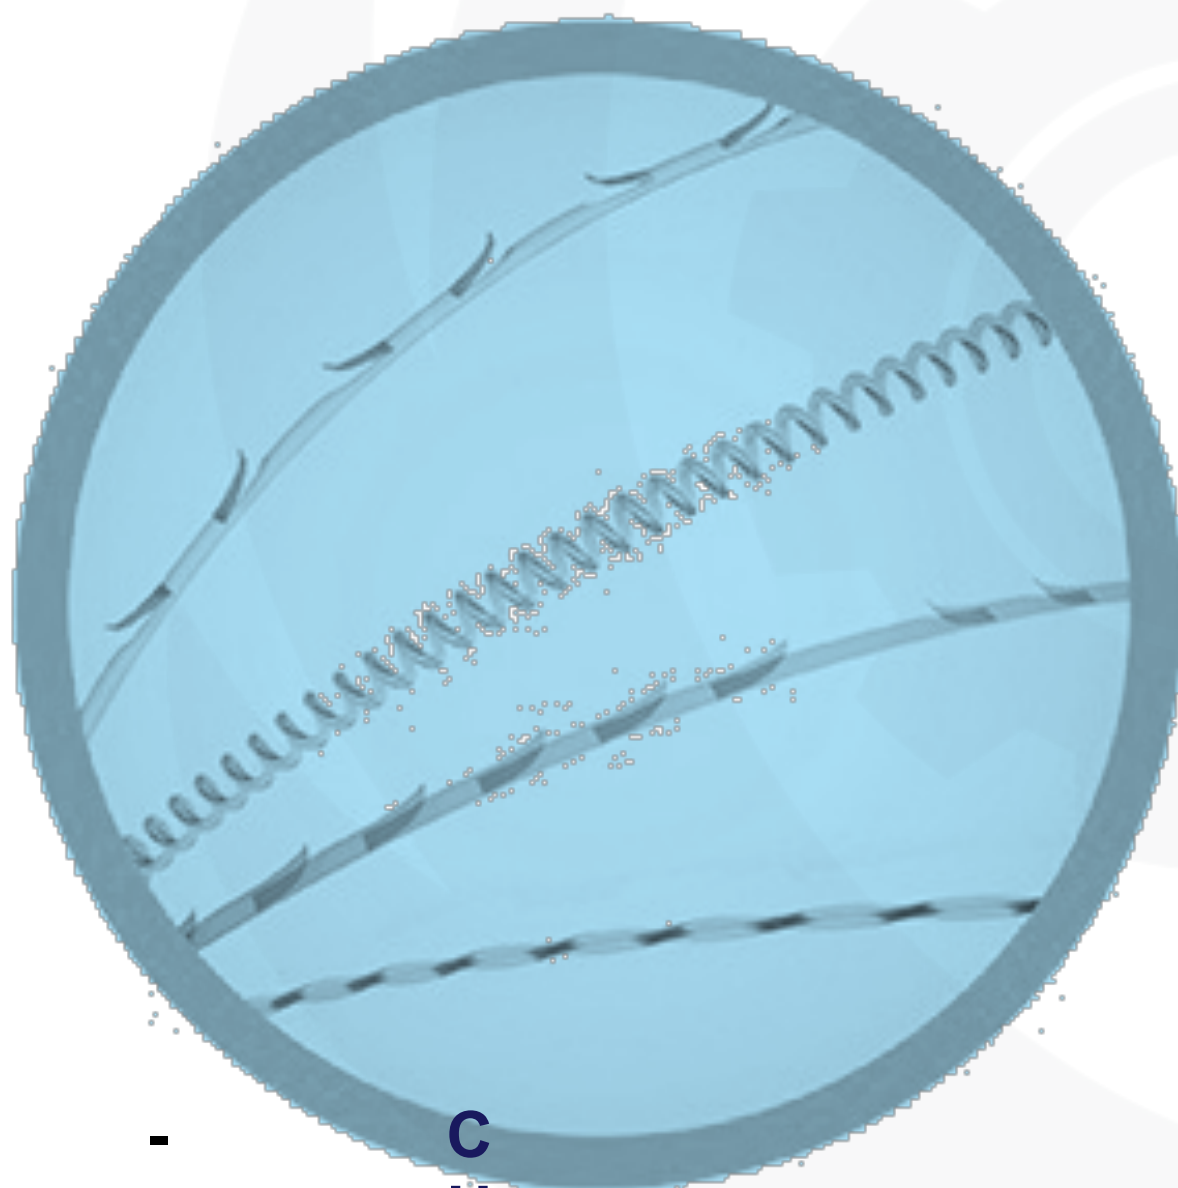

С
Н
Т
-



КЛАССИФИКАЦИЯ НИТЕЙ


Модификация «С»

➤ Mint Lift 43

➤ Mint Easy Sharp

➤ Mint Easy Blunt

- Aptos Thread 2 G;
- Aptos Light Lift Thread 2G;
- Spring Thread;
- Happy Lift Double Needle;
- Silhouette Soft;
- Silhouette Lift;
- Happy Lift Ancorage (одна из двух игл изогнутая)

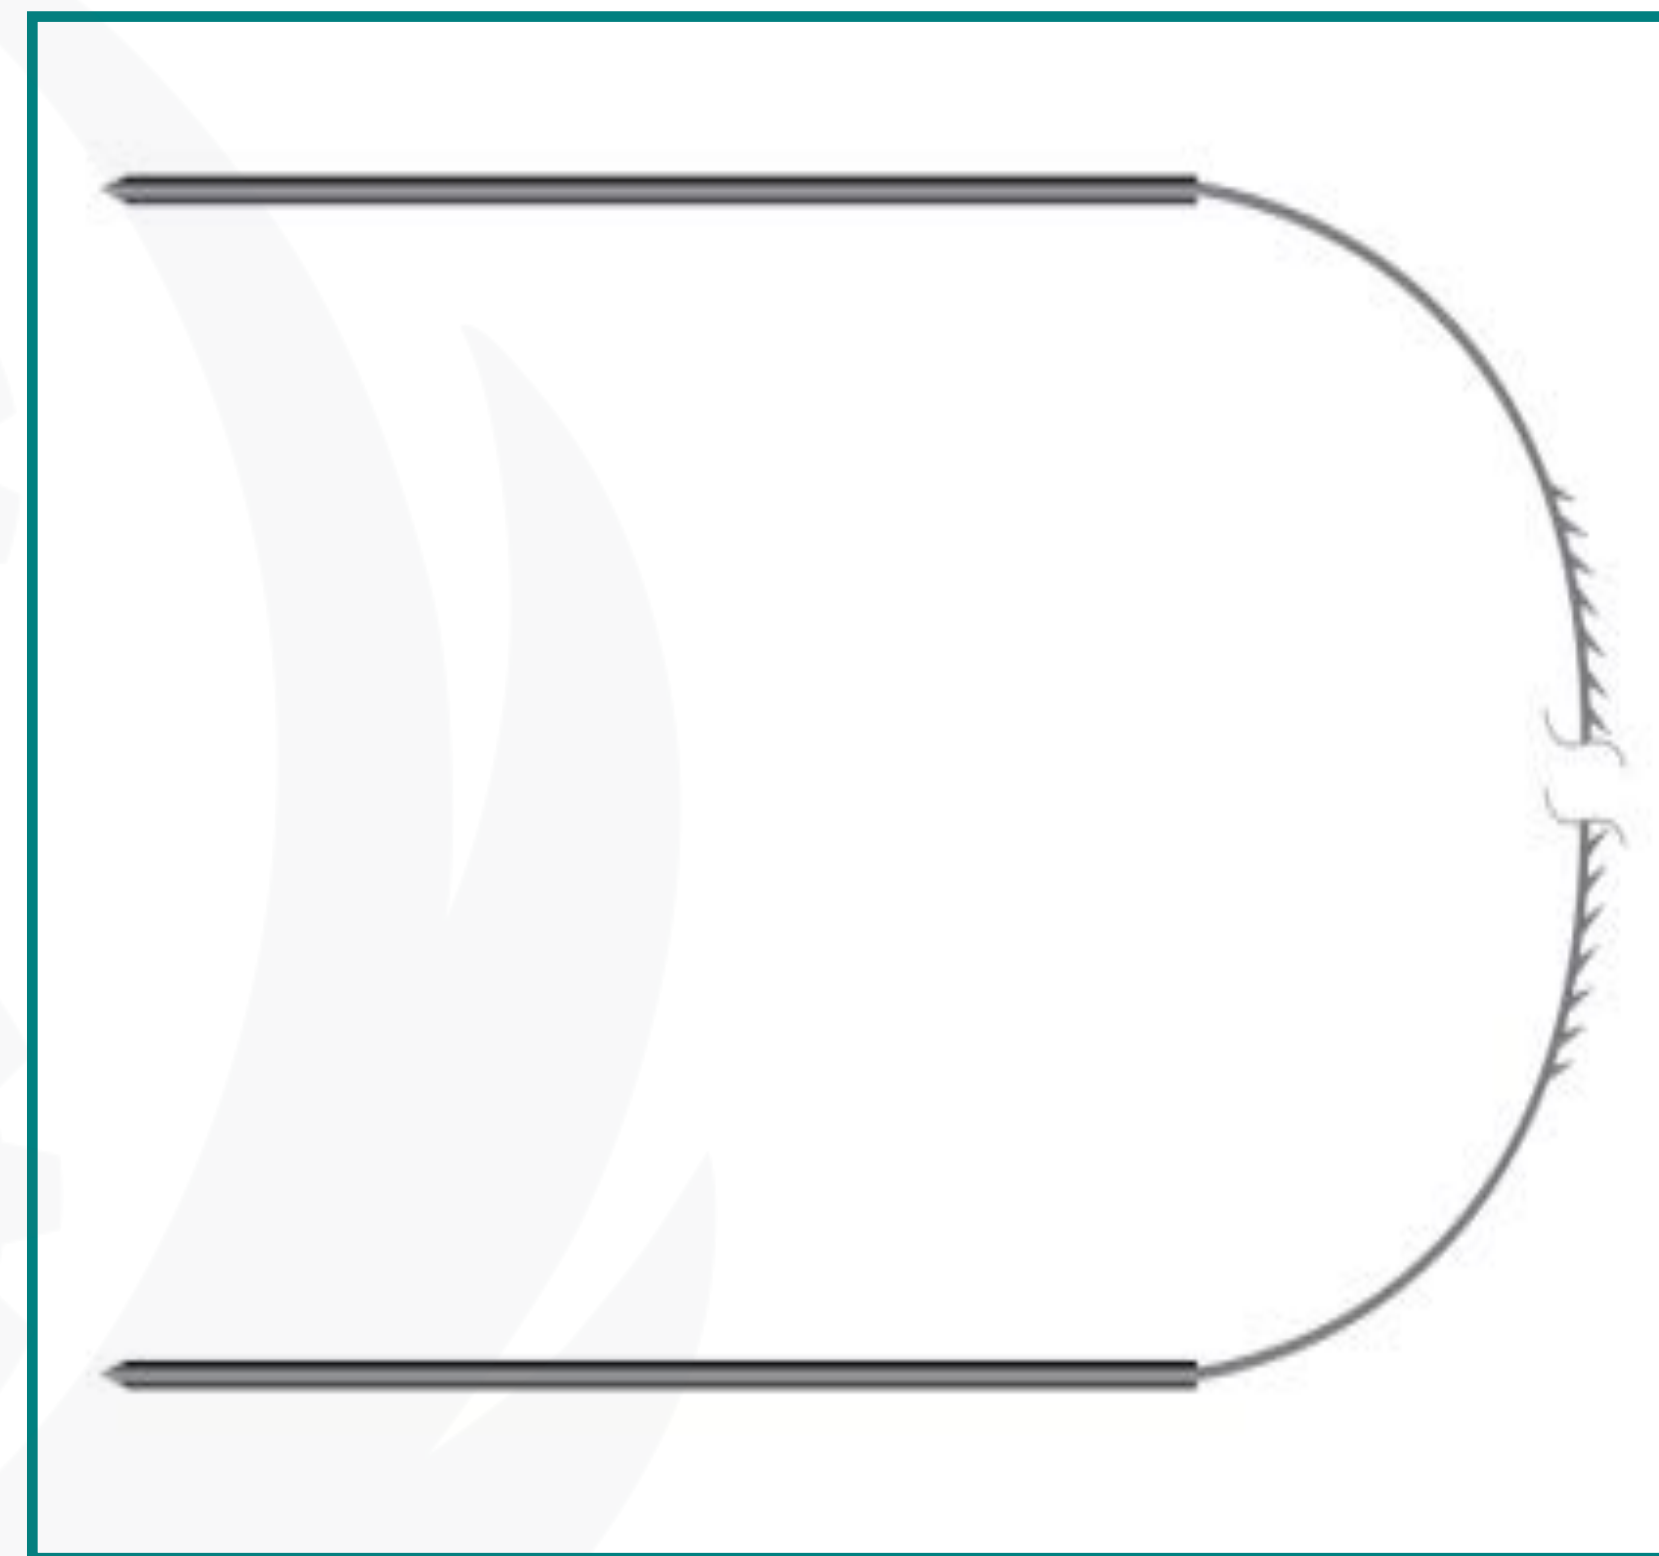

КЛАССИФИКАЦИЯ НИТЕЙ

Модификация «i»

Mint mini Mint Fine

- Aptos Excellence (Elegance, Visage, Body, Contour);
- Happy Lift (Boca, Free floating);
- Resorblift;
- Omega V;
- Beauty Lift V Line (ROSE, ROSE 2D, ROSE 3D, COG 2D)



Выбор пациента и прогнозирование результата




ПРАВИЛА УСТАНОВКИ НИТЕЙ

1. Правило «направления насечек»
2. Правило «глубины»
3. Правило «фиксаций»
4. Правило «минимального шага»
5. Правила «выхода иглы из тканей»:
Строго вертикальный выход
Только в неподвижной зоне
На 1 см «до» или на 1 см «после» морщины или складки
6. Правило «периферийного натяжения»
7. Правило «перетягивания каната»
8. Правило «гармонии при передислокации тканей»
9. Правило «этапности воздействия»
10. Правило «иммобилизация зон коррекции»



Анатомические ориентиры

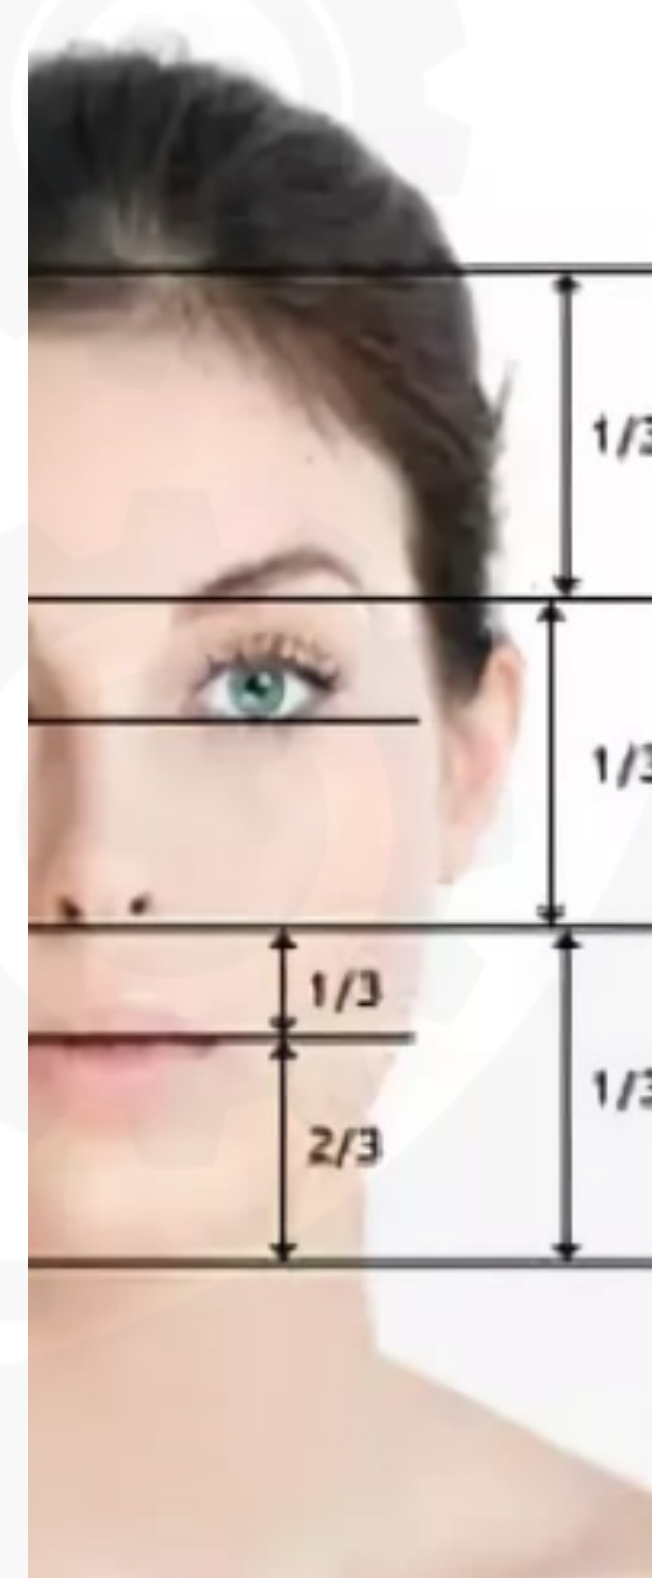

Реперные зоны для фиксации




Область поверхностной
темпоральной фасции

Область апоневроза и
истинных связок




Платизмарно ушной связки
и сосцевидного отростка

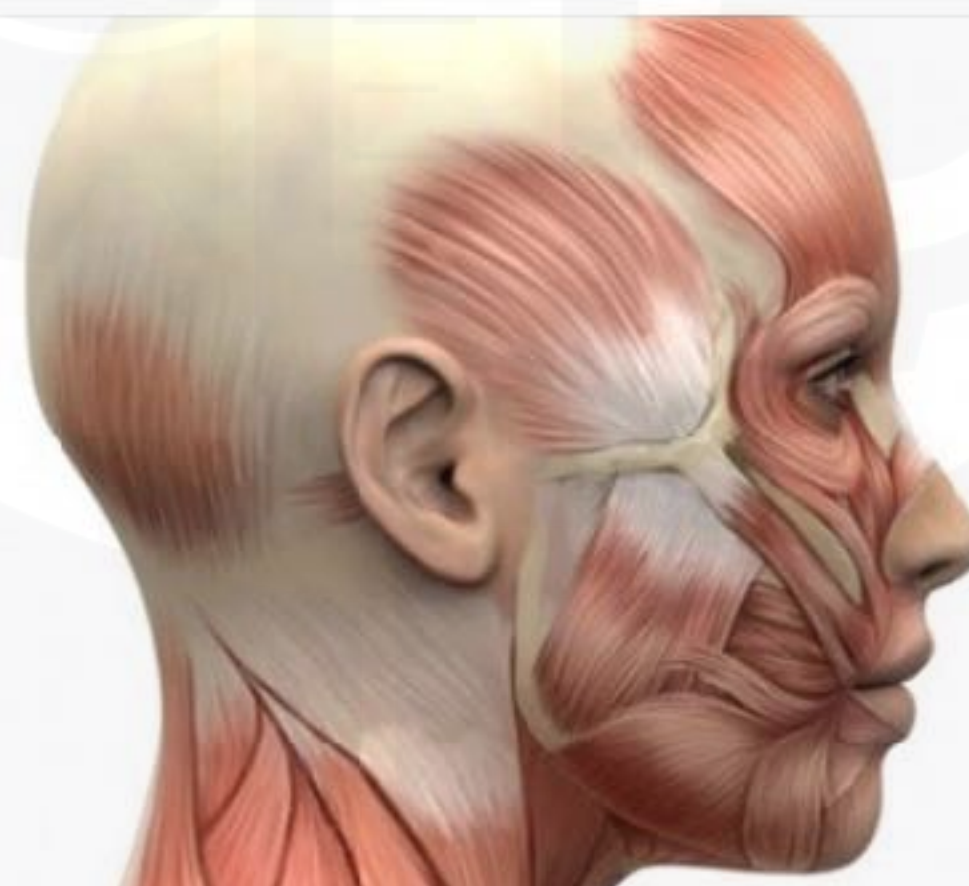


ИМПЛАНТАЦИЯ НИТЕЙ


Нить вводят в подкожно-жировой слой выше SMAS, но не слишком близко к поверхности кожи

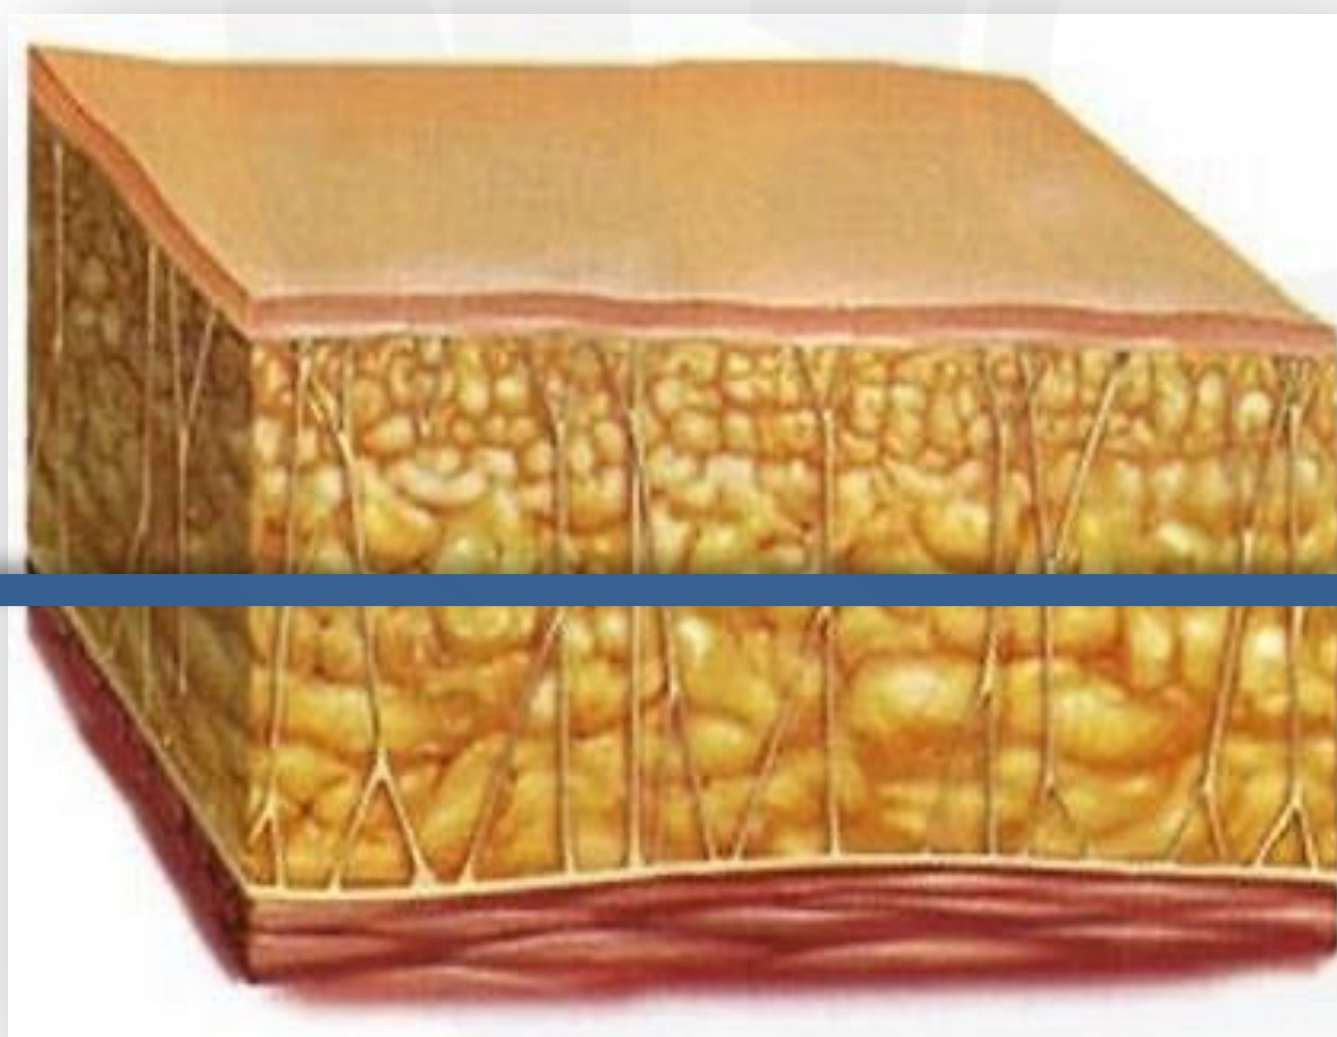


Подкожная жировая клетчатка лица

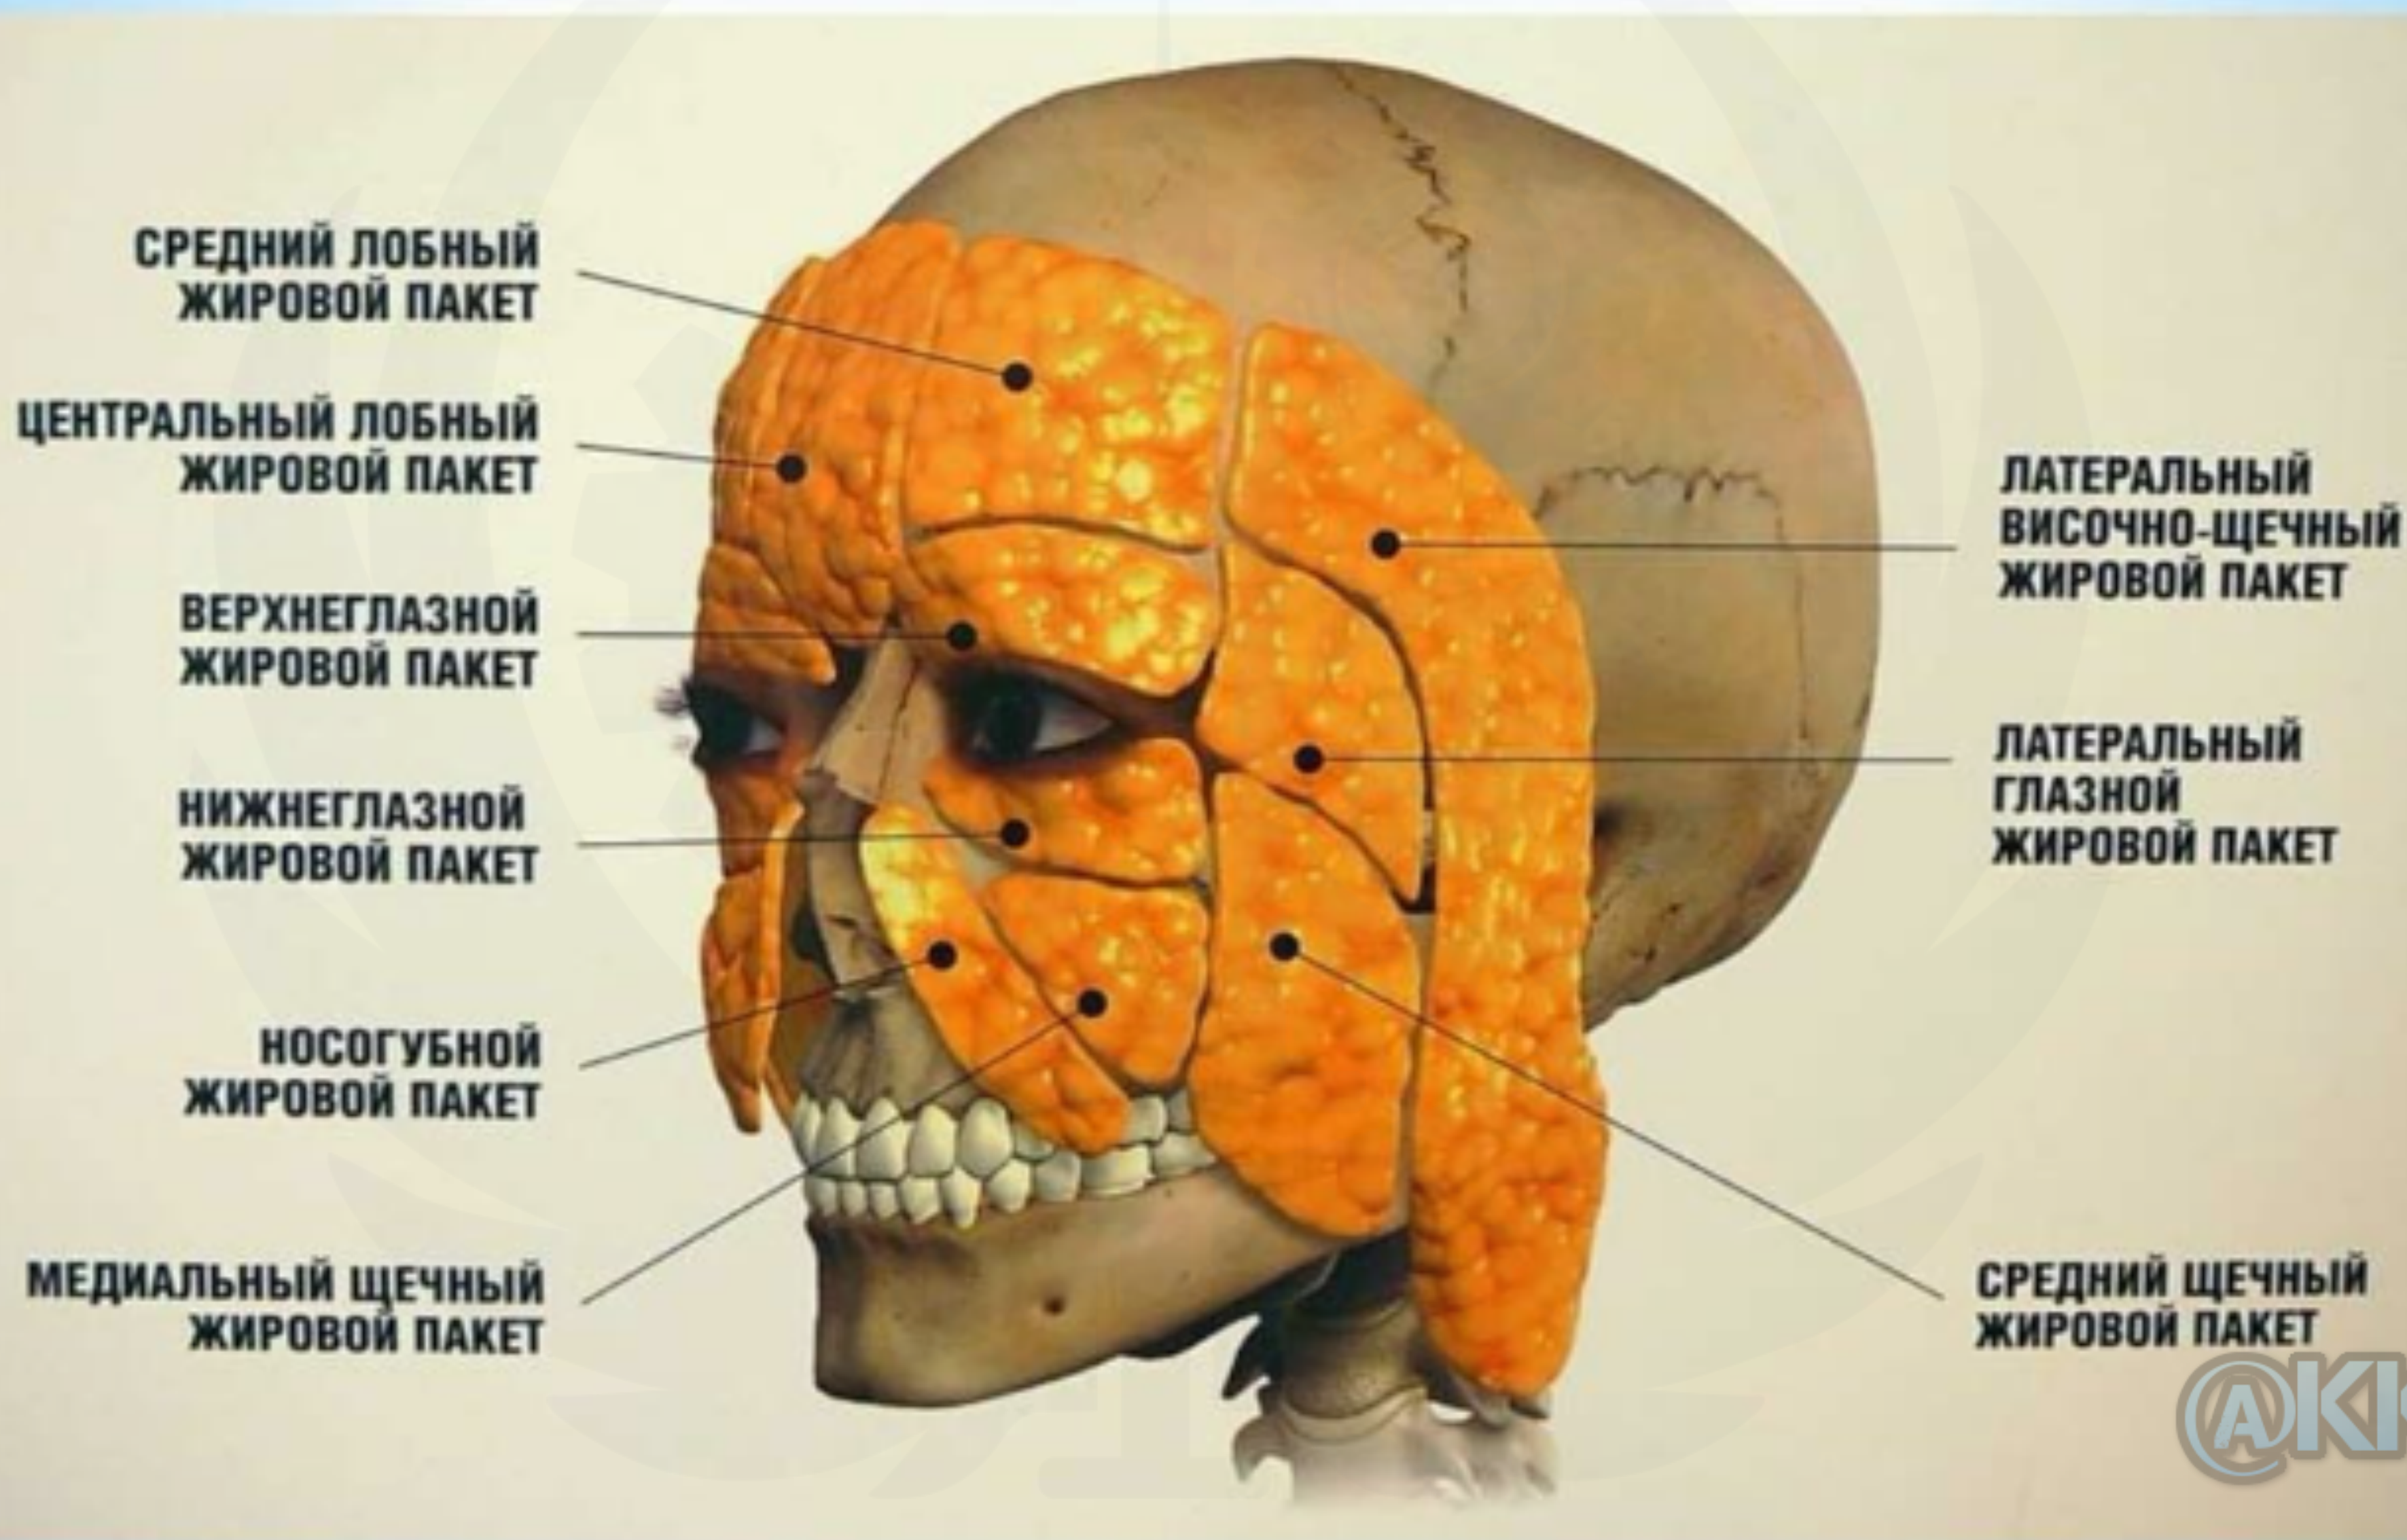

Что происходит со связочным аппаратом ?

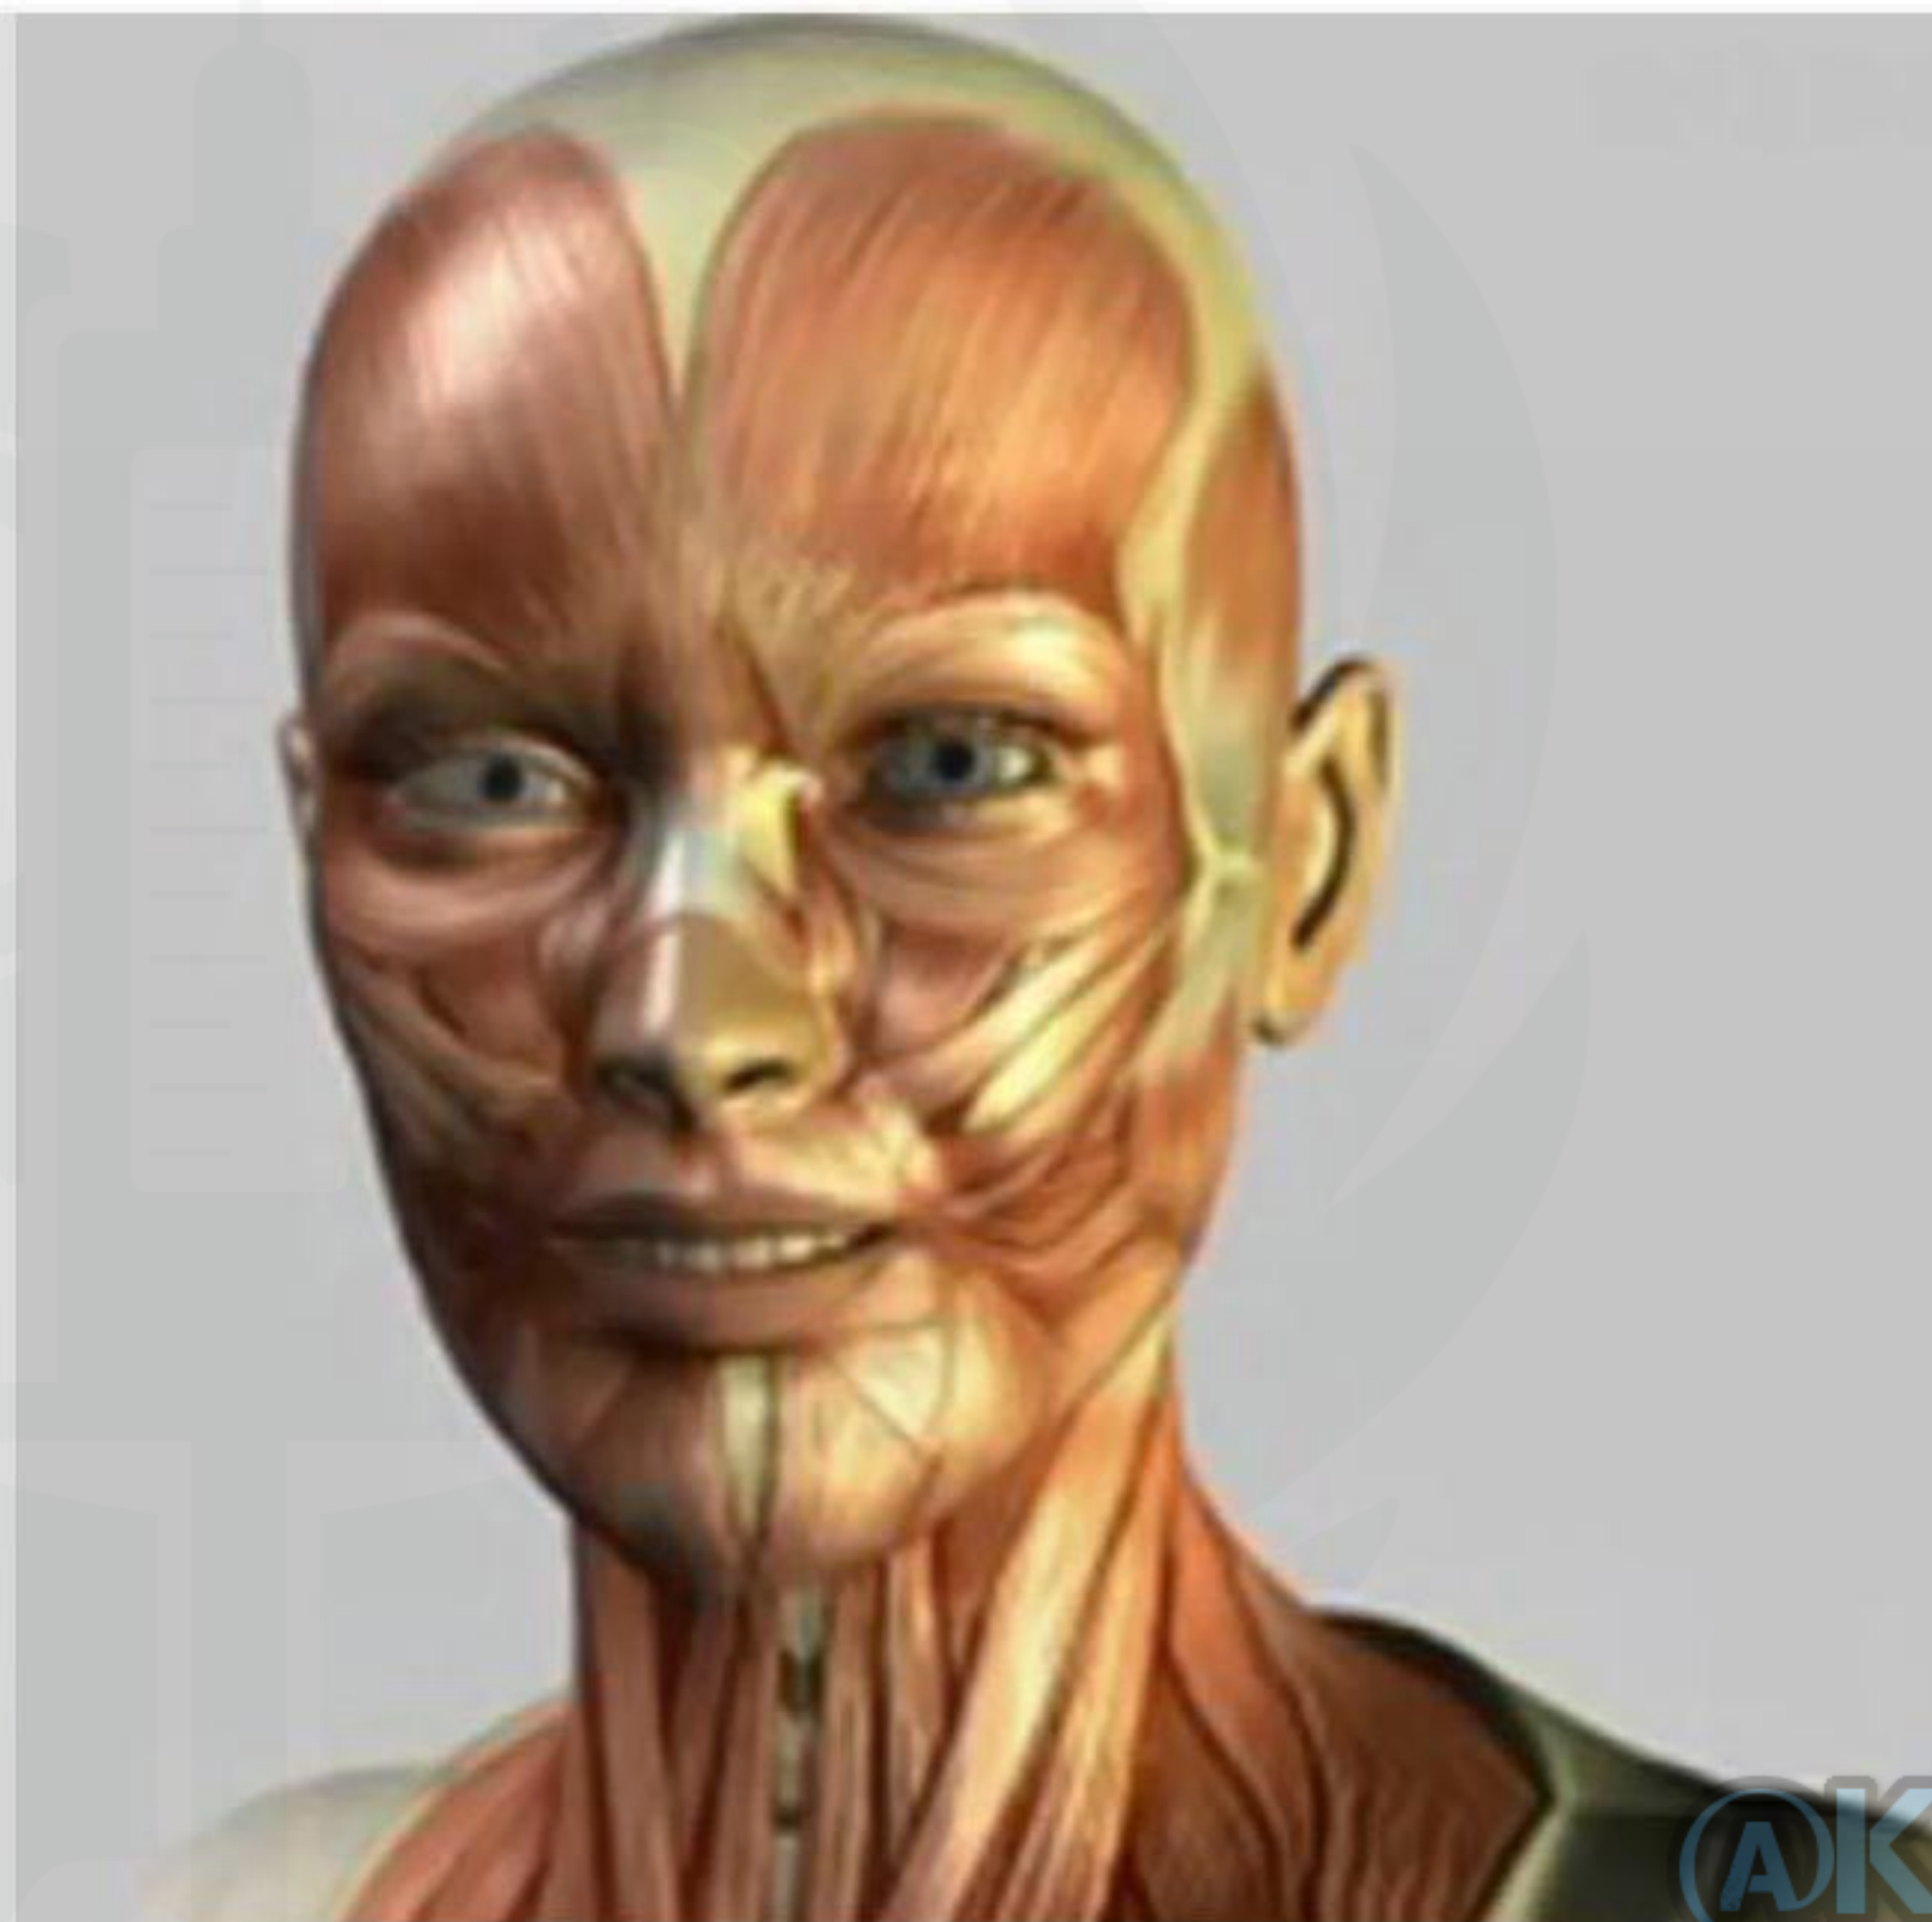


Истинные связки лица – расположение

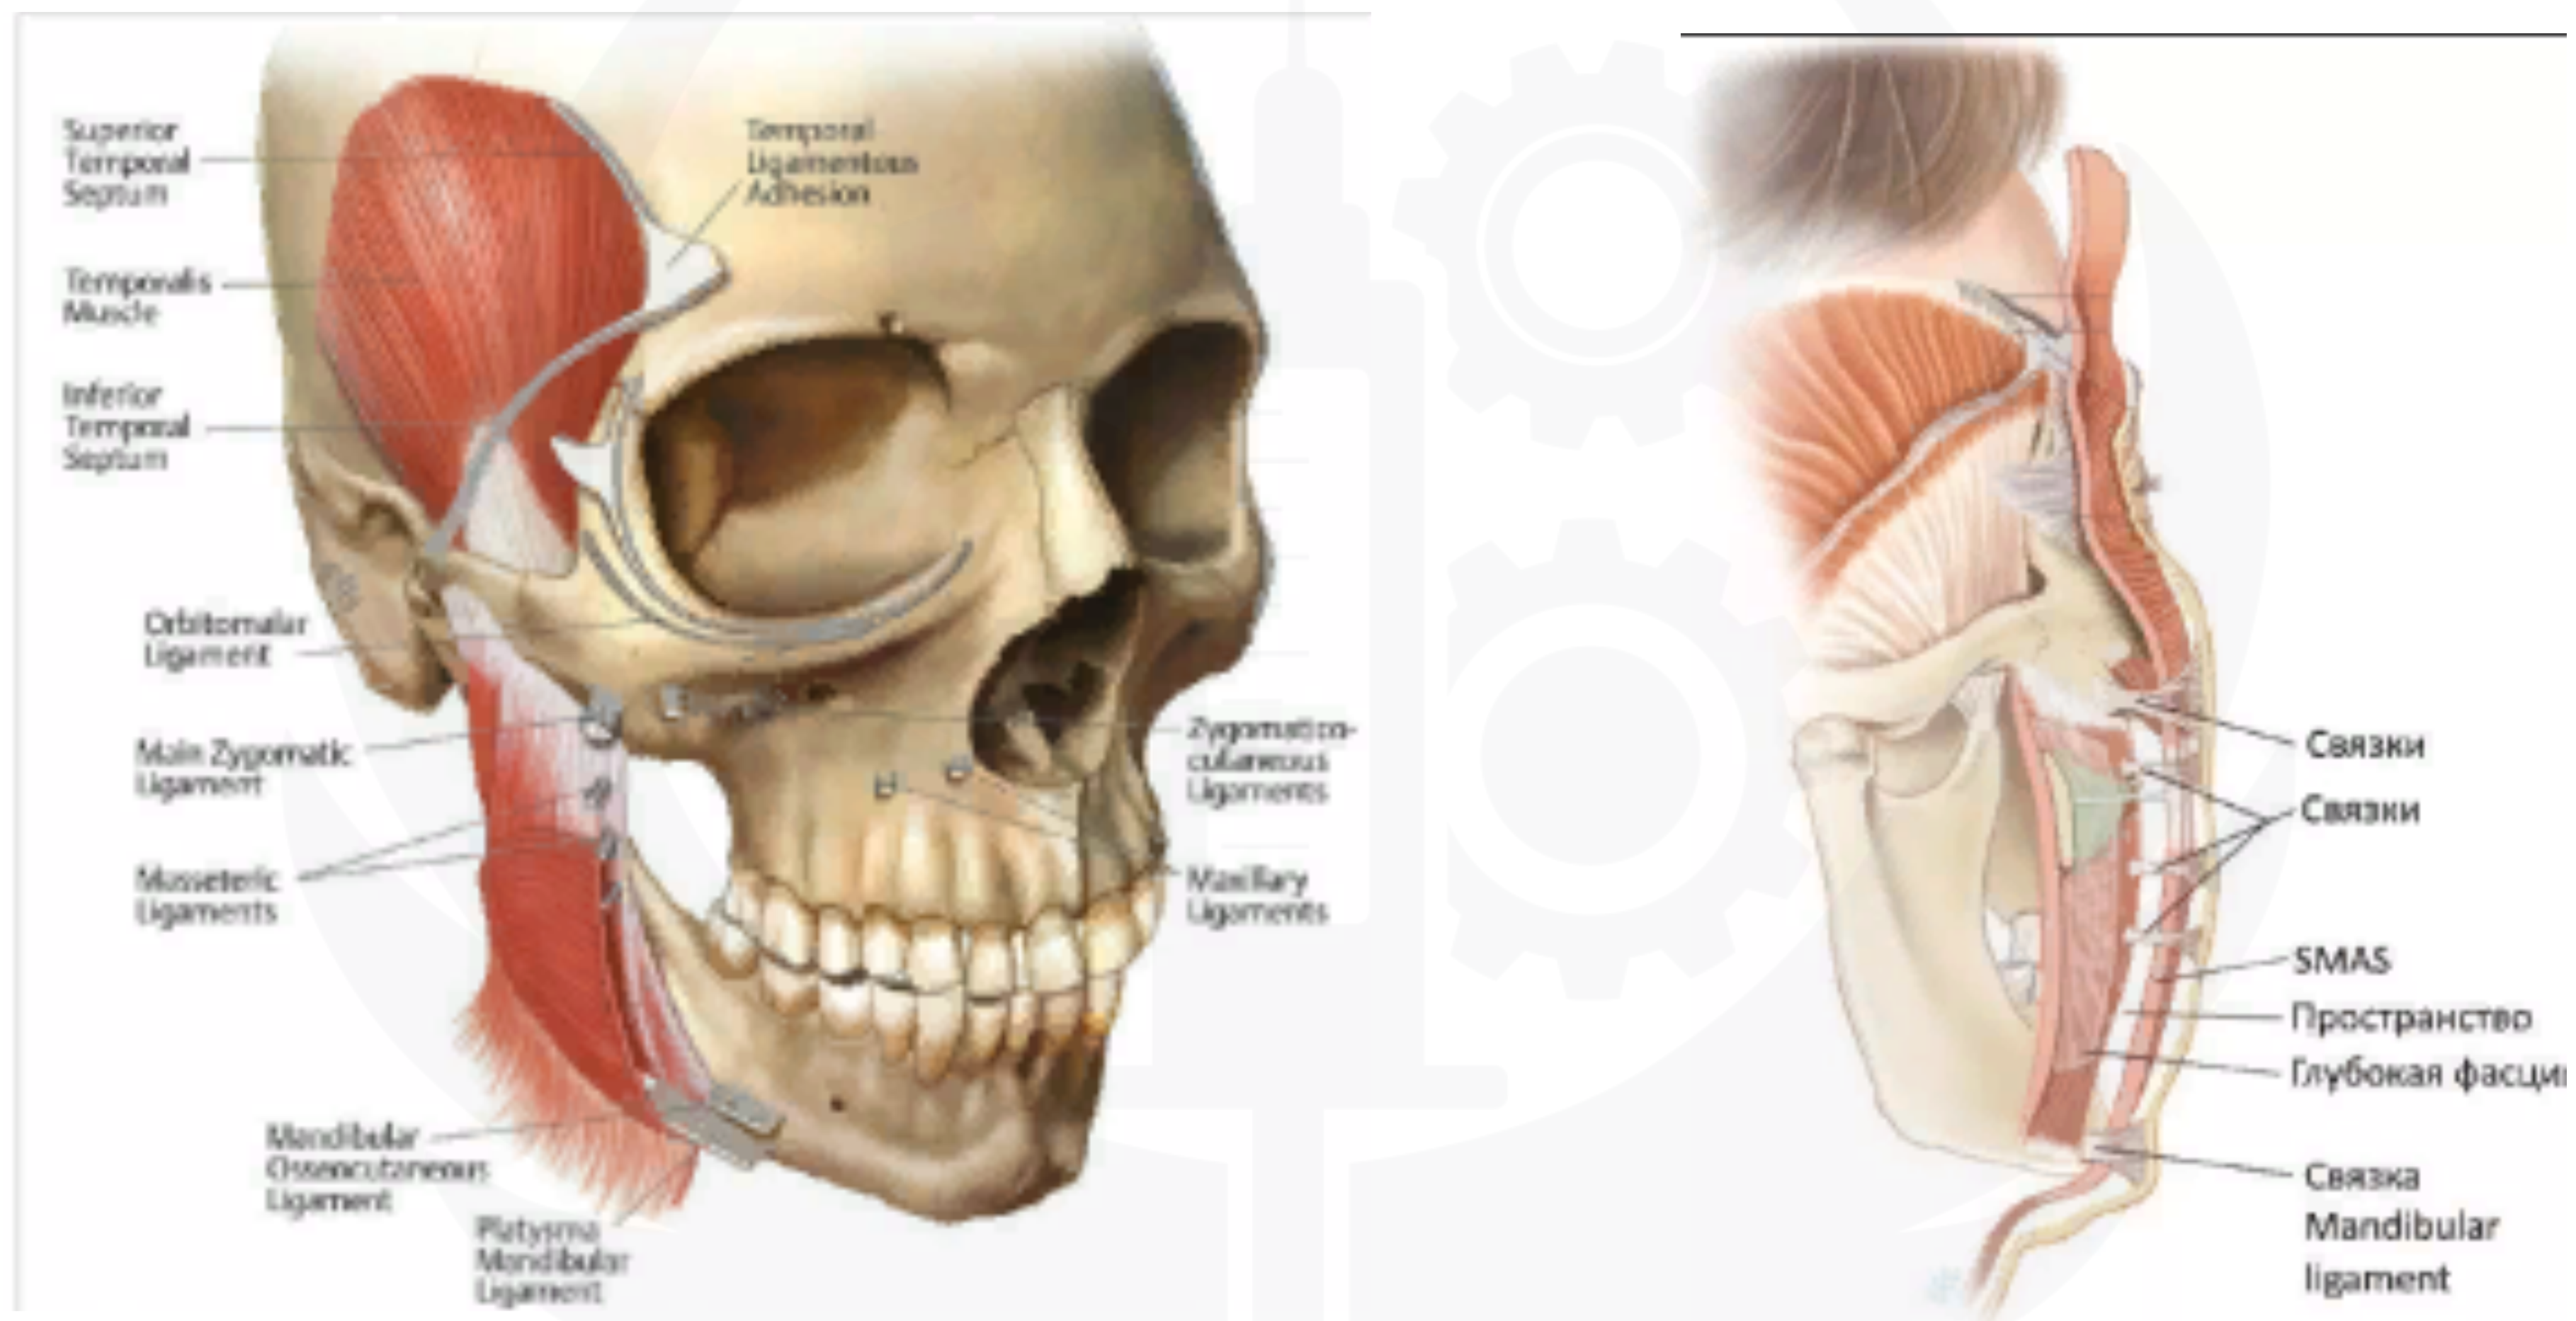

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Аутоиммунные заболевания
- Тяжелые соматические заболевания
- Заболевания крови
- Коллагенозы
- Ишемическая болезнь сердца
- Артериальная гипертензия II и III степени
- Гемофилия
- Психические и невротические нарушения
- Наличие злокачественных новообразований
- Заболевания кожи в области проведения процедуры
- Ранее введенные небиodeградирующие инъекционные импланты в зоне проведения процедуры
- Склонность к образованию келоидных и/или гипертрофических рубцов
- Лихорадочные состояния
- Беременность, лактация

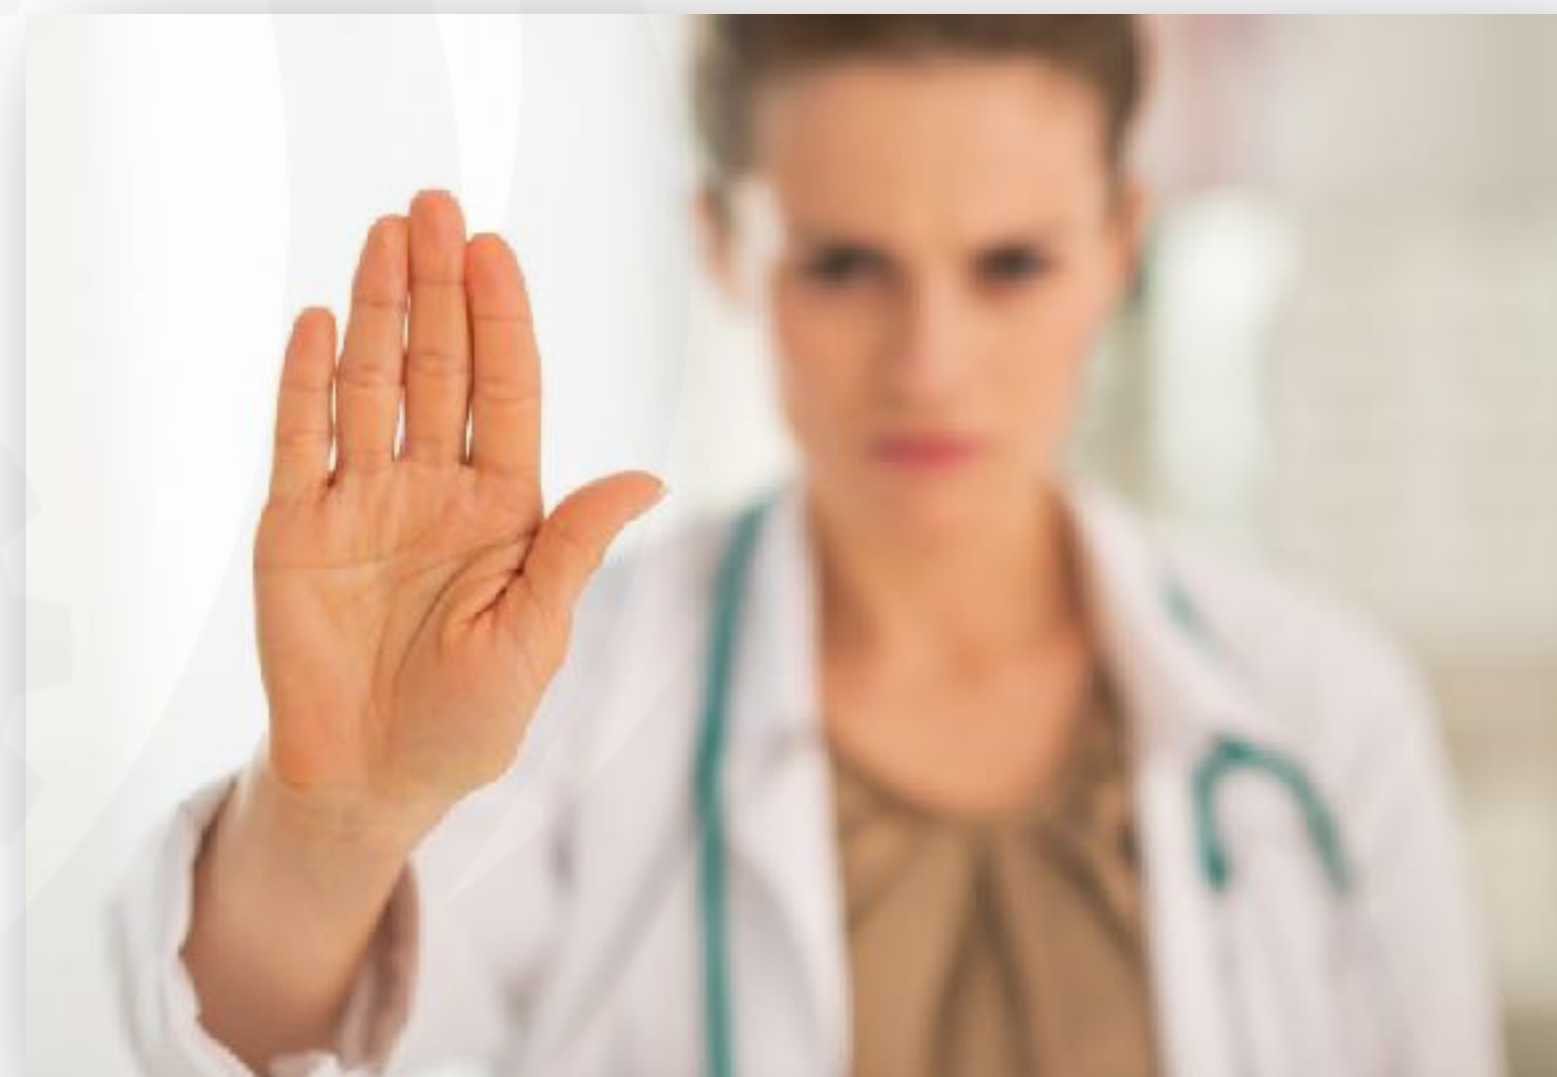

СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ МЕТОДИКАМИ



Ботулинотерапия
Волюмизация
Контурная пластика



Биоревитализация
Аппаратные методики



Пластические операции

Ассортимент линии нитей MINT





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 19 февраля 2016 года № РЗН 2016/3727

На медицинское изделие
Материал тонкий хирургический стерильный рассасывающийся MINT

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
**"ХансБиомед Корп.", Корея,
HansBiomed Corp., 807, 55, Seongsuil-ro, Seongdong-gu, Seoul, Korea**

Производитель
**"ХансБиомед Корп.", Корея,
HansBiomed Corp., 807, 55, Seongsuil-ro, Seongdong-gu, Seoul, Korea**

Место производства медицинского изделия
**HansBiomed Corp., 64, Yuseong-daero, 1628beon-gil, Yuseong-gu, Daejeon, 305-811,
Korea**

Номер регистрационного досье № РД-8282/34715 от 21.08.2015

Вид медицинского изделия 147190

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9300

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 19 февраля 2016 года № 1343
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0017630

MINT LIFT : характеристики

Оптимальные долговечные
и безопасные нити

Одобрены FDA

Биодеградируемые

Запатентованная технология
пресс формования шипов

Шипы спирально расположены по всей окружности
нити и

обеспечивают максимально надежную фиксацию
мягких тканей



Шипы расположены двунаправлено

Упакованы с применением
азота в двойные блистерные упаковки для
профилактики
расстерилизации

Стерилизованы этиленоксидом




Mint Lift

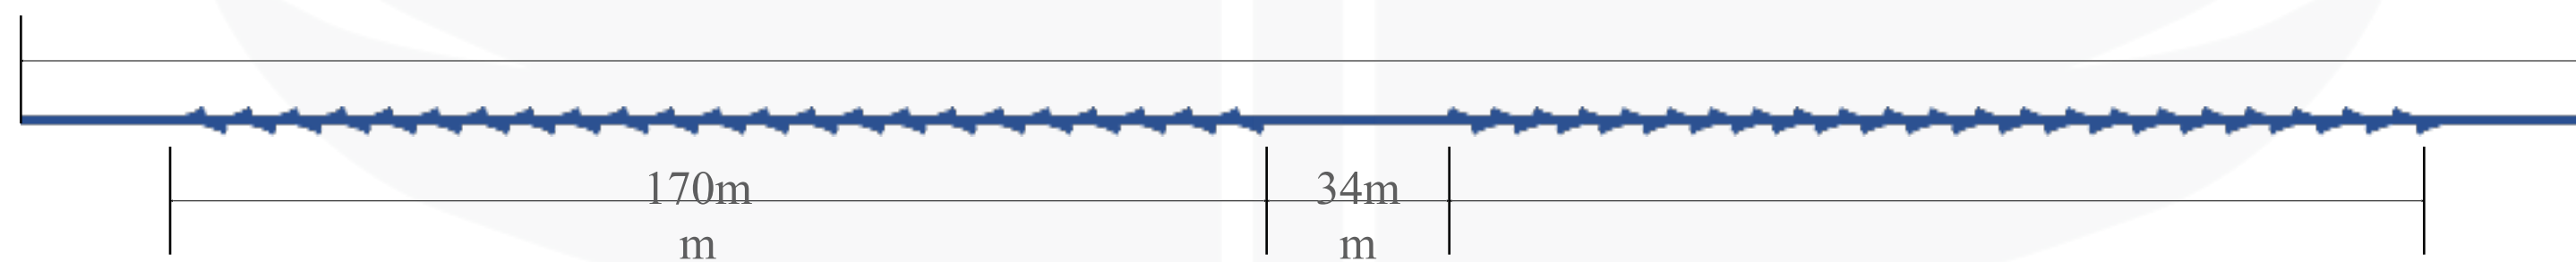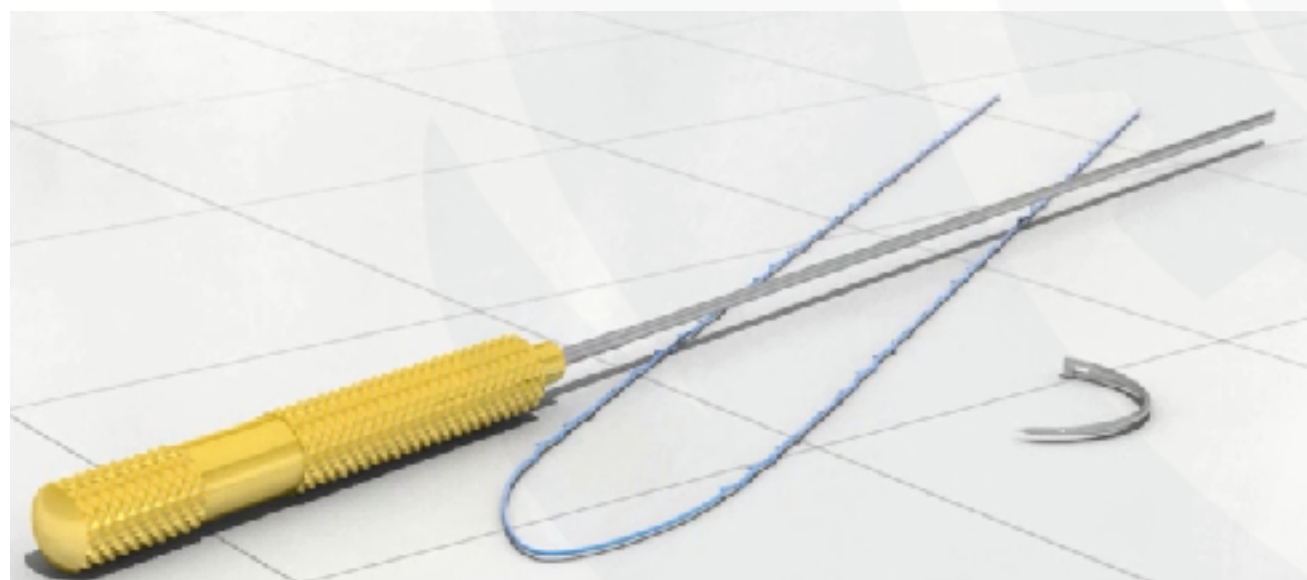

длина 43 см
82 фиксирующих шипа

Mint Easy

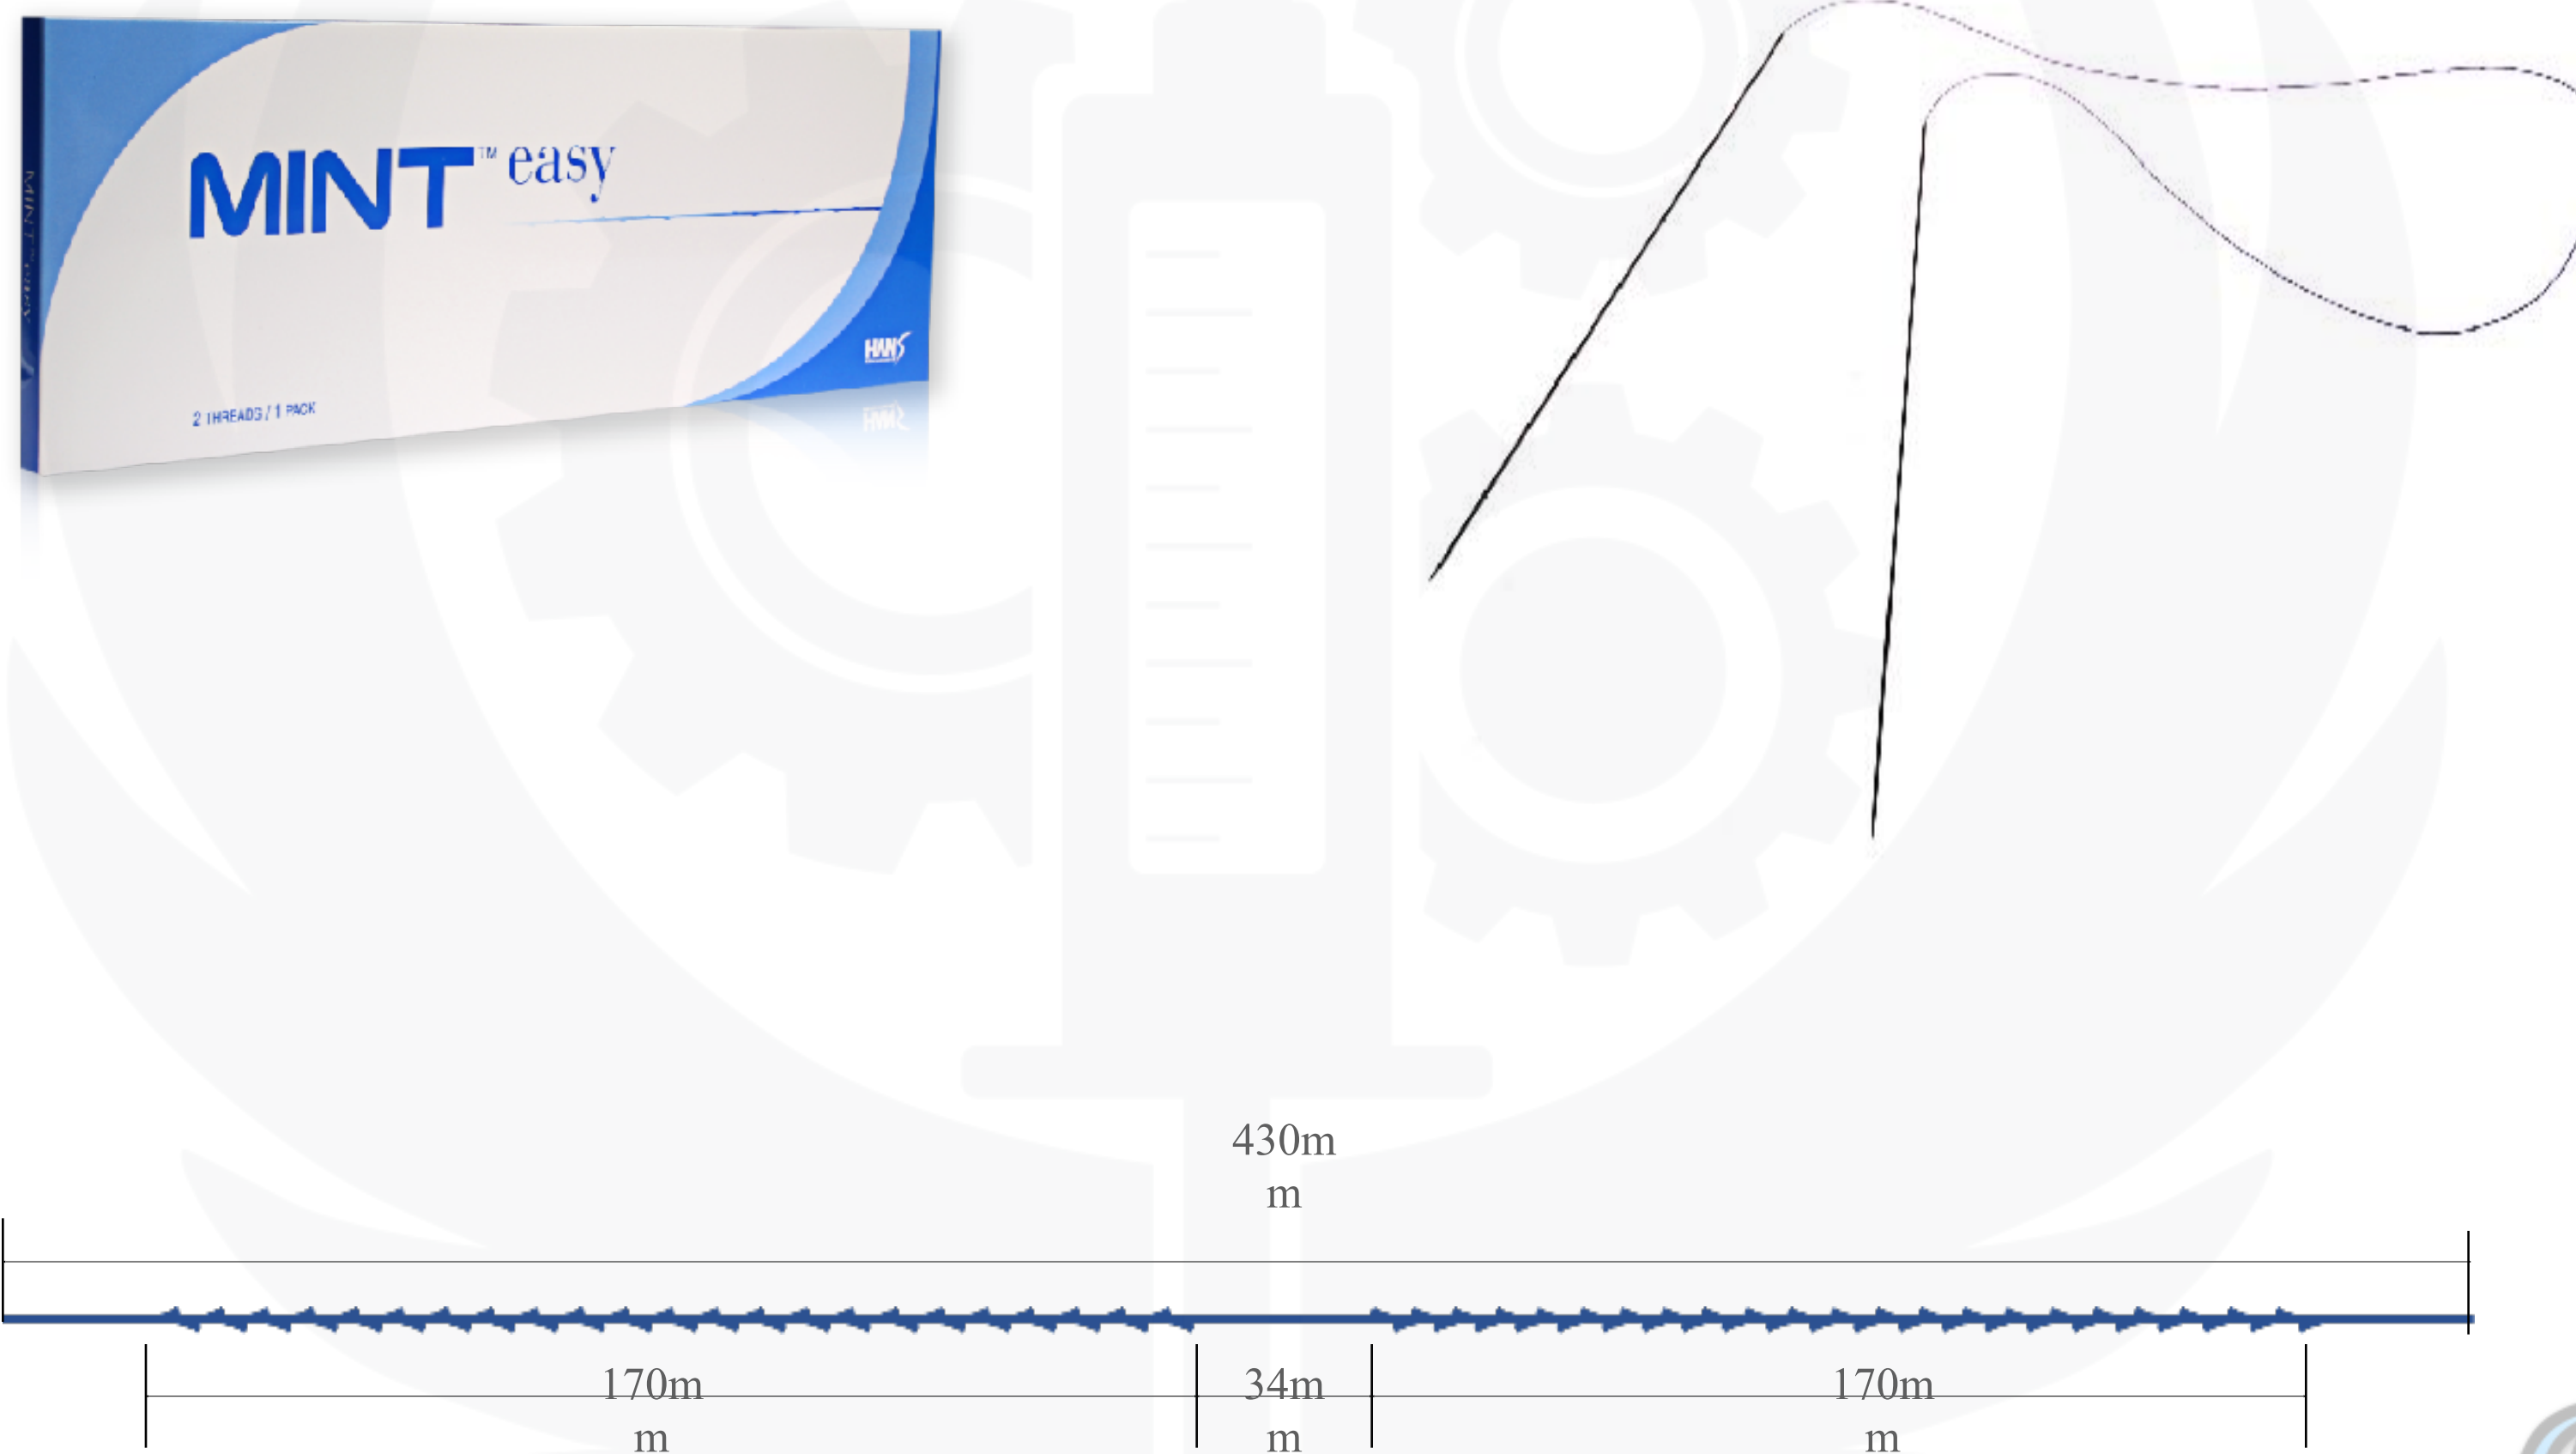


длина 43 см
82 фиксирующих шипа

Mint Mini



Длина а 17 см , 35 фиксирующих шипов

Mint Fine

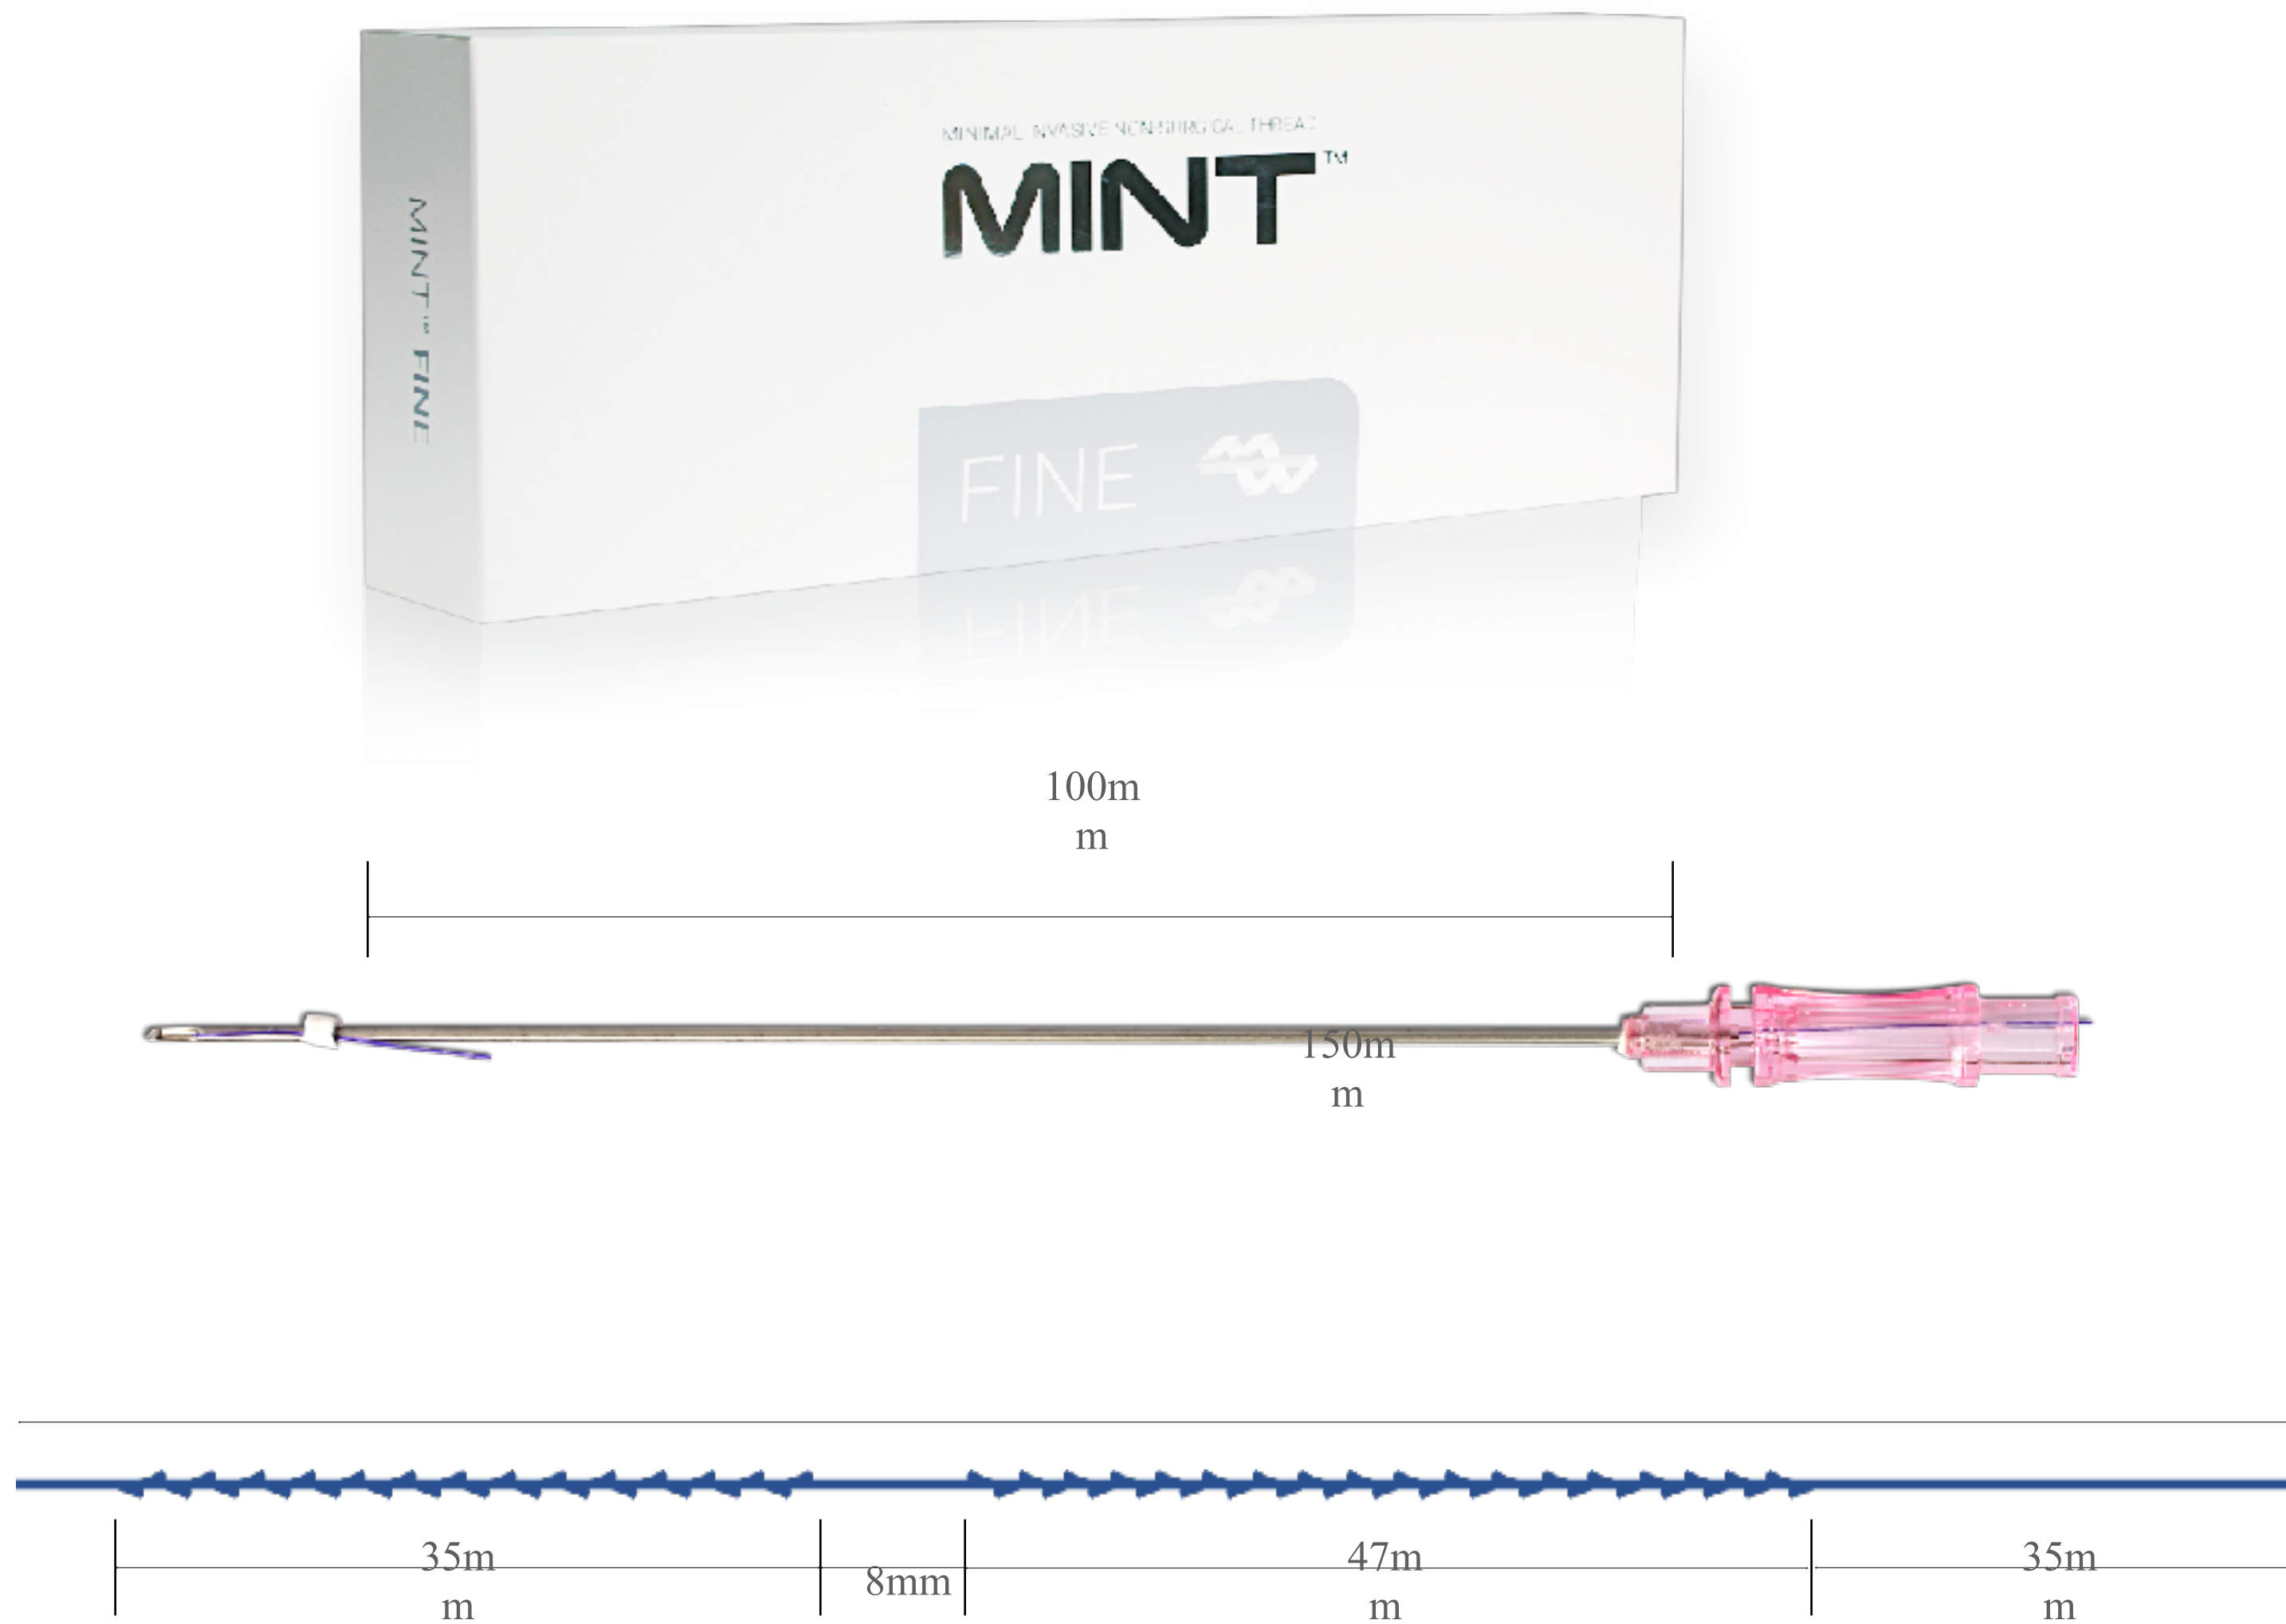

Длинна а 15 см , 32 фиксирующих шипа



ОСЛОЖНЕНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ



- Срыв нитей
- Выход нити к поверхности
кожи
- Нестабильный результат
- Ассиметрия
- Гиперкоррекция
- Линейные кровоизлияния
- Втяжения кожи в месте
прокола

Причины разочарования в методе

Продолжительность
эффекта
Стоимость
Осложнения
Неестественность подтяжки
Долгий реабилитационный
период
Болезненность

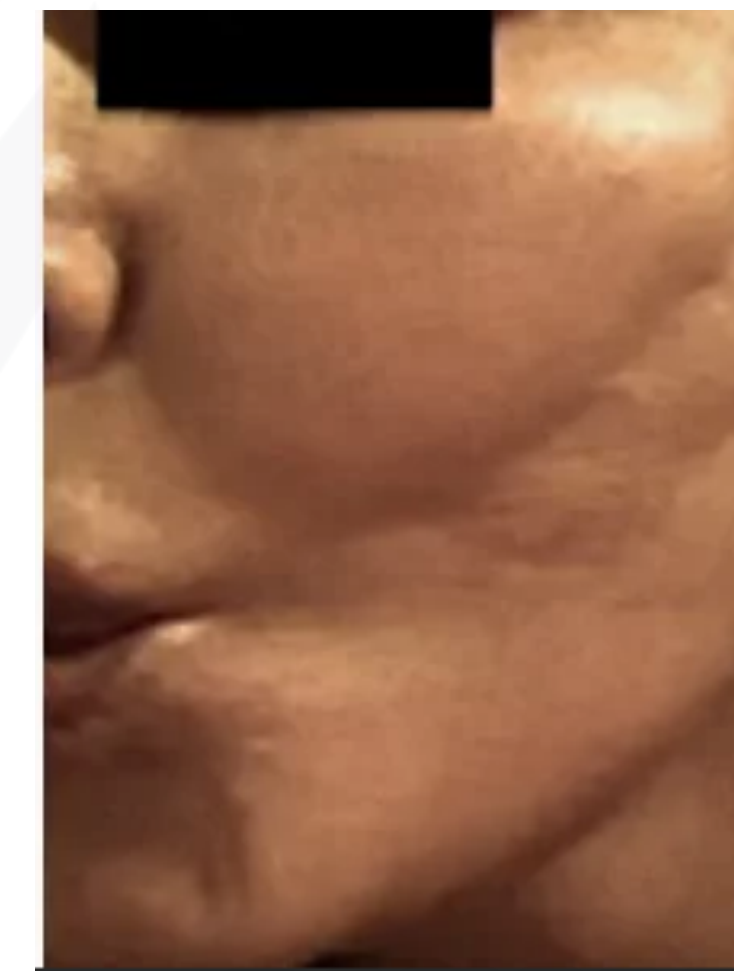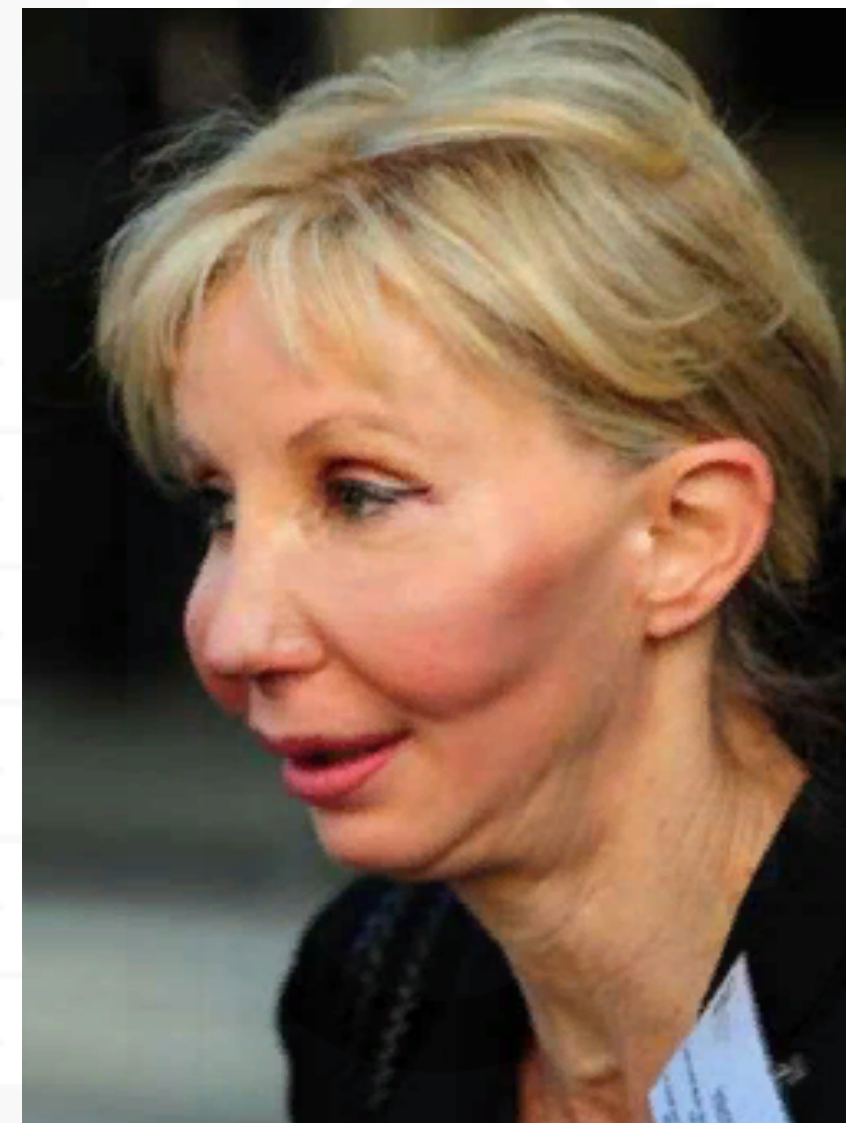

ФАКТОРЫ ОСЛОЖНЕНИЙ

Нарушения и ошибки -

**Выбор
глубины
имплантации**

**Выбор
количества
нитей**

**Выбор
материала
нитей**

**Нарушение
техники
имплантации**

**Нарушение
правил
асептики
и антисептики**

ФАКТОРЫ ОСЛОЖНЕНИЙ

Ошибки в выборе -

**Выбор
пациента**

**Выбор
реперной
зоны**

**Выбор
вектора
перемещения**

**Соблюдение
правил
реабилитации**

**Подготовка
тканей
к имплантации**

ОСЛОЖНЕНИЯ НИТЕВОГО ЛИФТИНГА



Слагаемые успеха тредлифтинга

- 1) знание инвалютивной последовательности жировых компарментов
- 2) знание где находятся истинные связки
- 3) знание антагонизма депрессоров и элеваторов



Фиксация
Вектор
Количество
Конфигурация
Реабилитация

10 шагов к успешной процедуре



Шаг 1- осмотр и получение информированного согласия



- Толщина подкожной жировой клетчатки
- Антагонизм депрессоров и элеваторов
- Костный скелет
- Положение истинных связок
- Мандибула и максила как опора мягких тканей
- Височнонижнечелюстной сустав
- Мобильность мягких тканей

Шаг 2 – фото документирование в трех проекциях



Правила качественного фото

- 1 – темный фон
- 2 – прямой свет
- 3 проекция анфас
- 4 – проекция профиль
- 5 – проекция полупрофиль

Шаг 3 – антисептическая обработка

Список рекомендуемых антисептиков:

Хлоргексидин на спиртовой
основе
Октинисепт
Бетадин
Сангвитар
Перекись водорода
Асептолин
Мирамед
Витасепт



Шаг 4 – выполнение разметки



Правила проведения разметки

- Вертикальное положение
- Отсутствие мимики на момент проведения
- Мануальное перемещение тканей с учетом идеального эстетического положения
- Согласование и прогнозирование результата с пациентом

Шаг 5 – проведение анестезии



Инфильтрационная анестезия рецепт

Шприц на 5 мл – 2 шт

Игла 30 G 2 шт

NaCl физ р-р 0.9% 6 мл

Ультракаин – 2 карпулы

Бикарбонат натрия 4 % 2 мл

Шаг 6 – создание стерильной зоны



Перечень необходимых материалов

Стерильный халат
Стерильные салфетки 20шт
Стерильные перчатки 2 пары
Стерильные простыни 3 шт 50/70
Стерильная простынь 70/200 1 шт
Стерильный столик
Стерильный лоток
Стерильные ножницы
Зажим 2 шт
Пинцет 1 шт

Шаг 7 – имплантация нитей







Шаг 8 – обработка зон имплантации наложение стерильной защиты



Перечень необходимых материалов
медицинский клей БФ для защиты
раневых каналов от инфицирования
Тейпы для профилактики отека
Дексаметозон 8 мг в\м

Шаг 9 – контроль и фото документирование

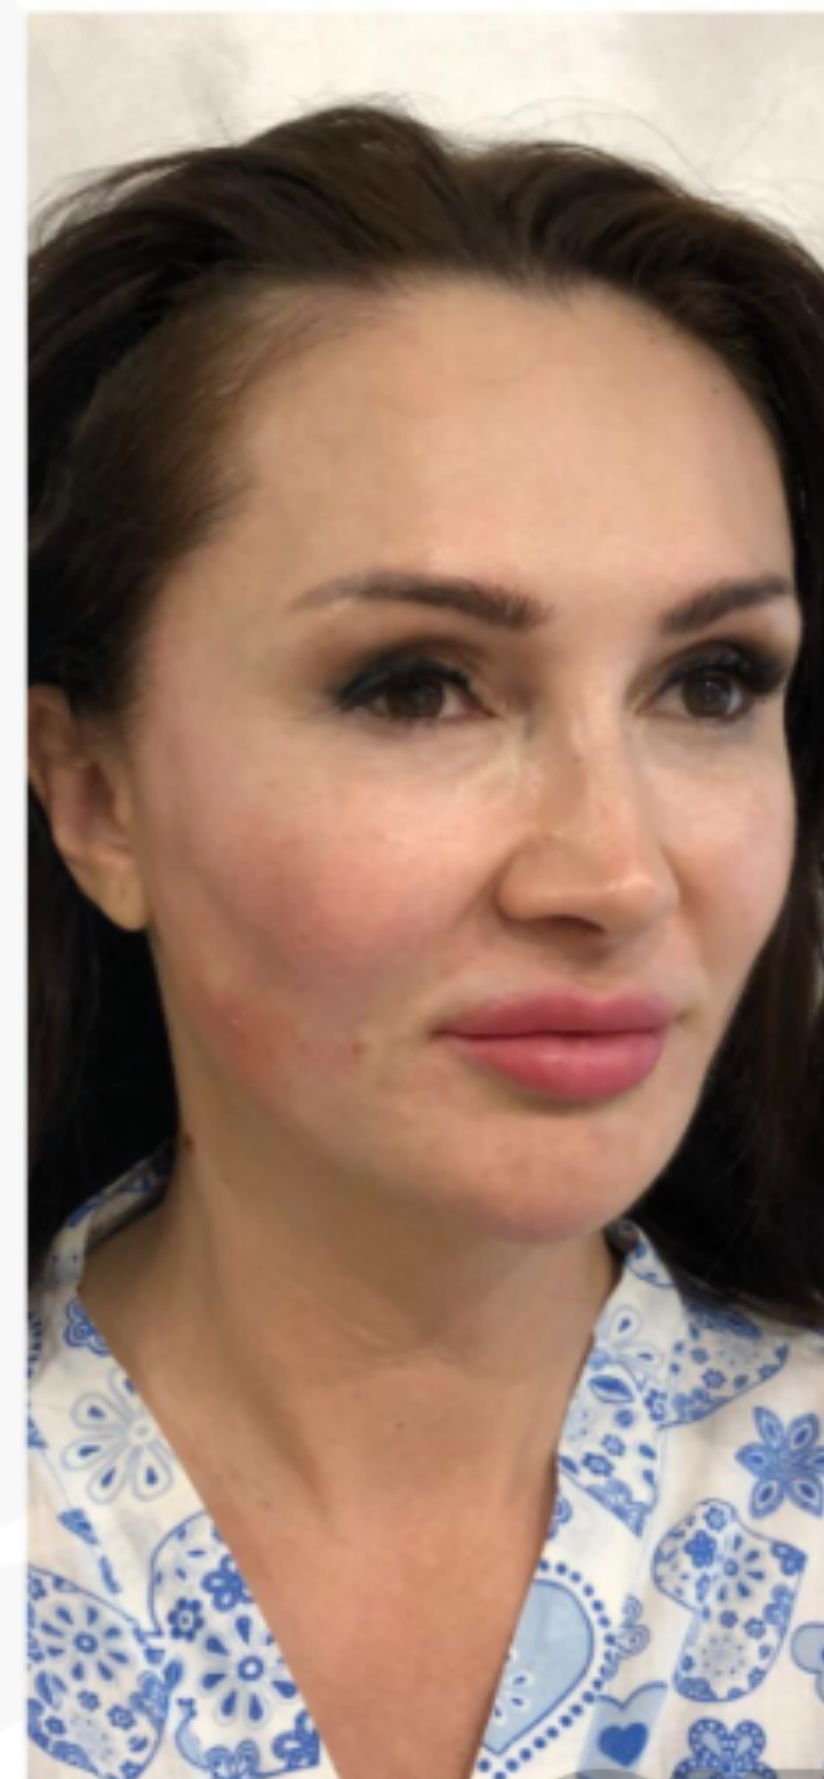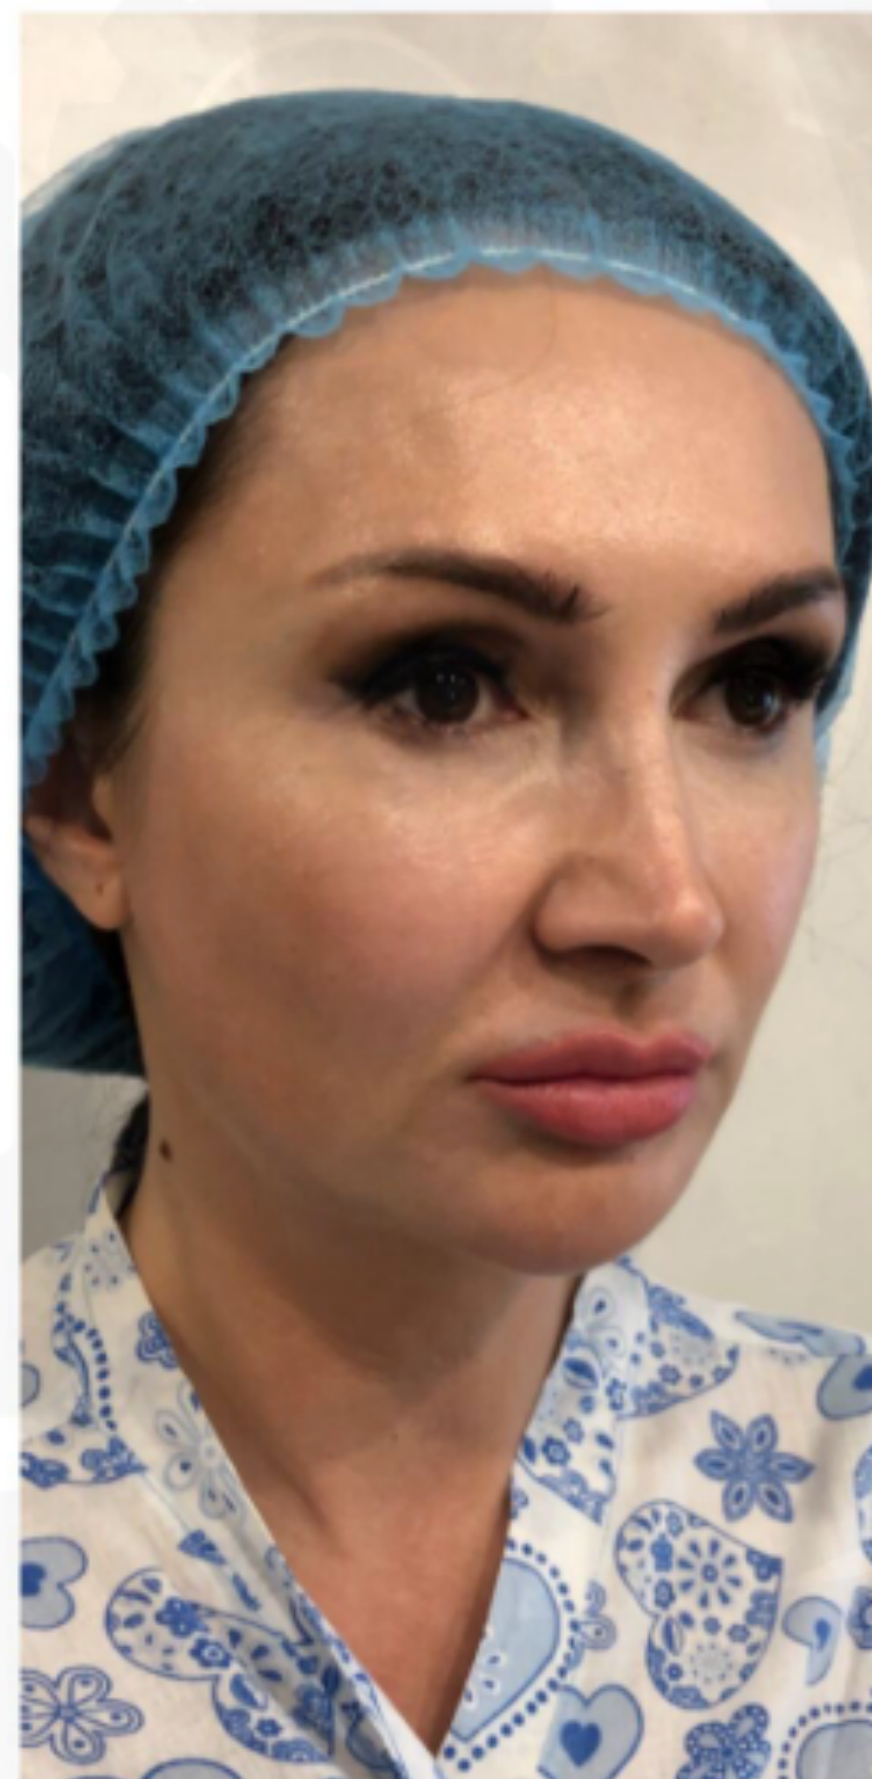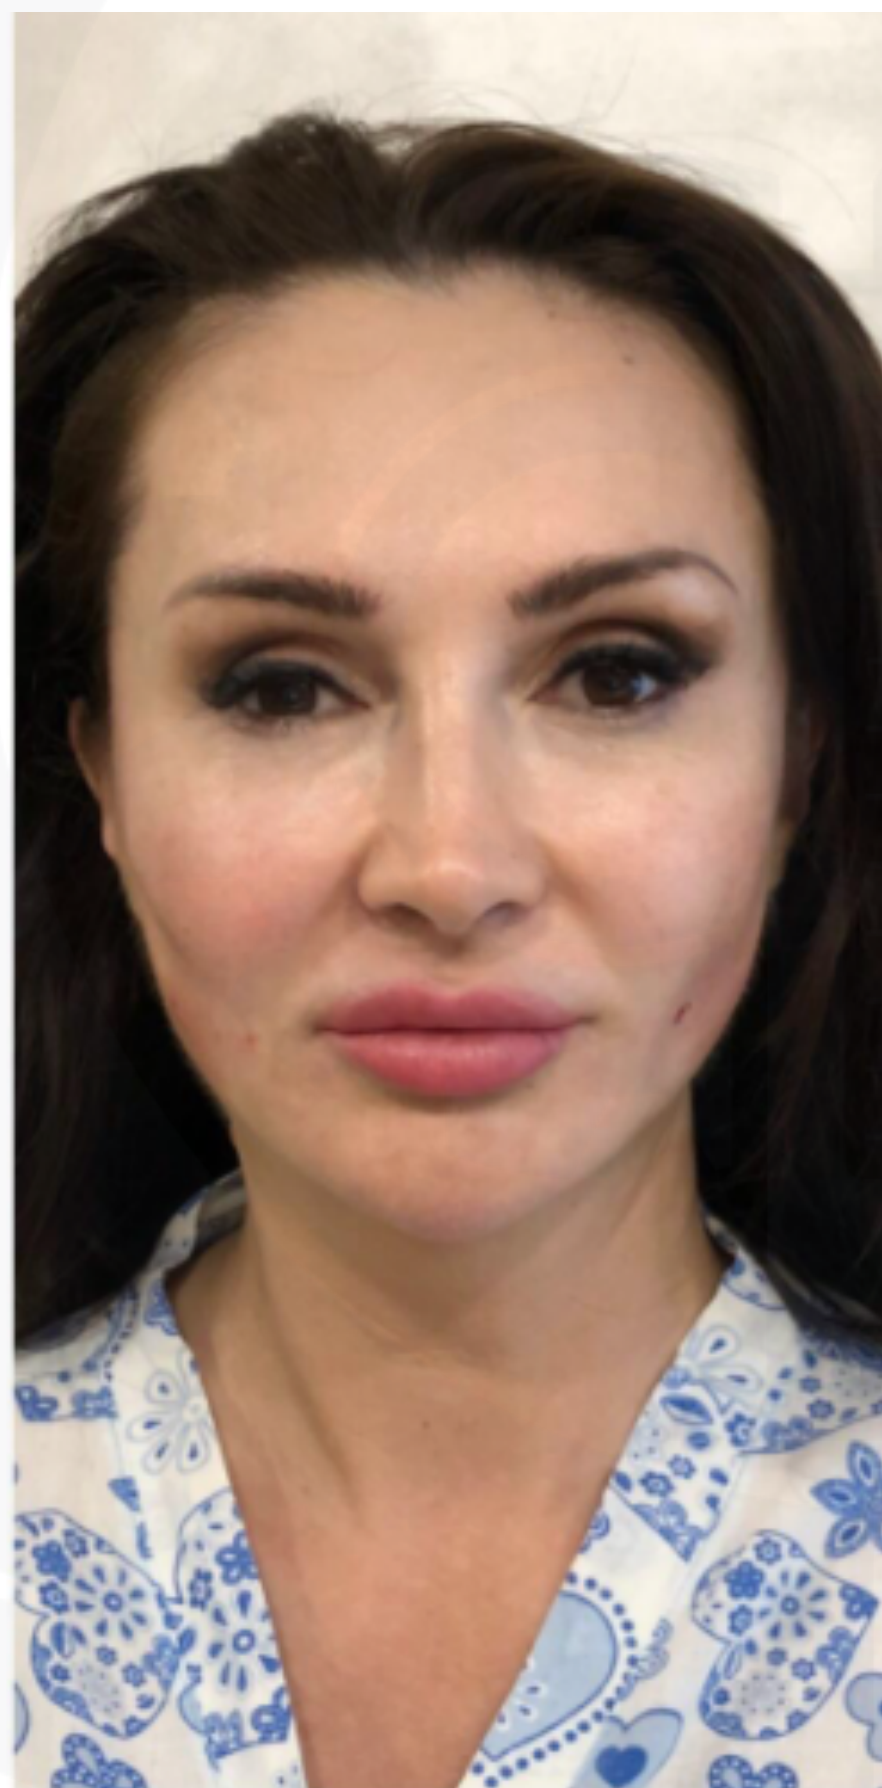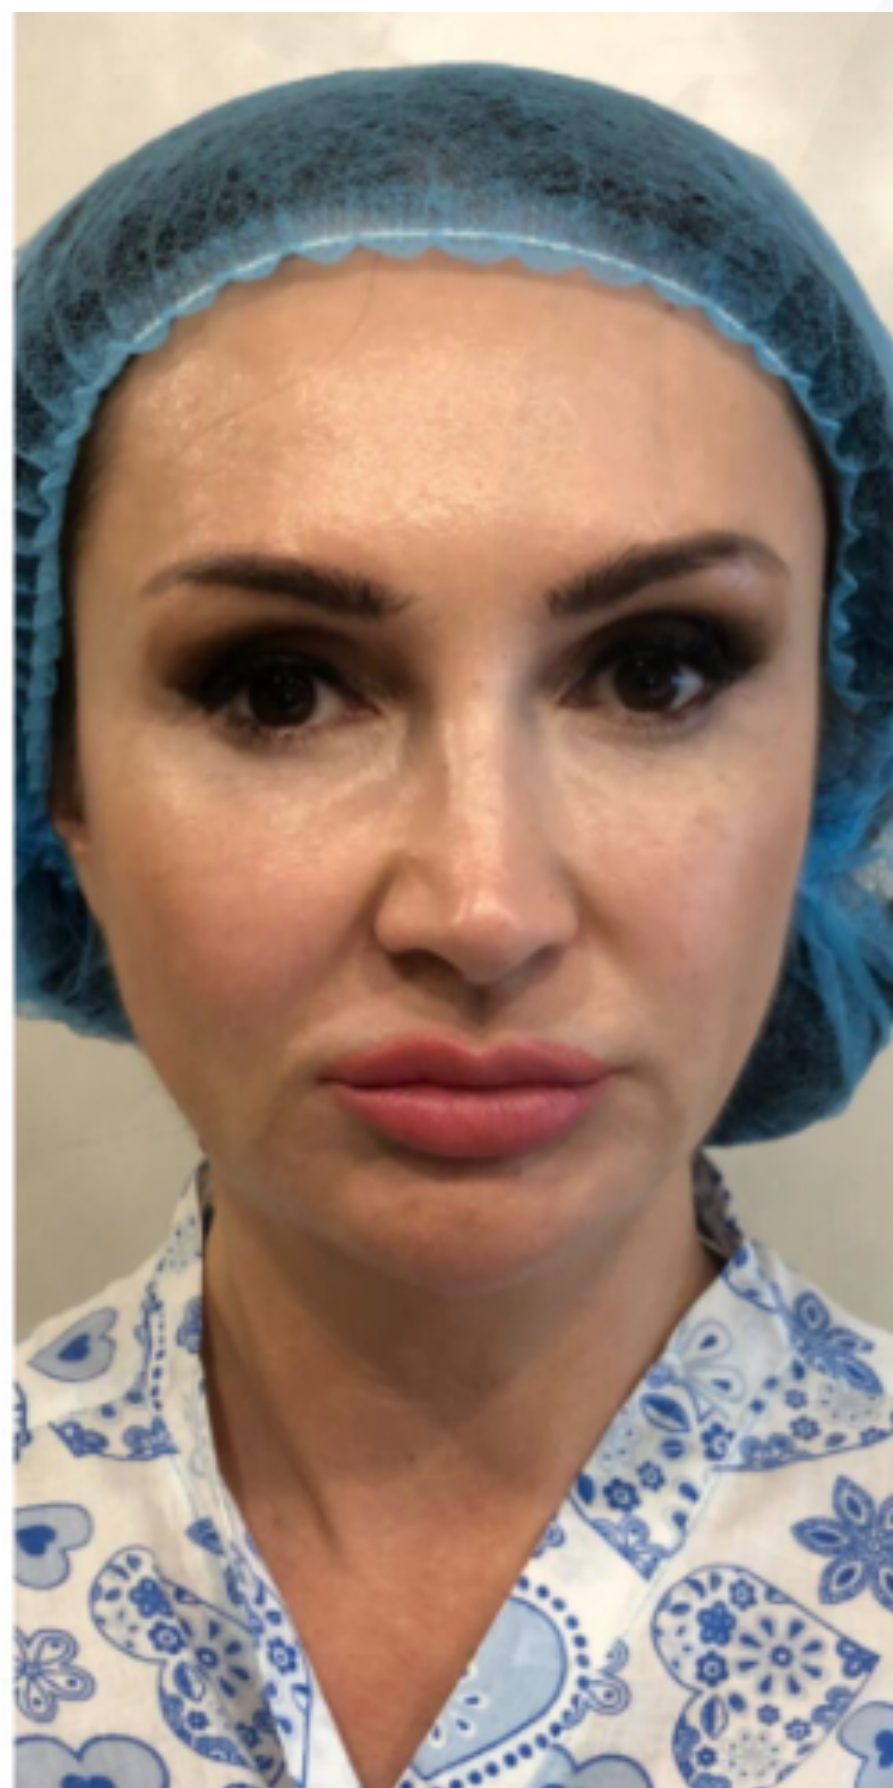


Шаг 10 - Рекомендации реабилитационного периода




- 1) Назначение противовоспалительной терапии
- 2) Назначение противоотечной терапии
- 3) Назначение противовирусной терапии
- 4) Ограничительные правила поведения
- 5) Ношение компрессионной повязки
- 6) Осмотр на 3, 14, 30 день после проведения имплантации

РЕКОМЕНДАЦИИ ПАЦИЕНТУ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

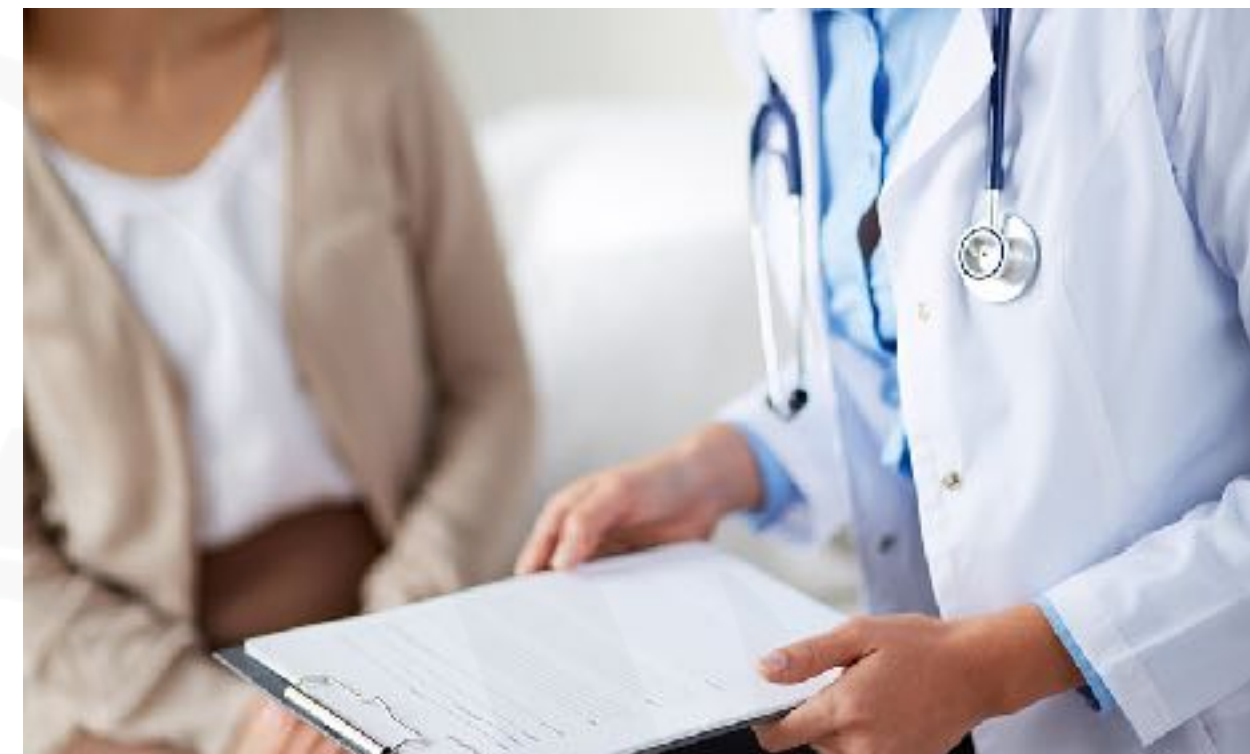


- Прикладывать холод к зоне коррекции в течение первых суток
- После установки лифтинговых нитей – первое время спать на спине и применять повязку из эластического бинта;
- По необходимости использовать анальгетики (анальгин, пенталгин, кетанов, солпадеин и др.) для купирования боли;
- Для снятия отеков и ускорения рассасывания мелких кровоизлияний использовать специальные мази/гели (гепариновую мазь, лиотон 1000, гепатромбин, троксевазин, траумель и др.);
- Снять кусочки пластыря с точек проколов кожи по прошествии первых суток.
- Обрабатывать эти точки раствором хлоргексидина ежедневно в течение 2-3-х дней;
- Снять удерживающие пластыри по истечении периода их использования;
- Максимально сдерживать свою мимику в течение недели, избегайте в этот период интенсивных жевательных движений, не открывайте рот слишком широко и резко;
- В течение 3-х дней не принимать горячего душа, не посещать бани, сауны и бассейны, отказаться от занятий активными видами спорта;
- Отказаться от тепловых процедур в зонах расположения нитей – на 1 месяц, от сеансов массажа, физиотерапии и процедур миостимуляции – на 2 месяца;
- Посетить врача через 7-14 дней

СХЕМА ИМПЛАНТАЦИИ Mint Lift 43 или Mint Easy Blunt

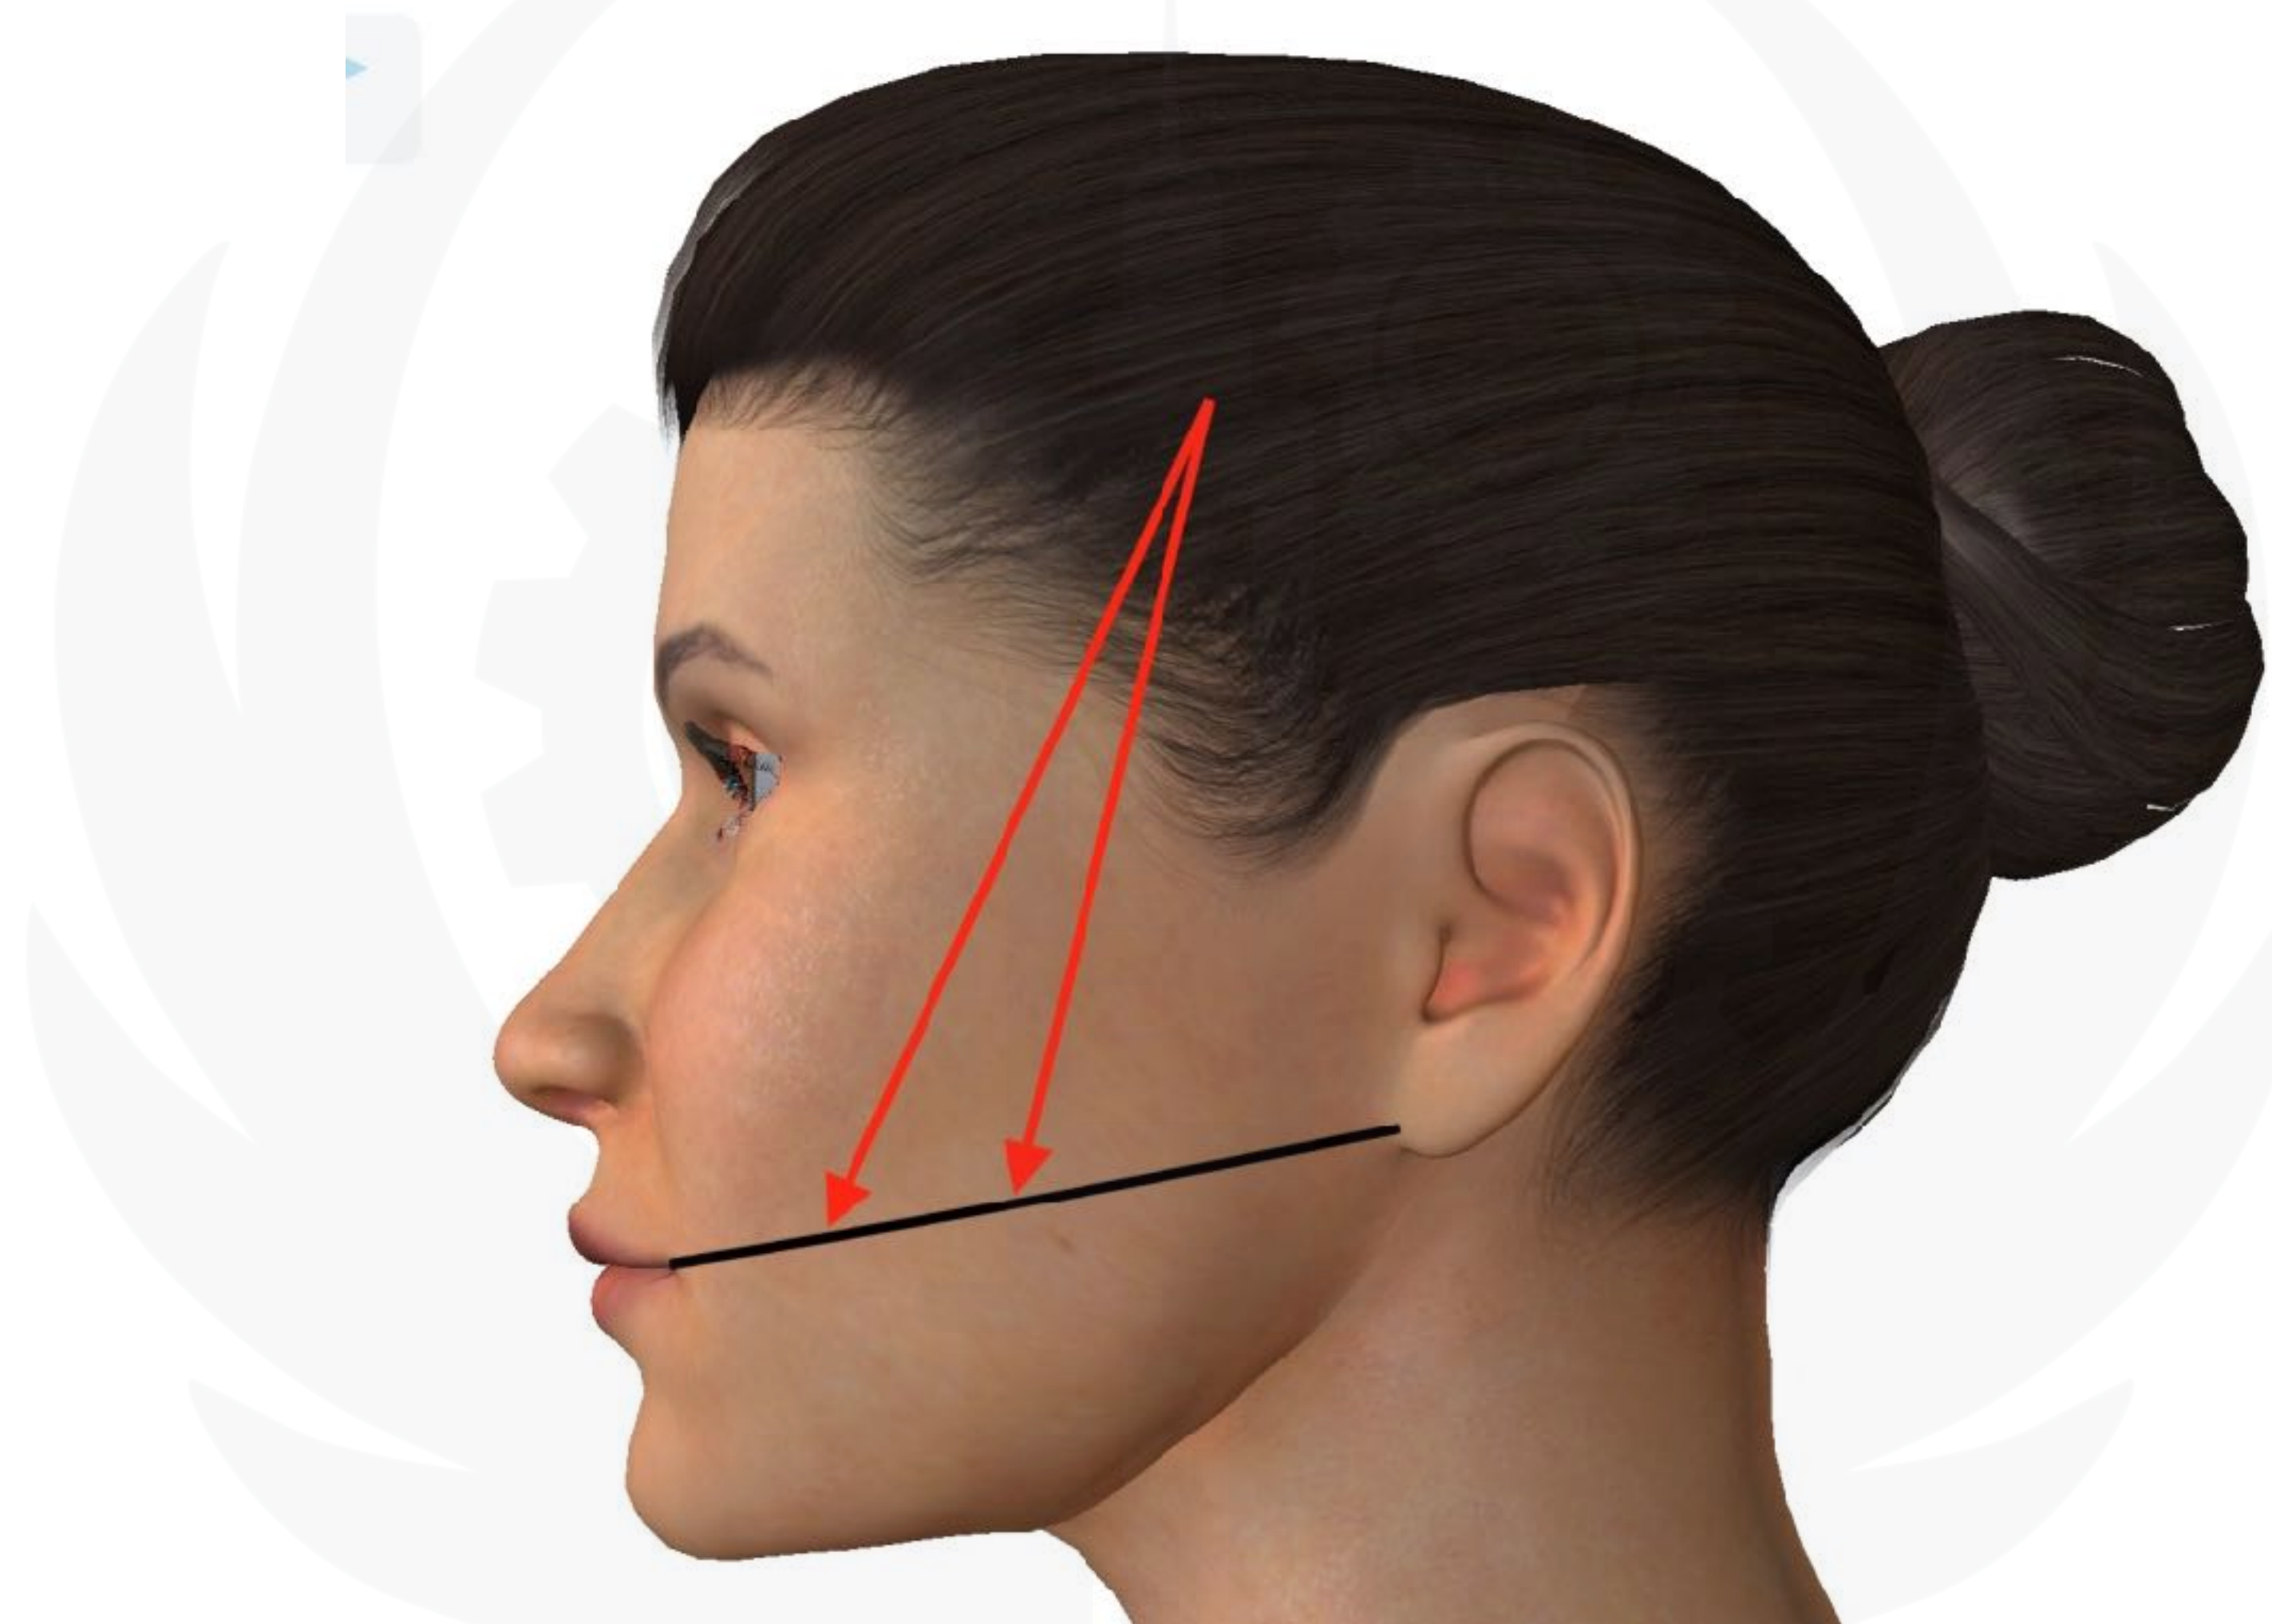


Установка нитей методом
«V образная фиксация»

СХЕМА ИМПЛАНТАЦИИ Mint Lift 43 или Mint Easy Blunt

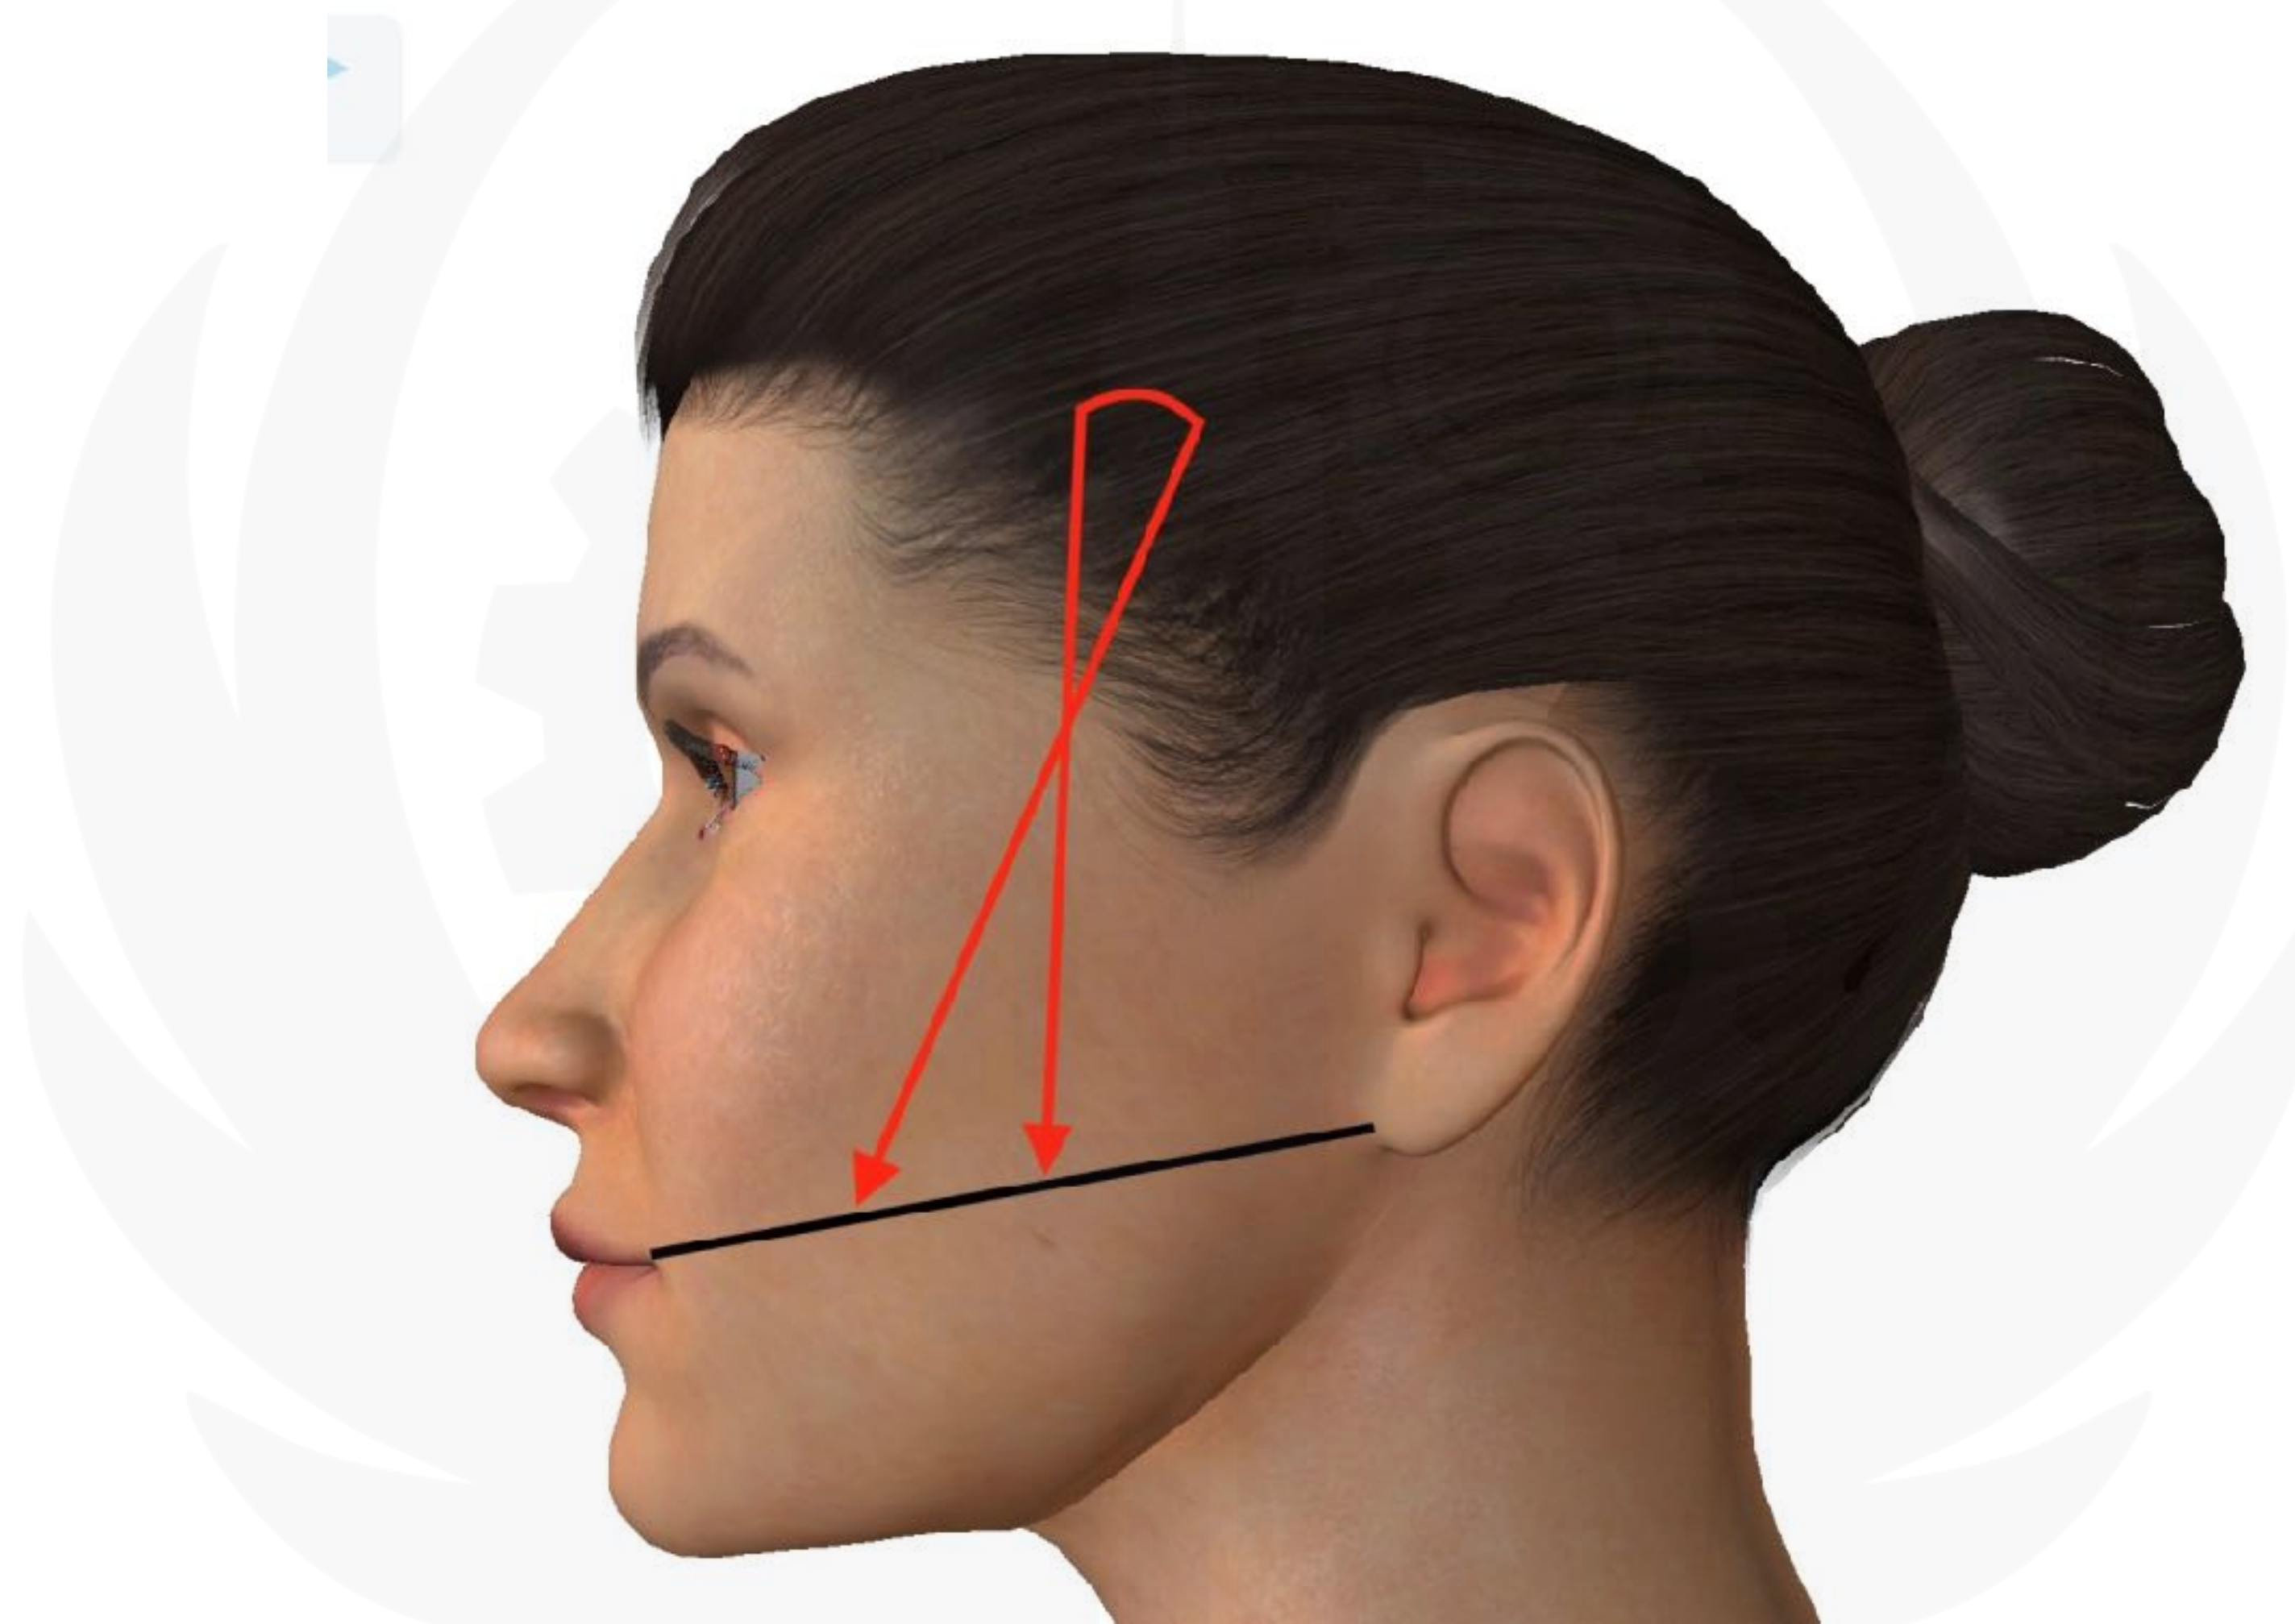


Установка нитей методом
«Хобранная фиксация»

СХЕМА ИМПЛАНТАЦИИ Mint Lift 43

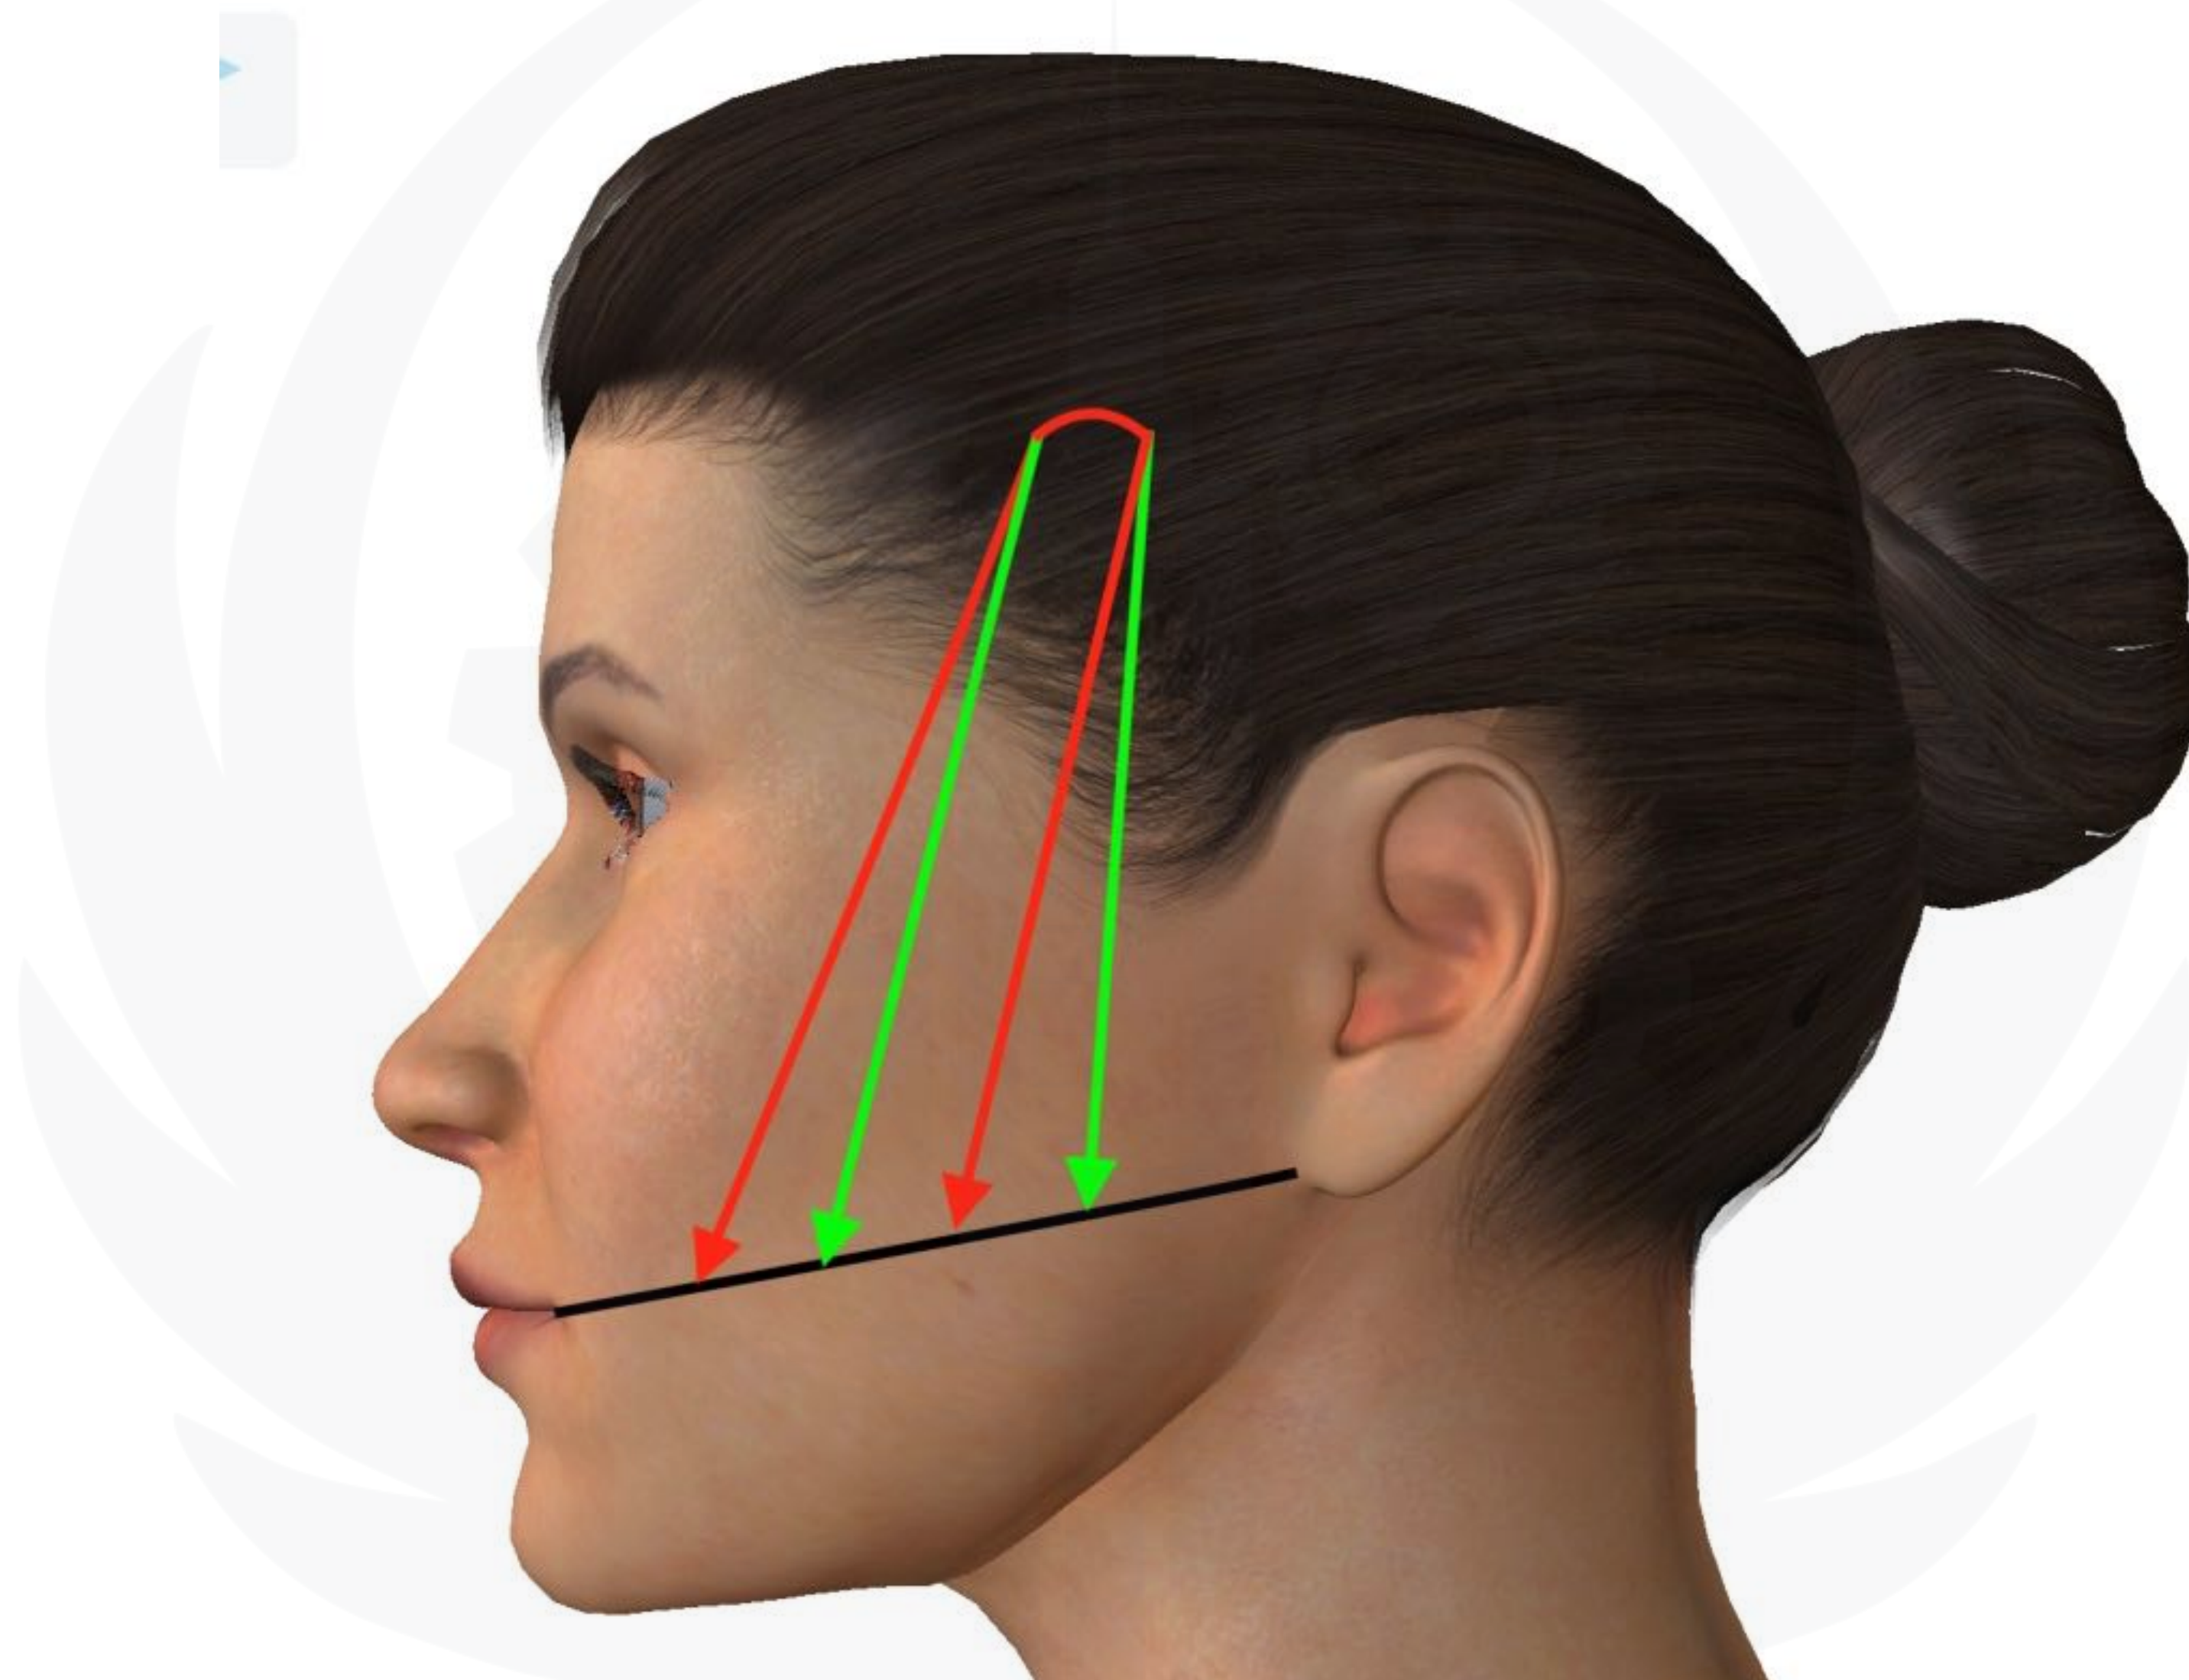


Установка нитей методом
«двойная V образная фиксация»

СХЕМА ИМПЛАНТАЦИИ Mint Lift 43 или Mint Easy Blunt

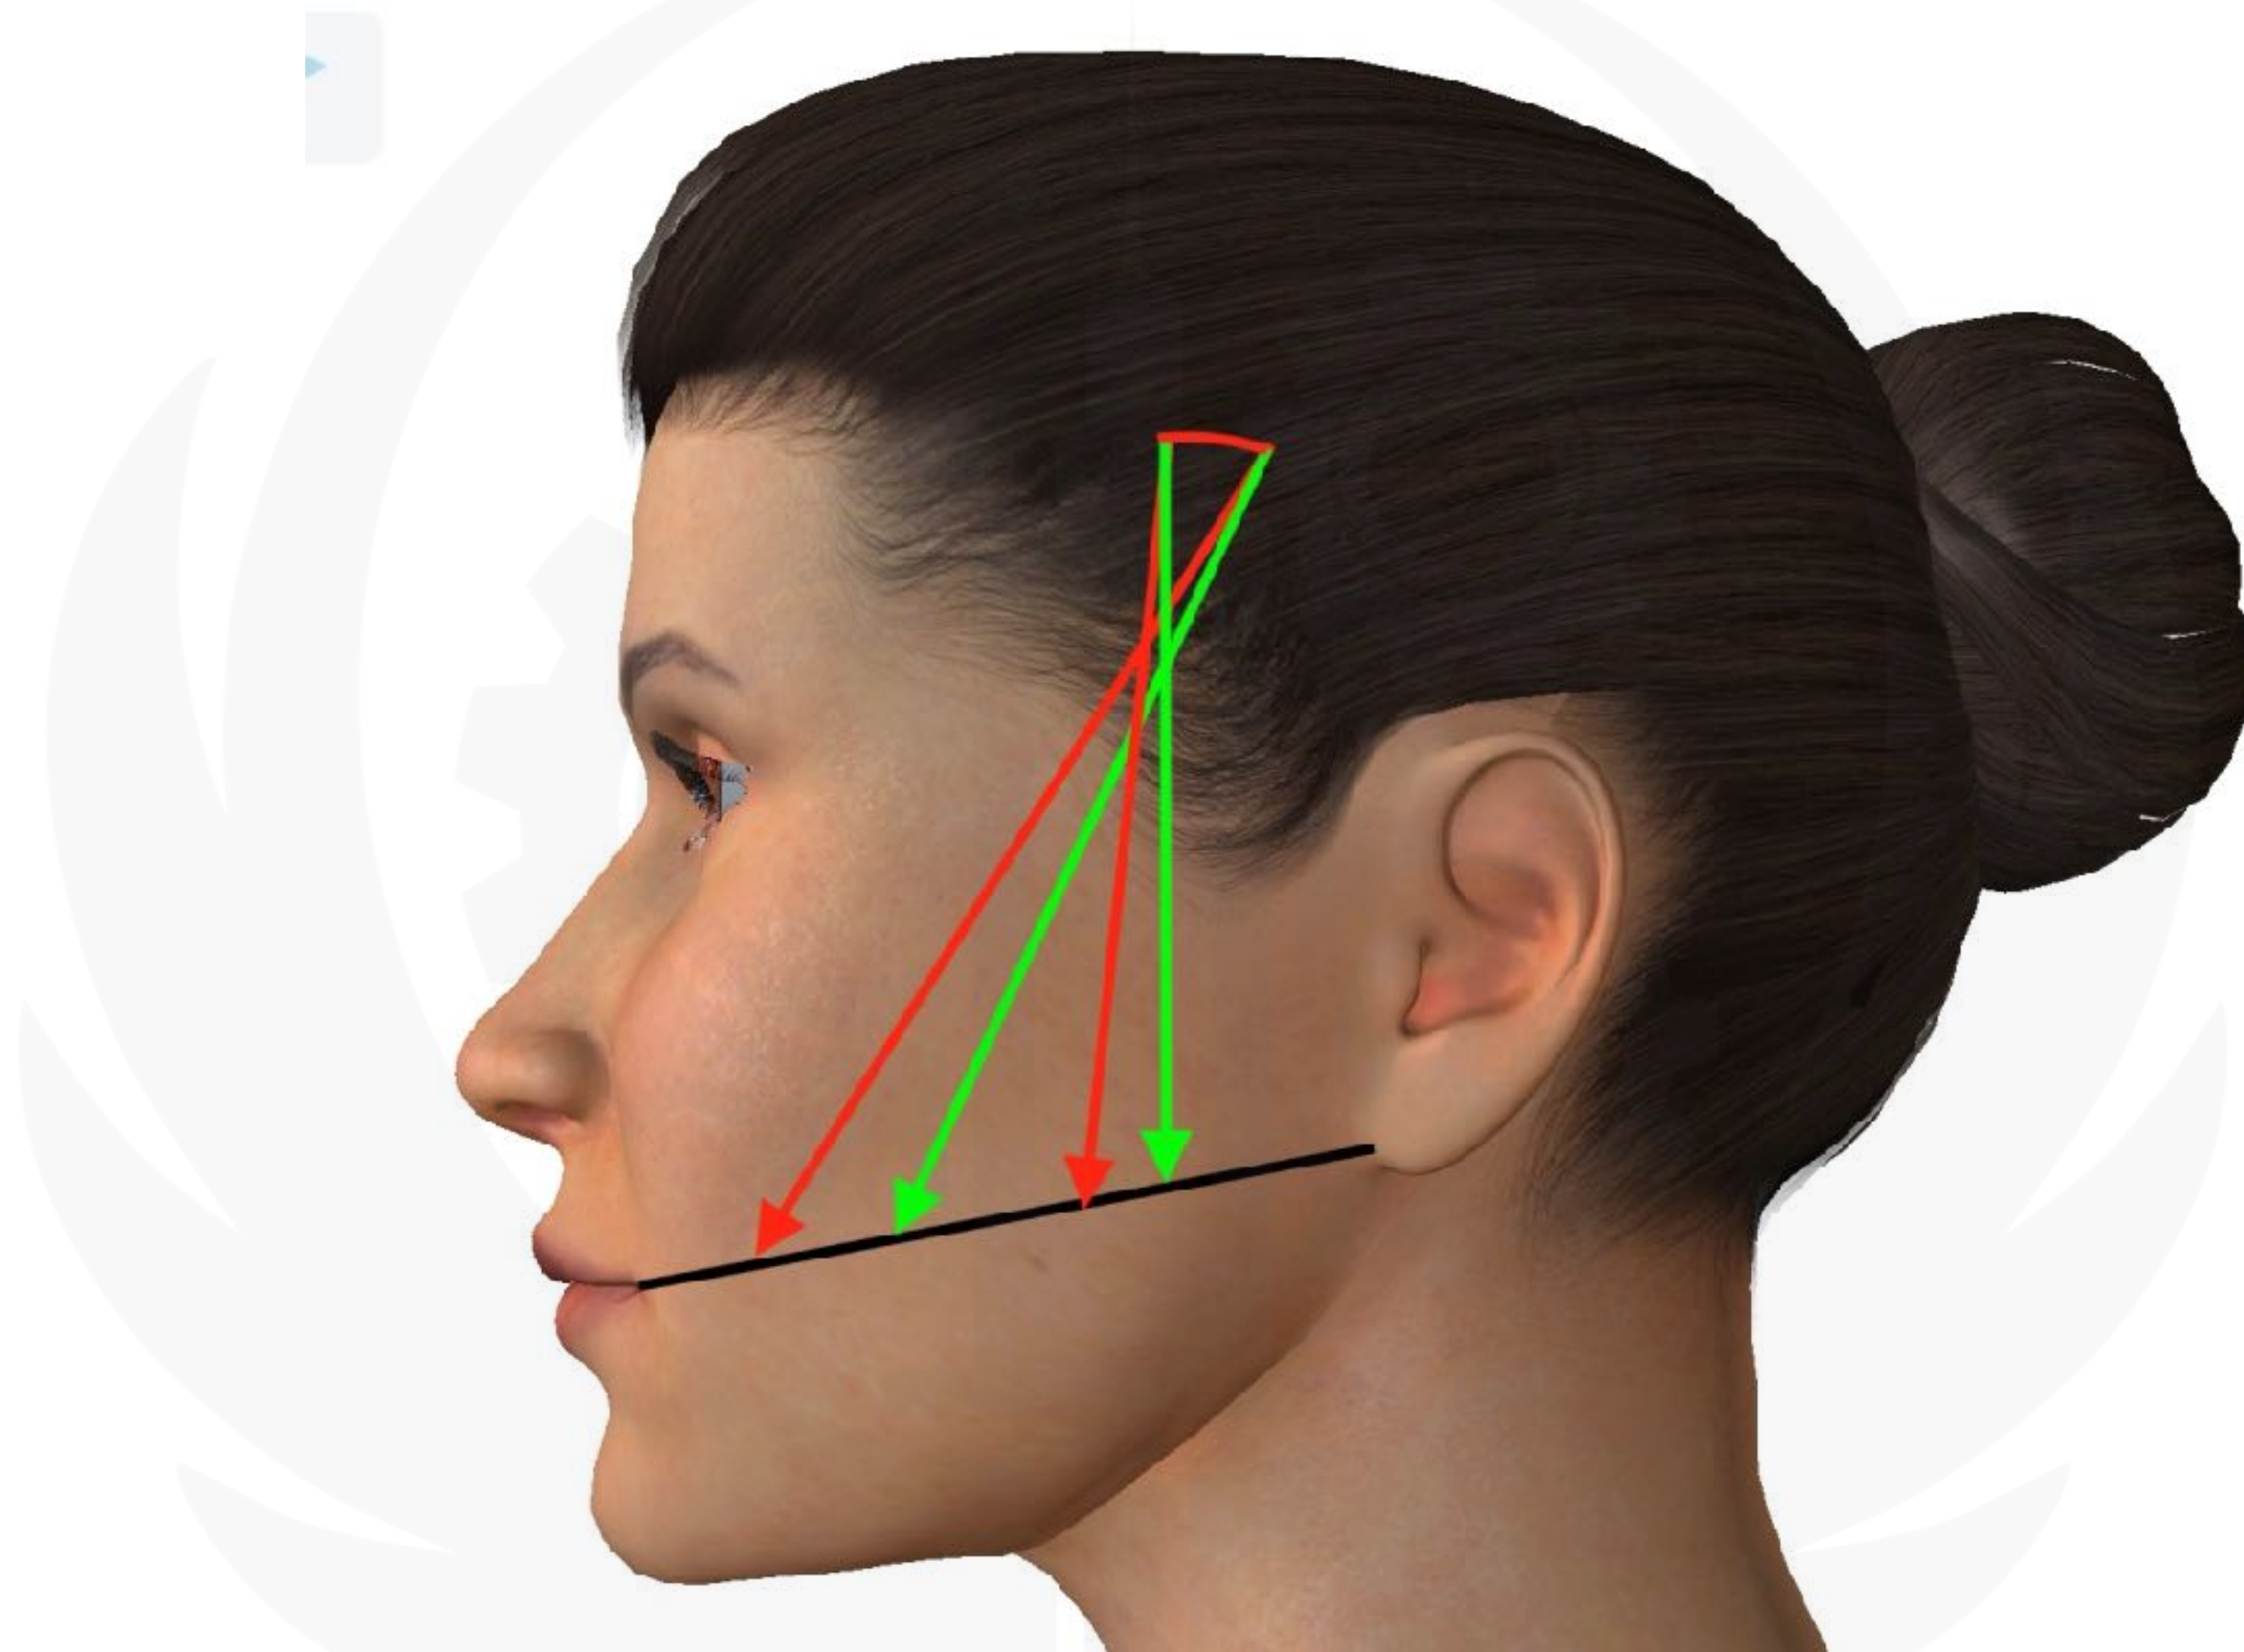


Установка нитей методом
«двойная Х-образная фиксация»

СХЕМА ИМПЛАНТАЦИИ Mint Lift 43 или Mint Easy Blunt

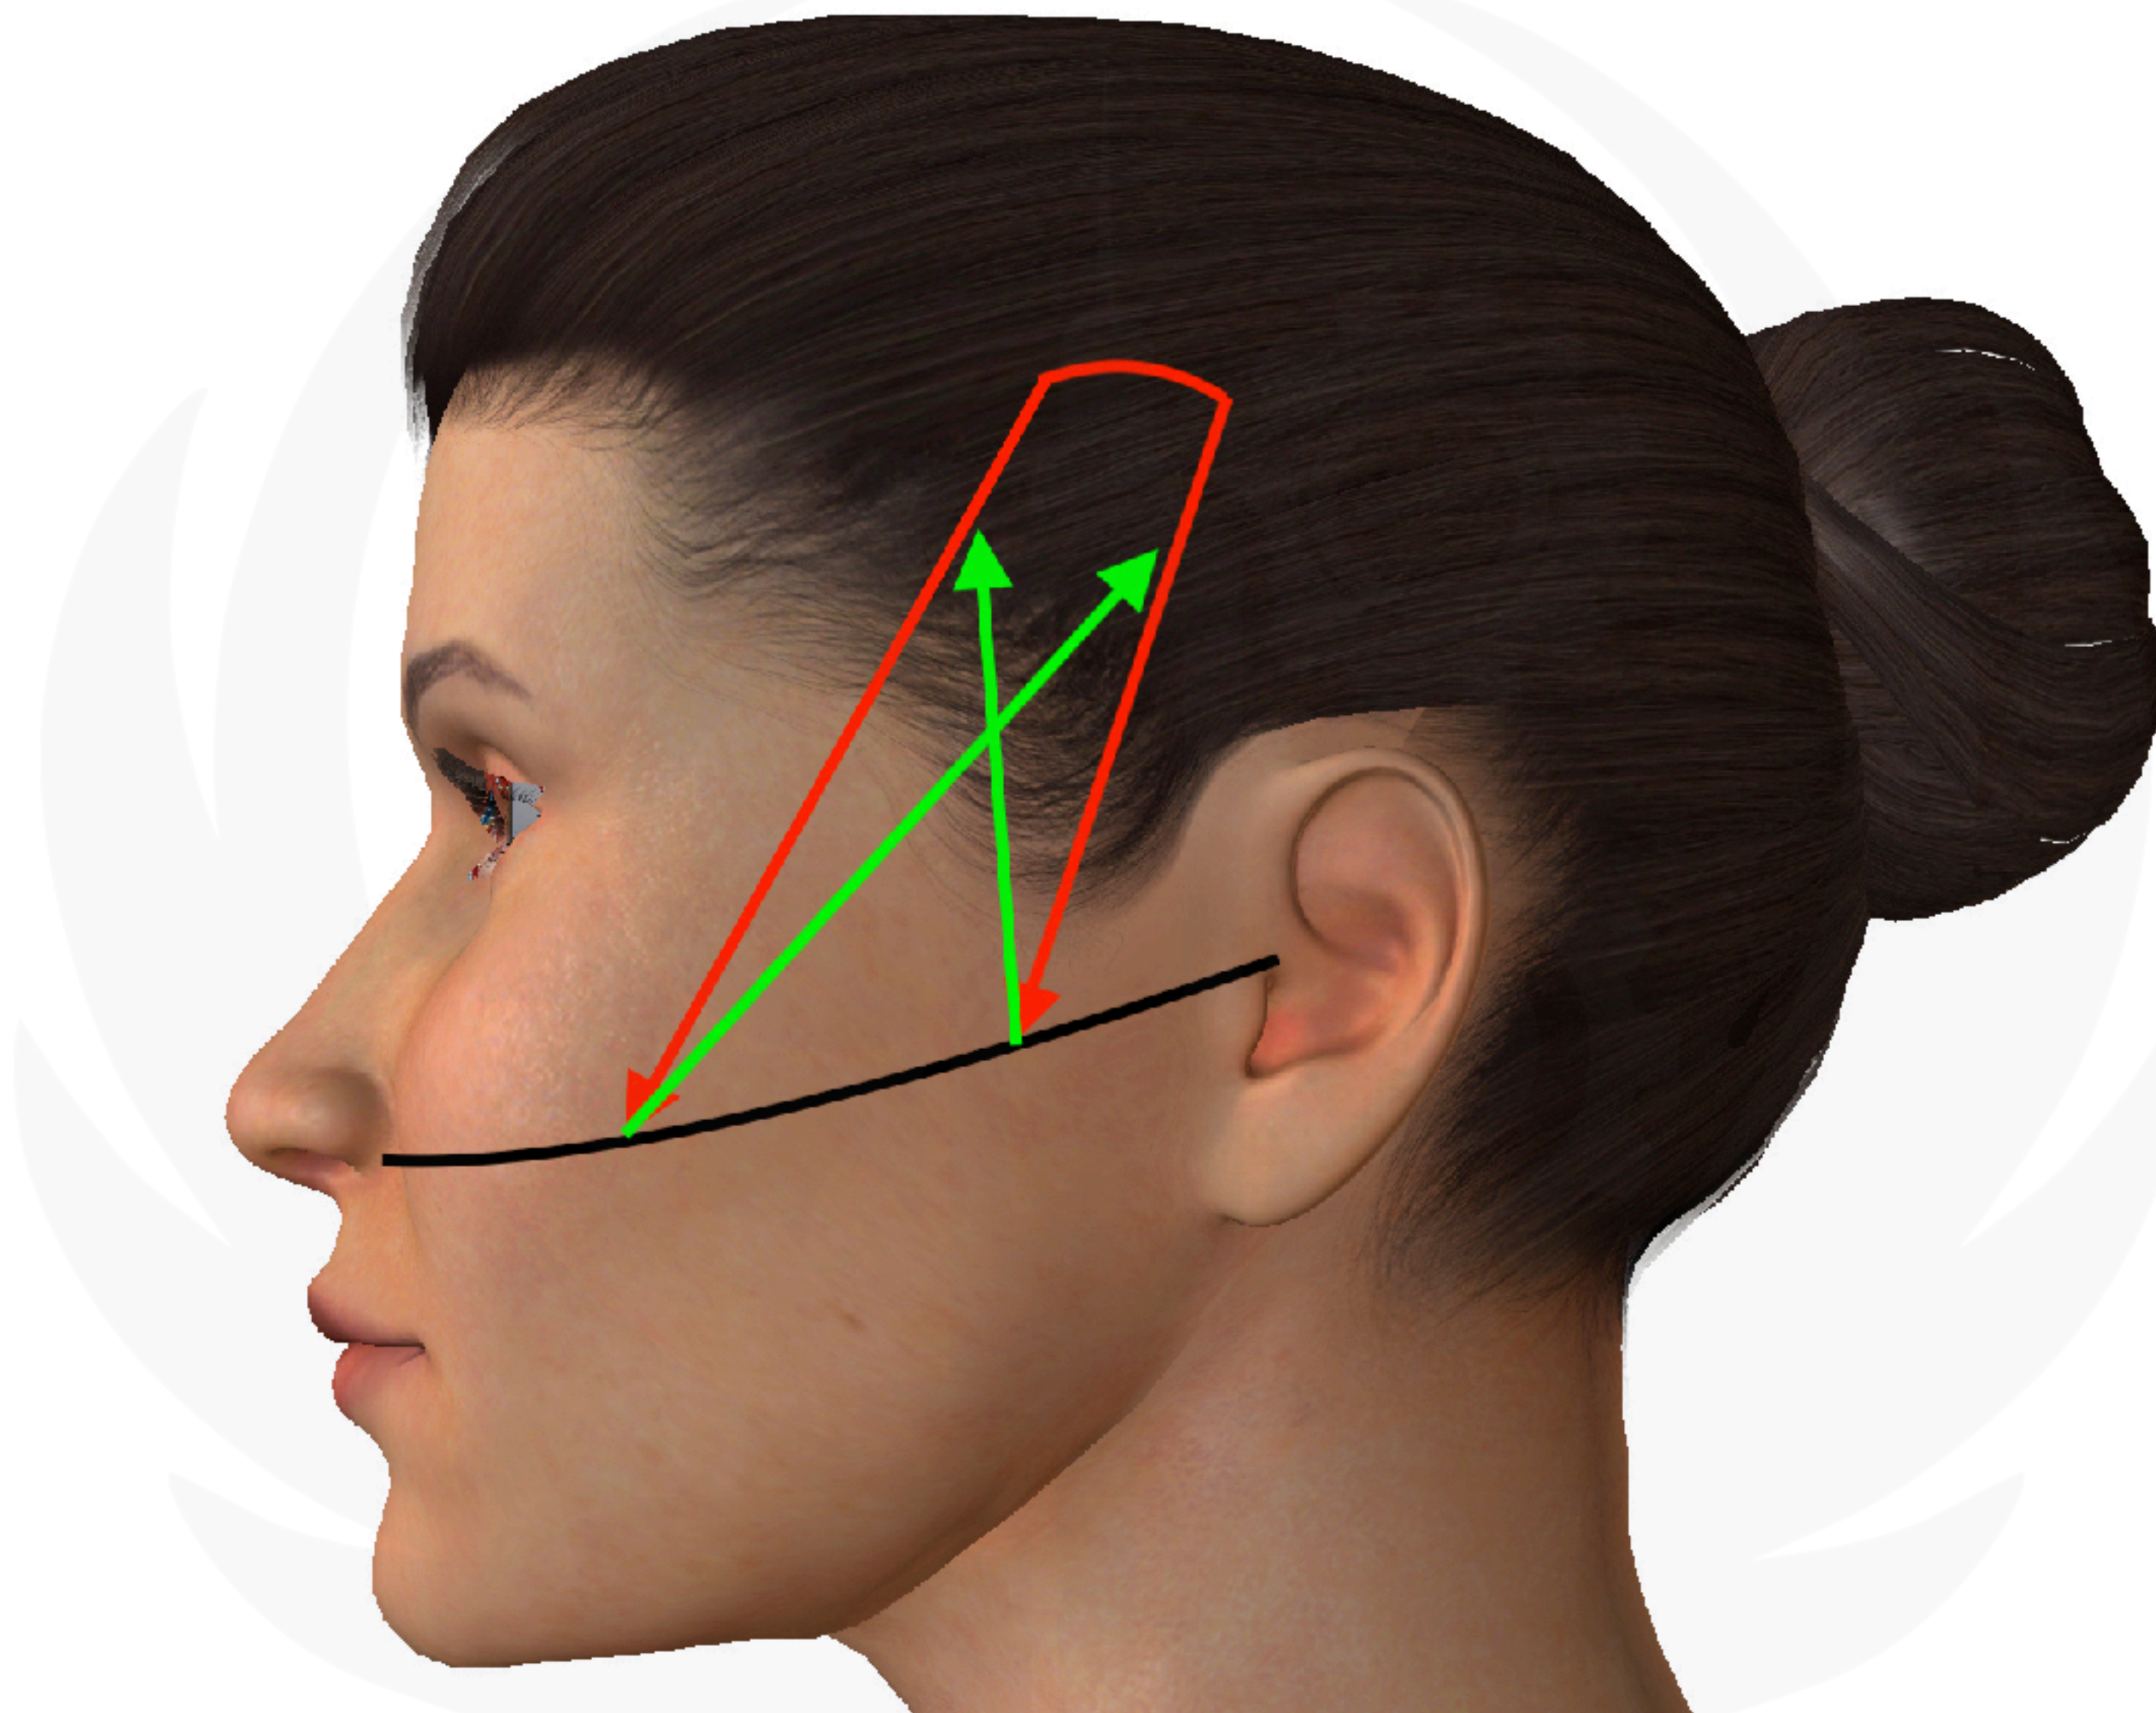


Установка нитей методом
«П - образная фиксация»

СХЕМА ИМПЛАНТАЦИИ Mint Lift 43

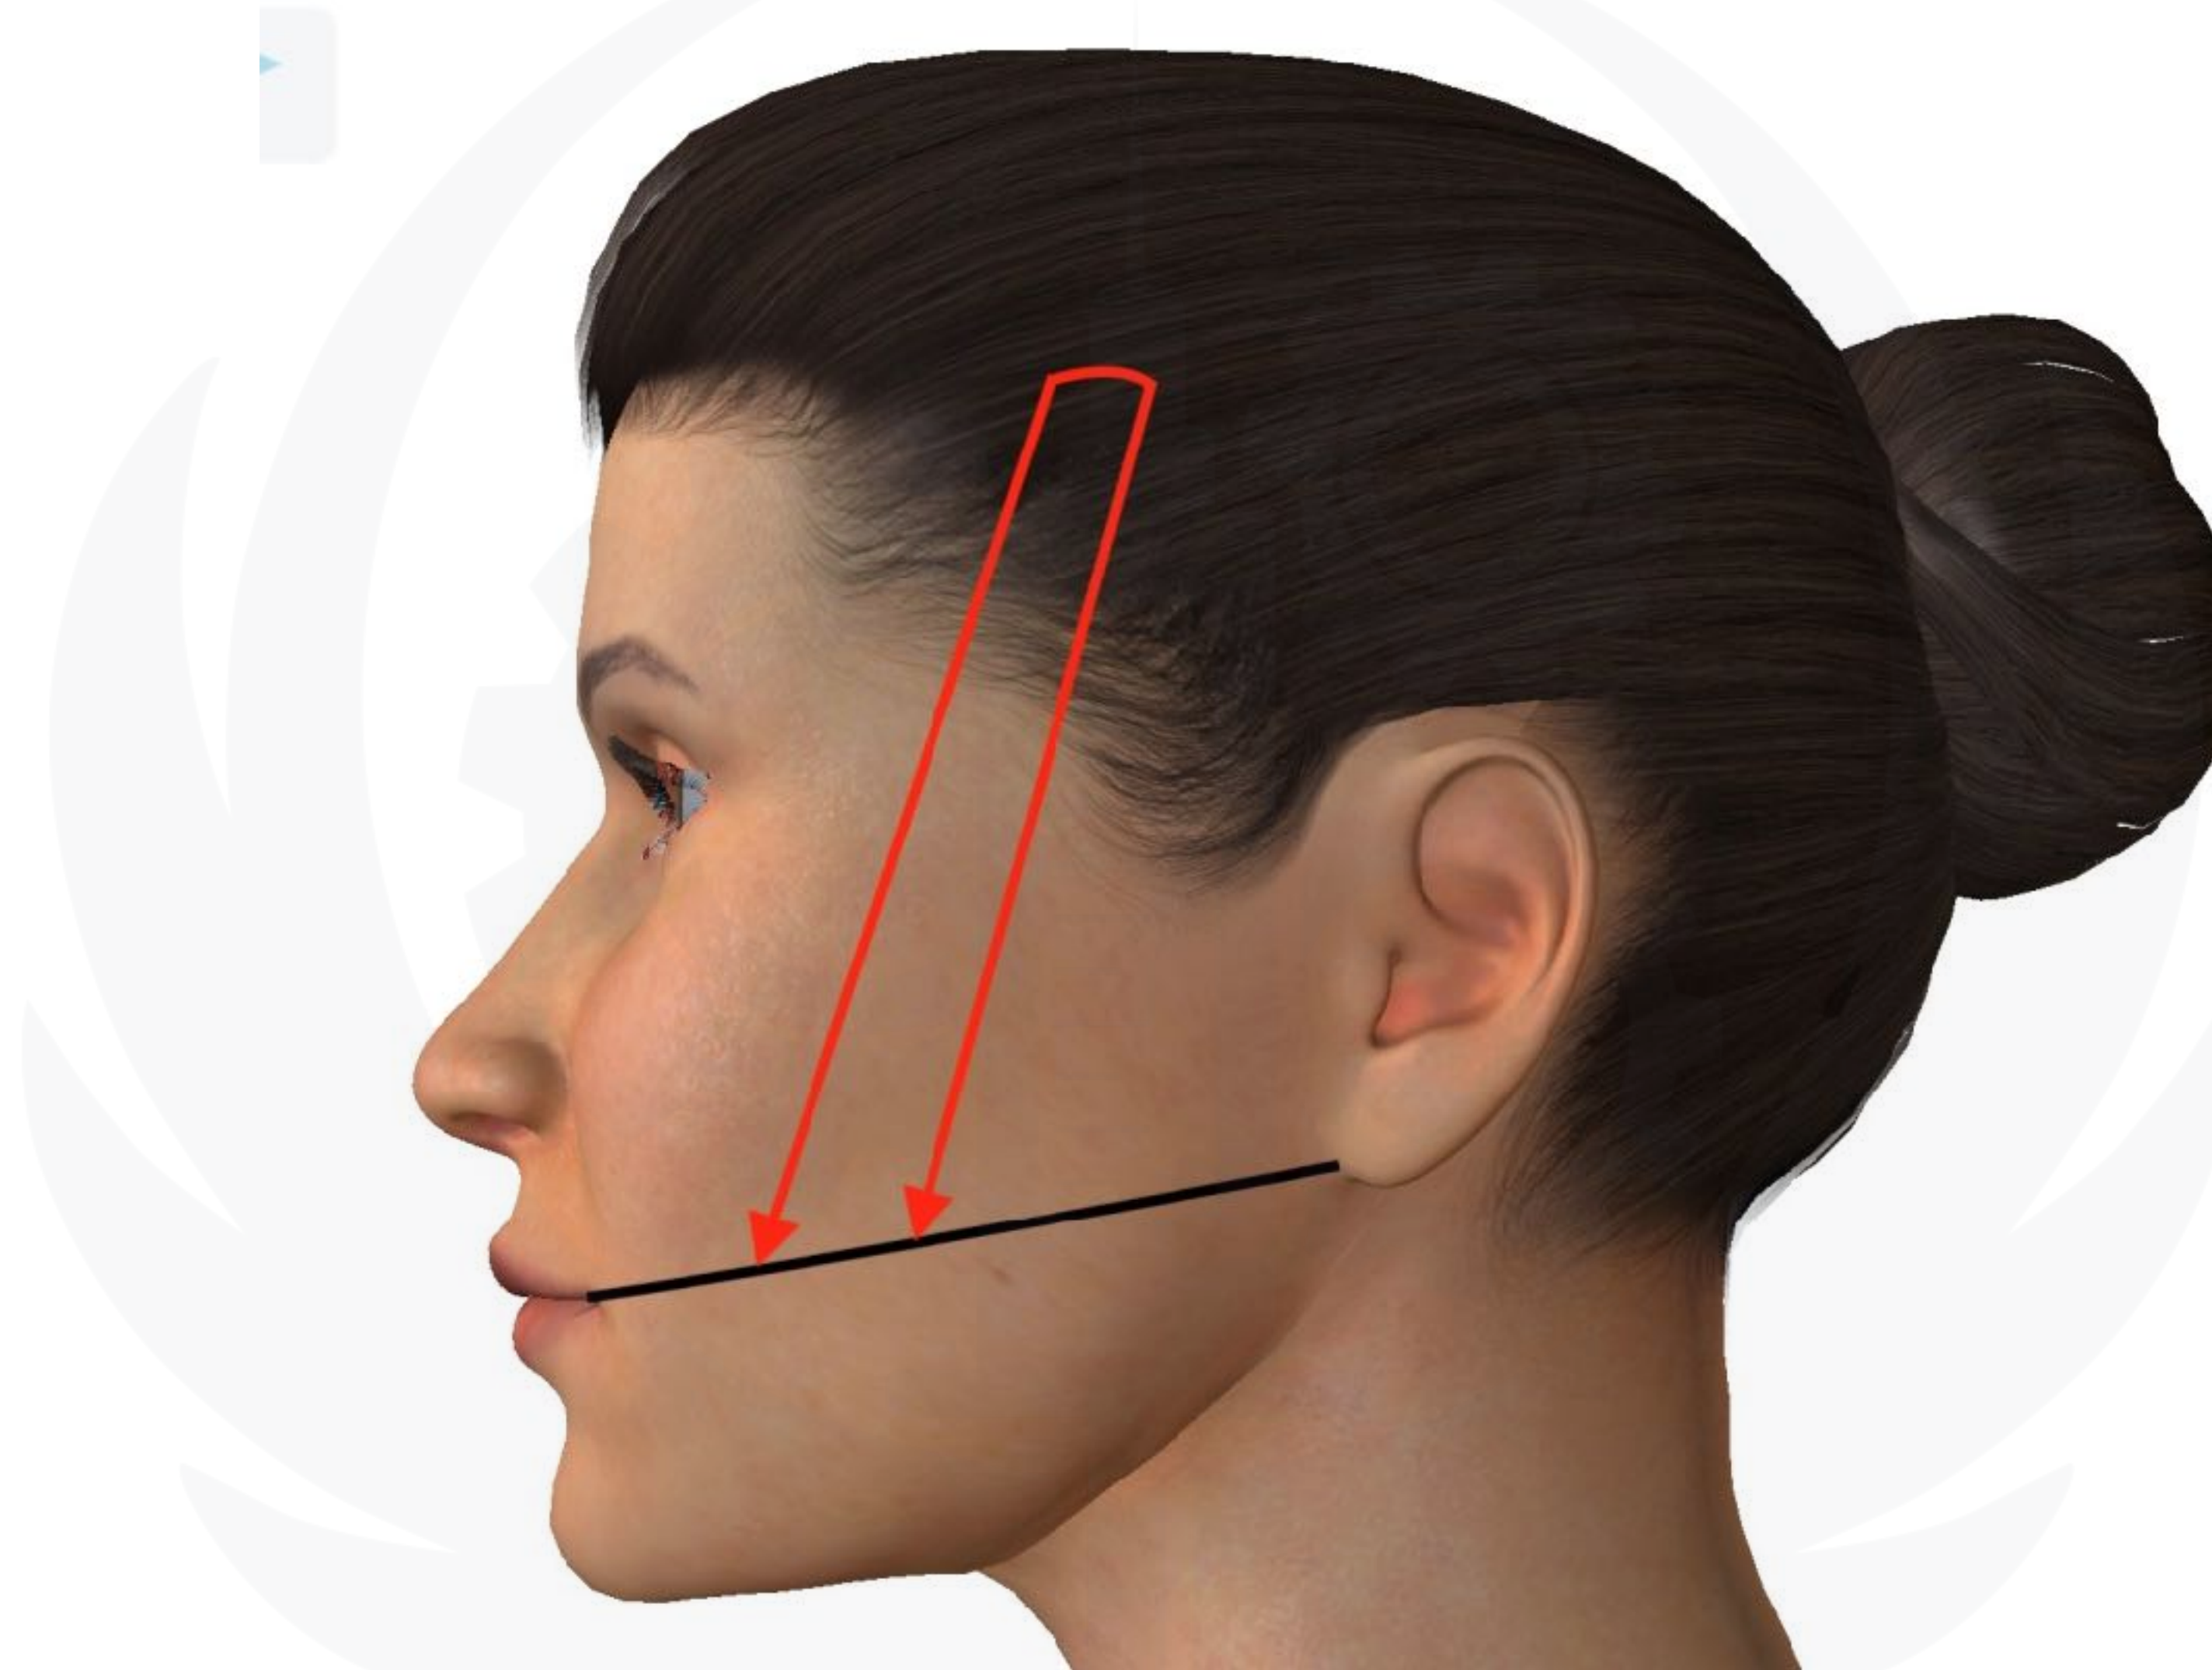


Установка нитей методом
«П - образная фиксация»

СХЕМА ИМПЛАНТАЦИИ Mint Easy

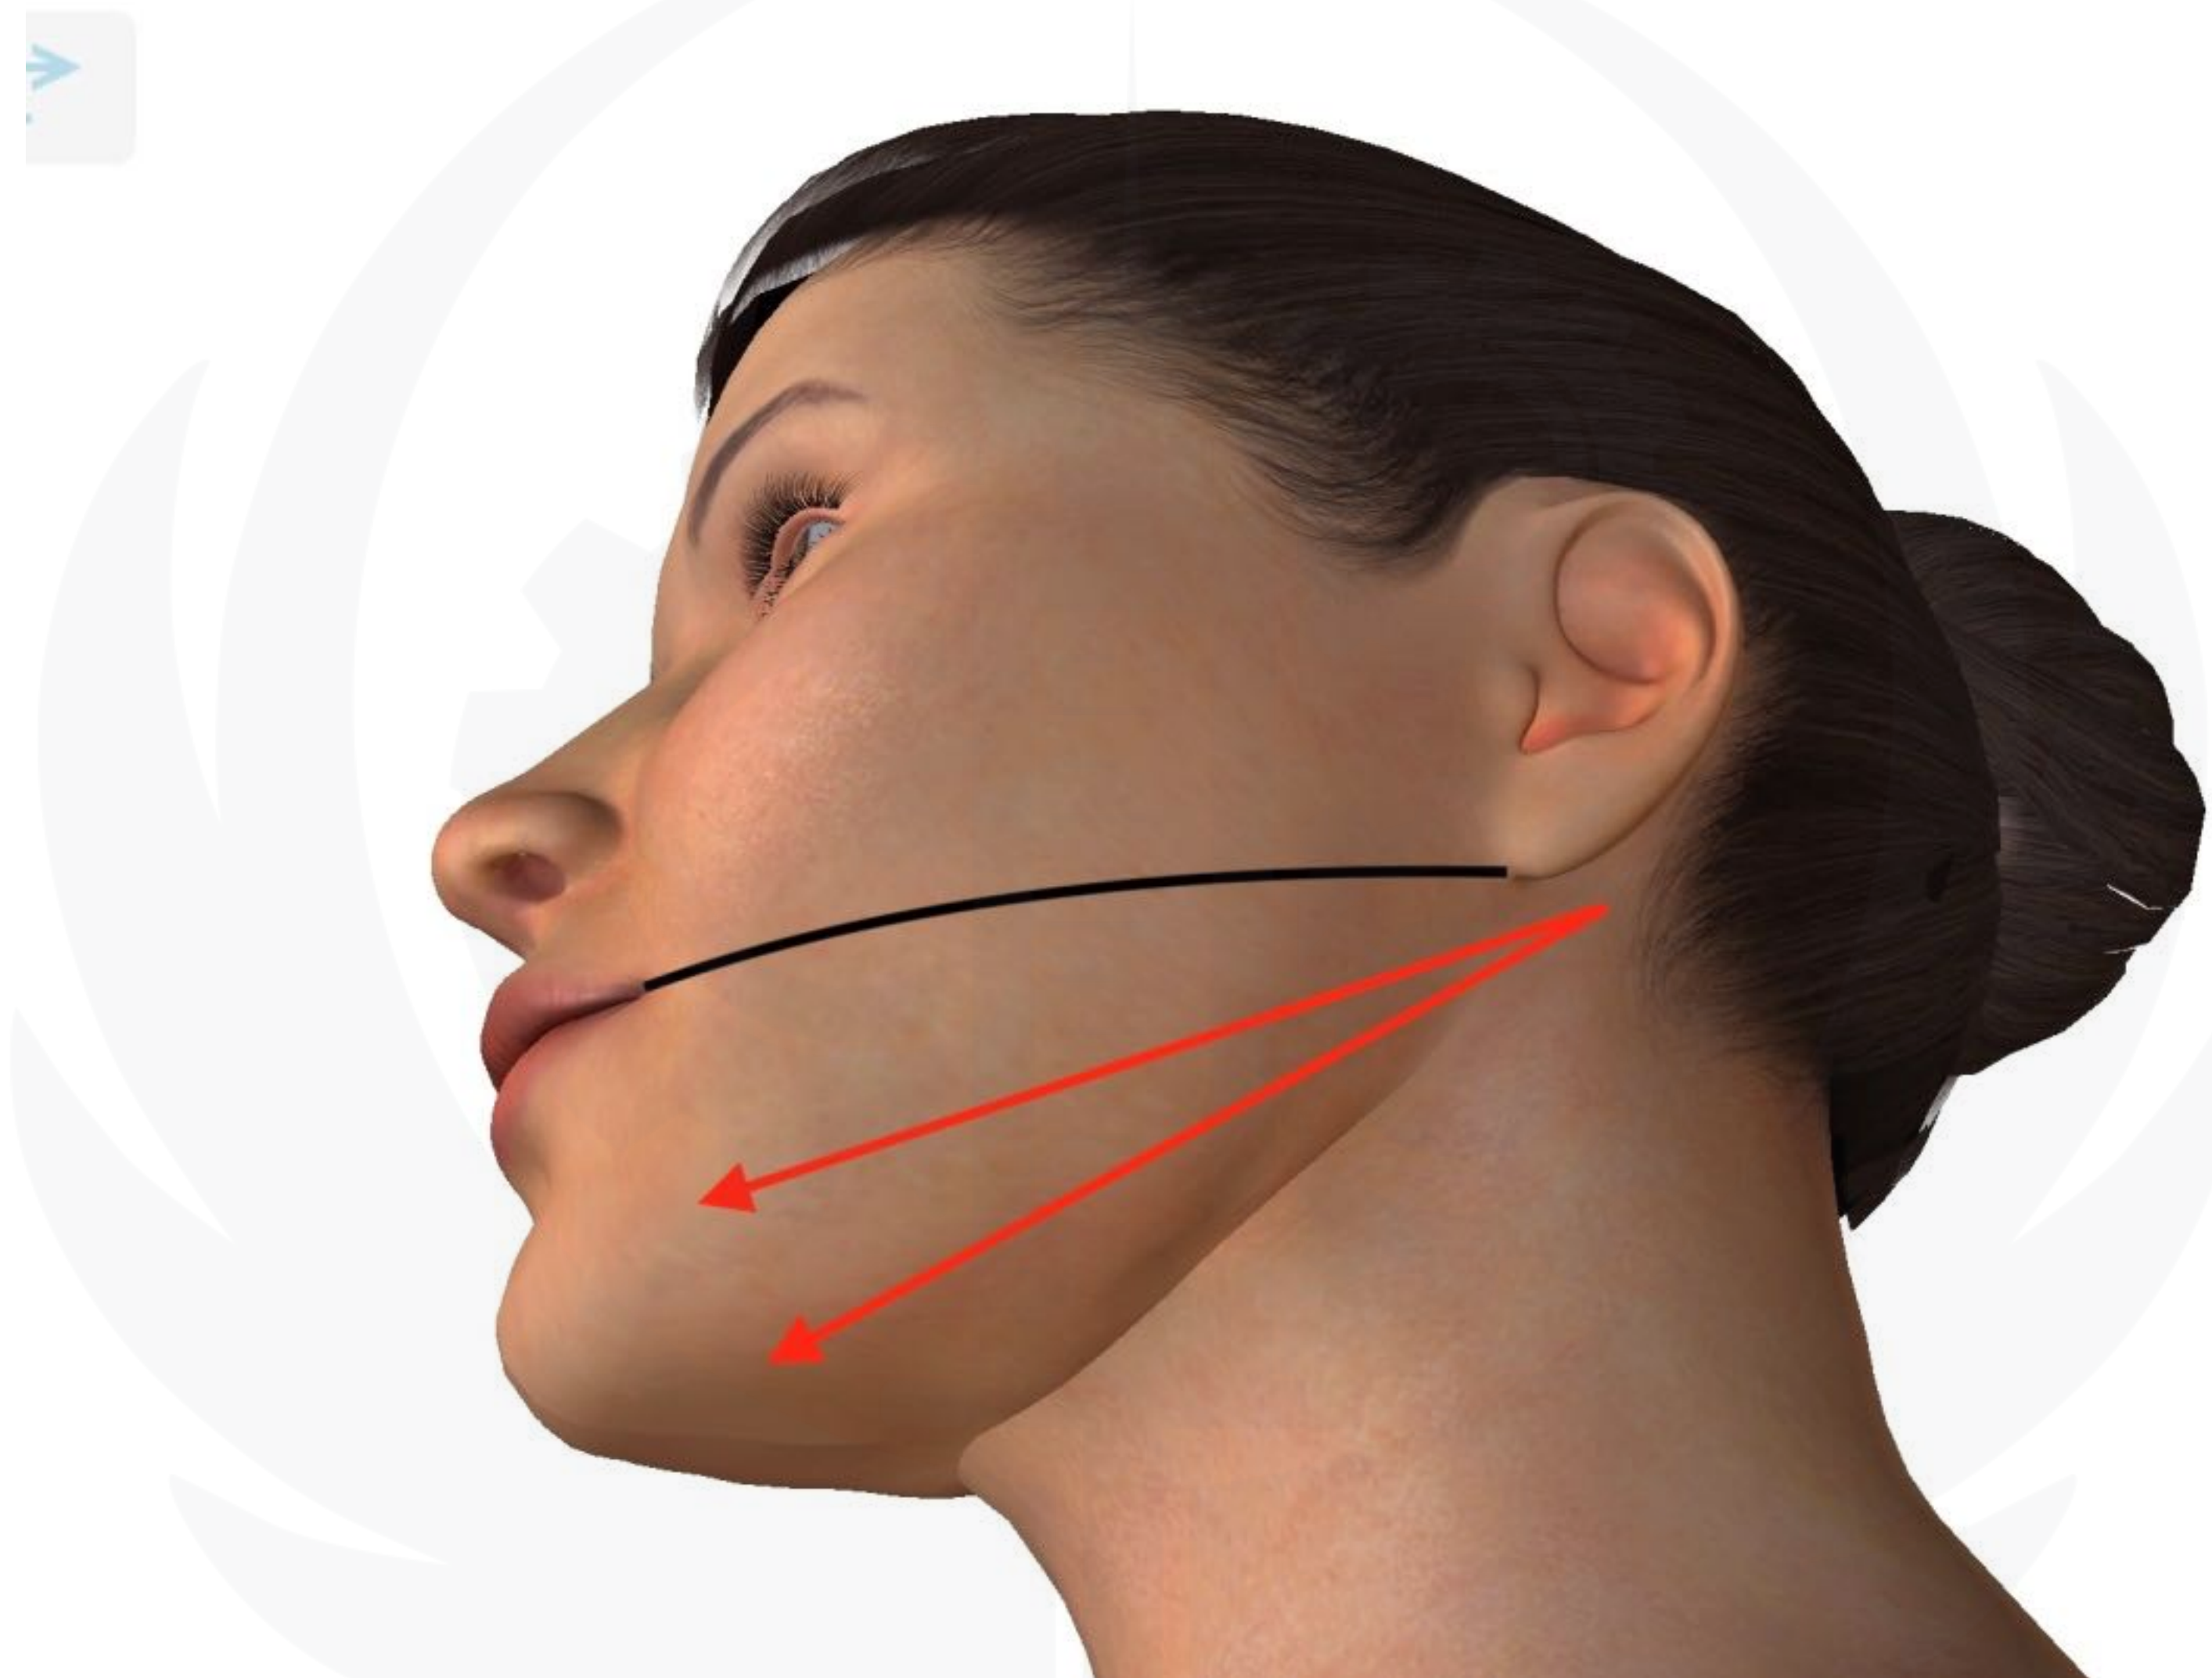


Установка нитей методом
«схема лифтинга нижней трети»

СХЕМА ИМПЛАНТАЦИИ Mint Easy

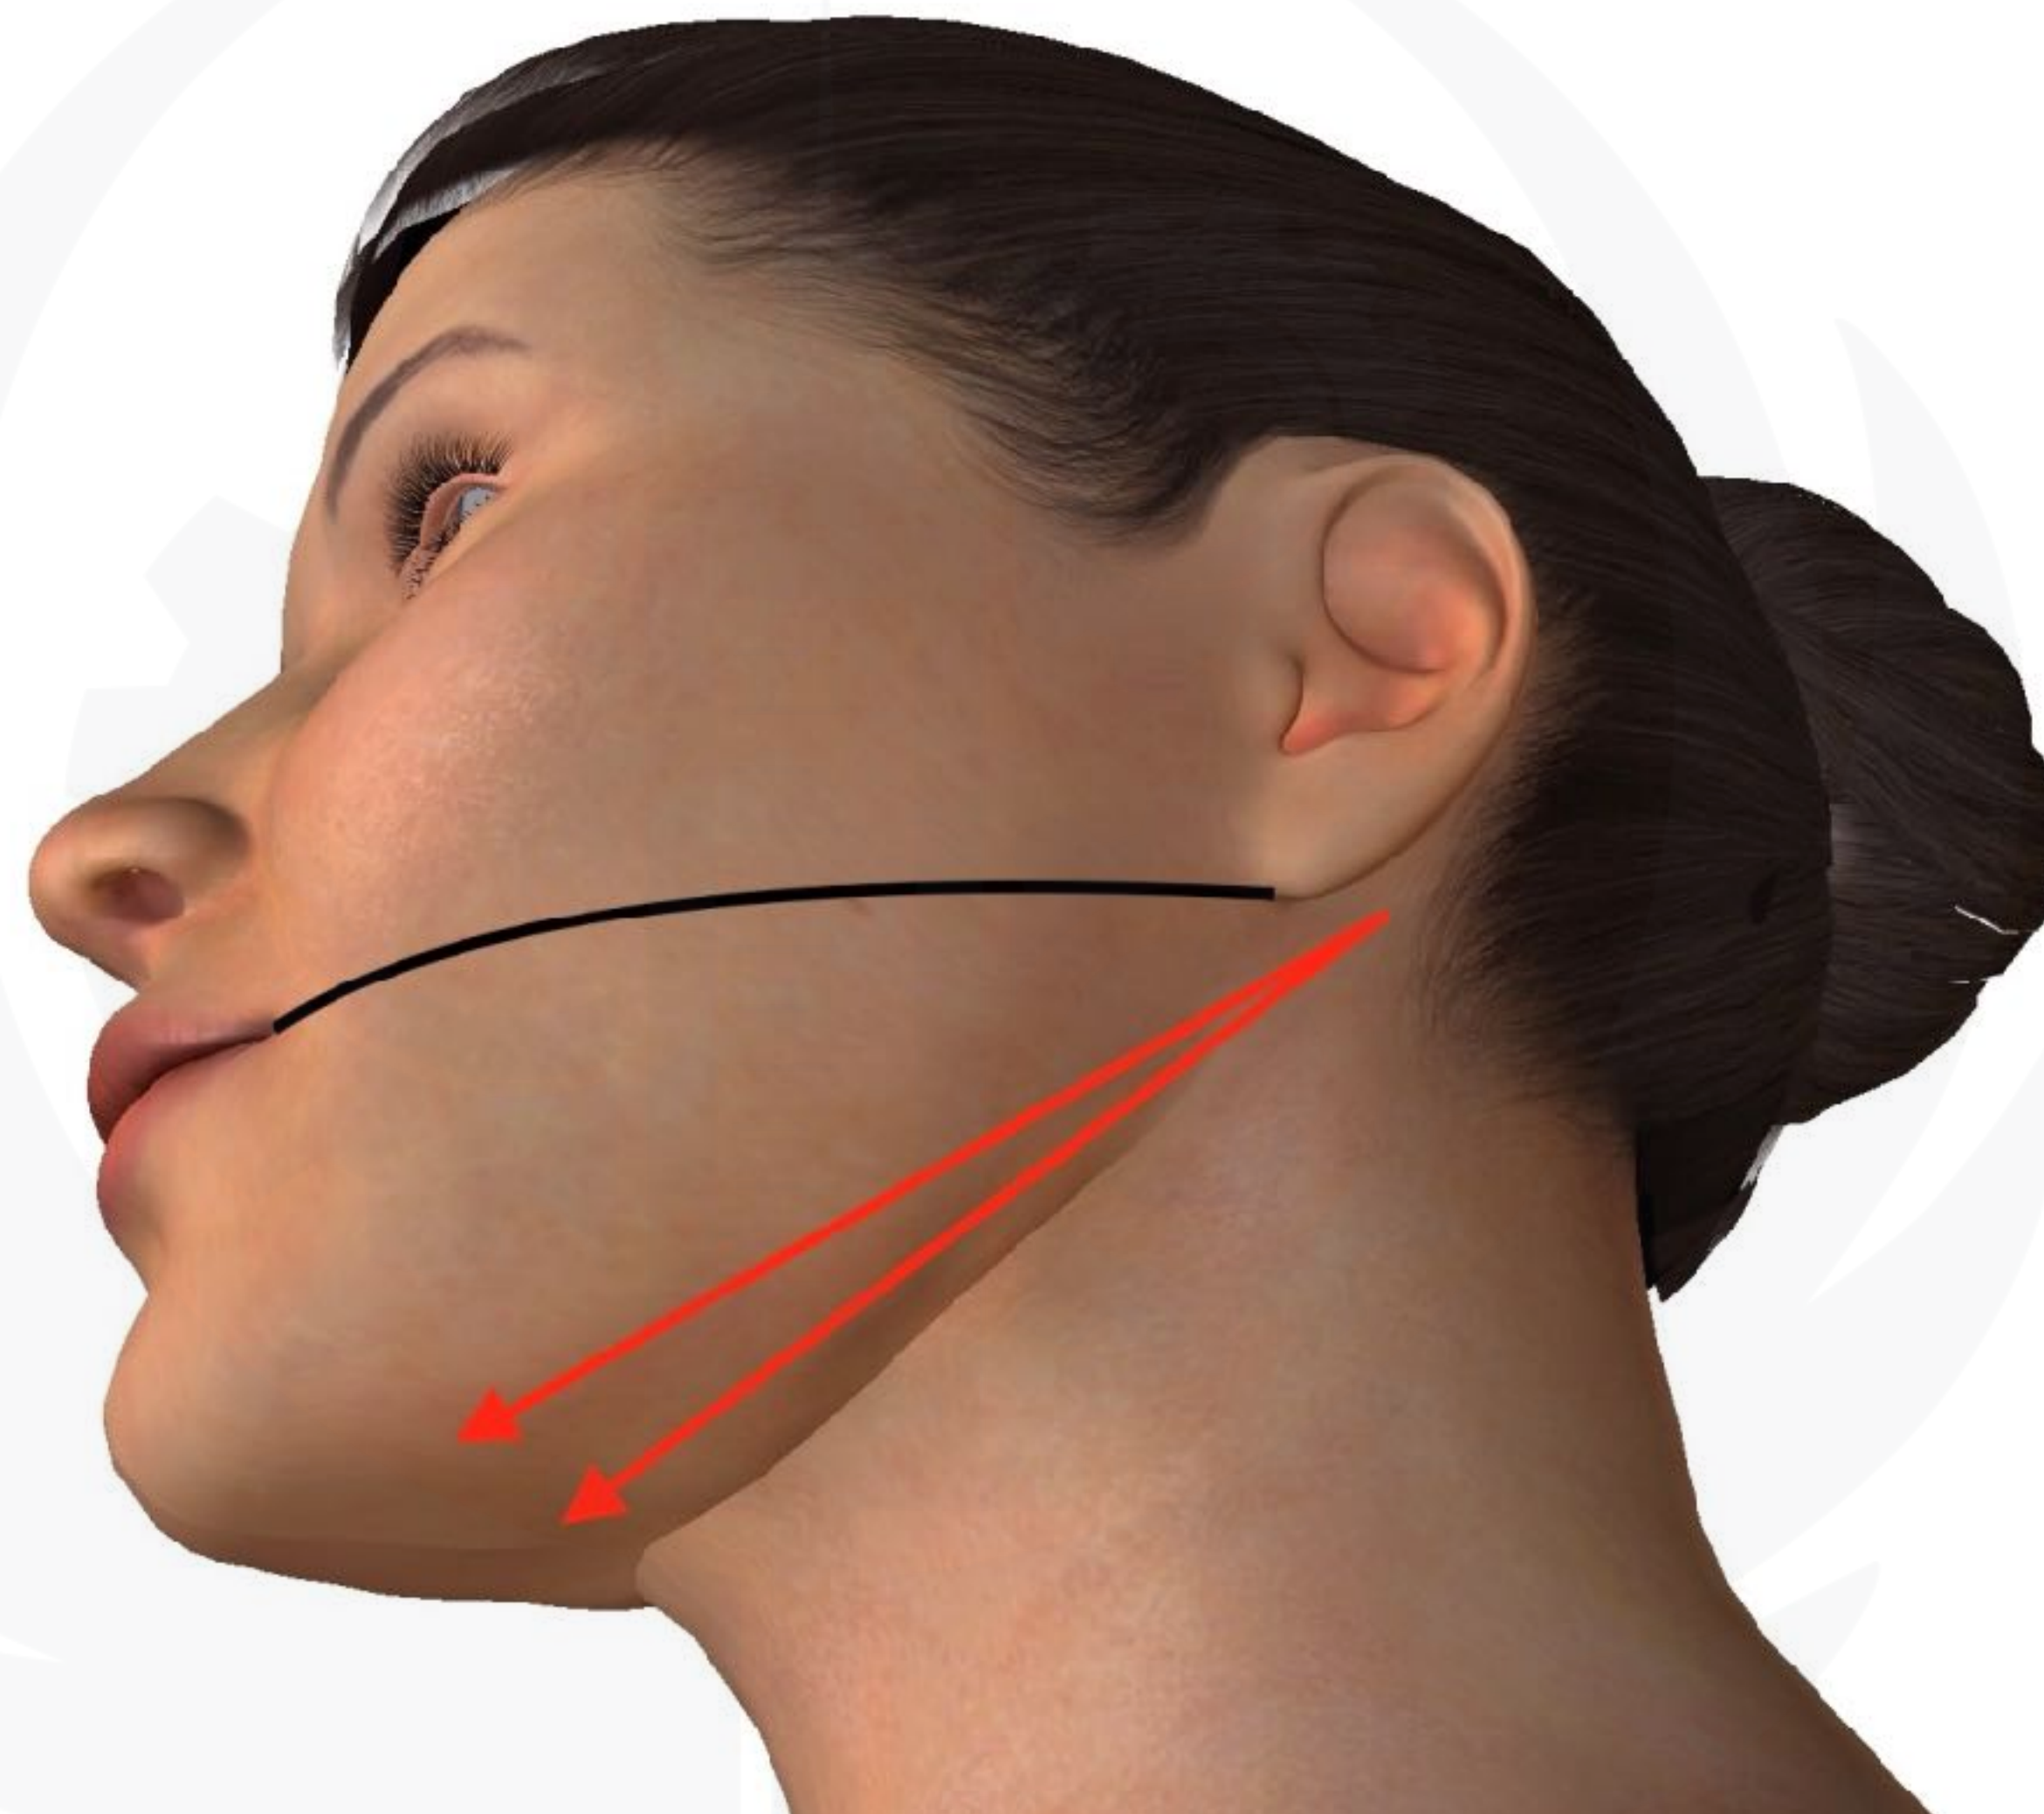


Установка нитей методом
«лифтинг субментальной зоны»

СХЕМА ИМПЛАНТАЦИИ Mint mini или Mint Fine

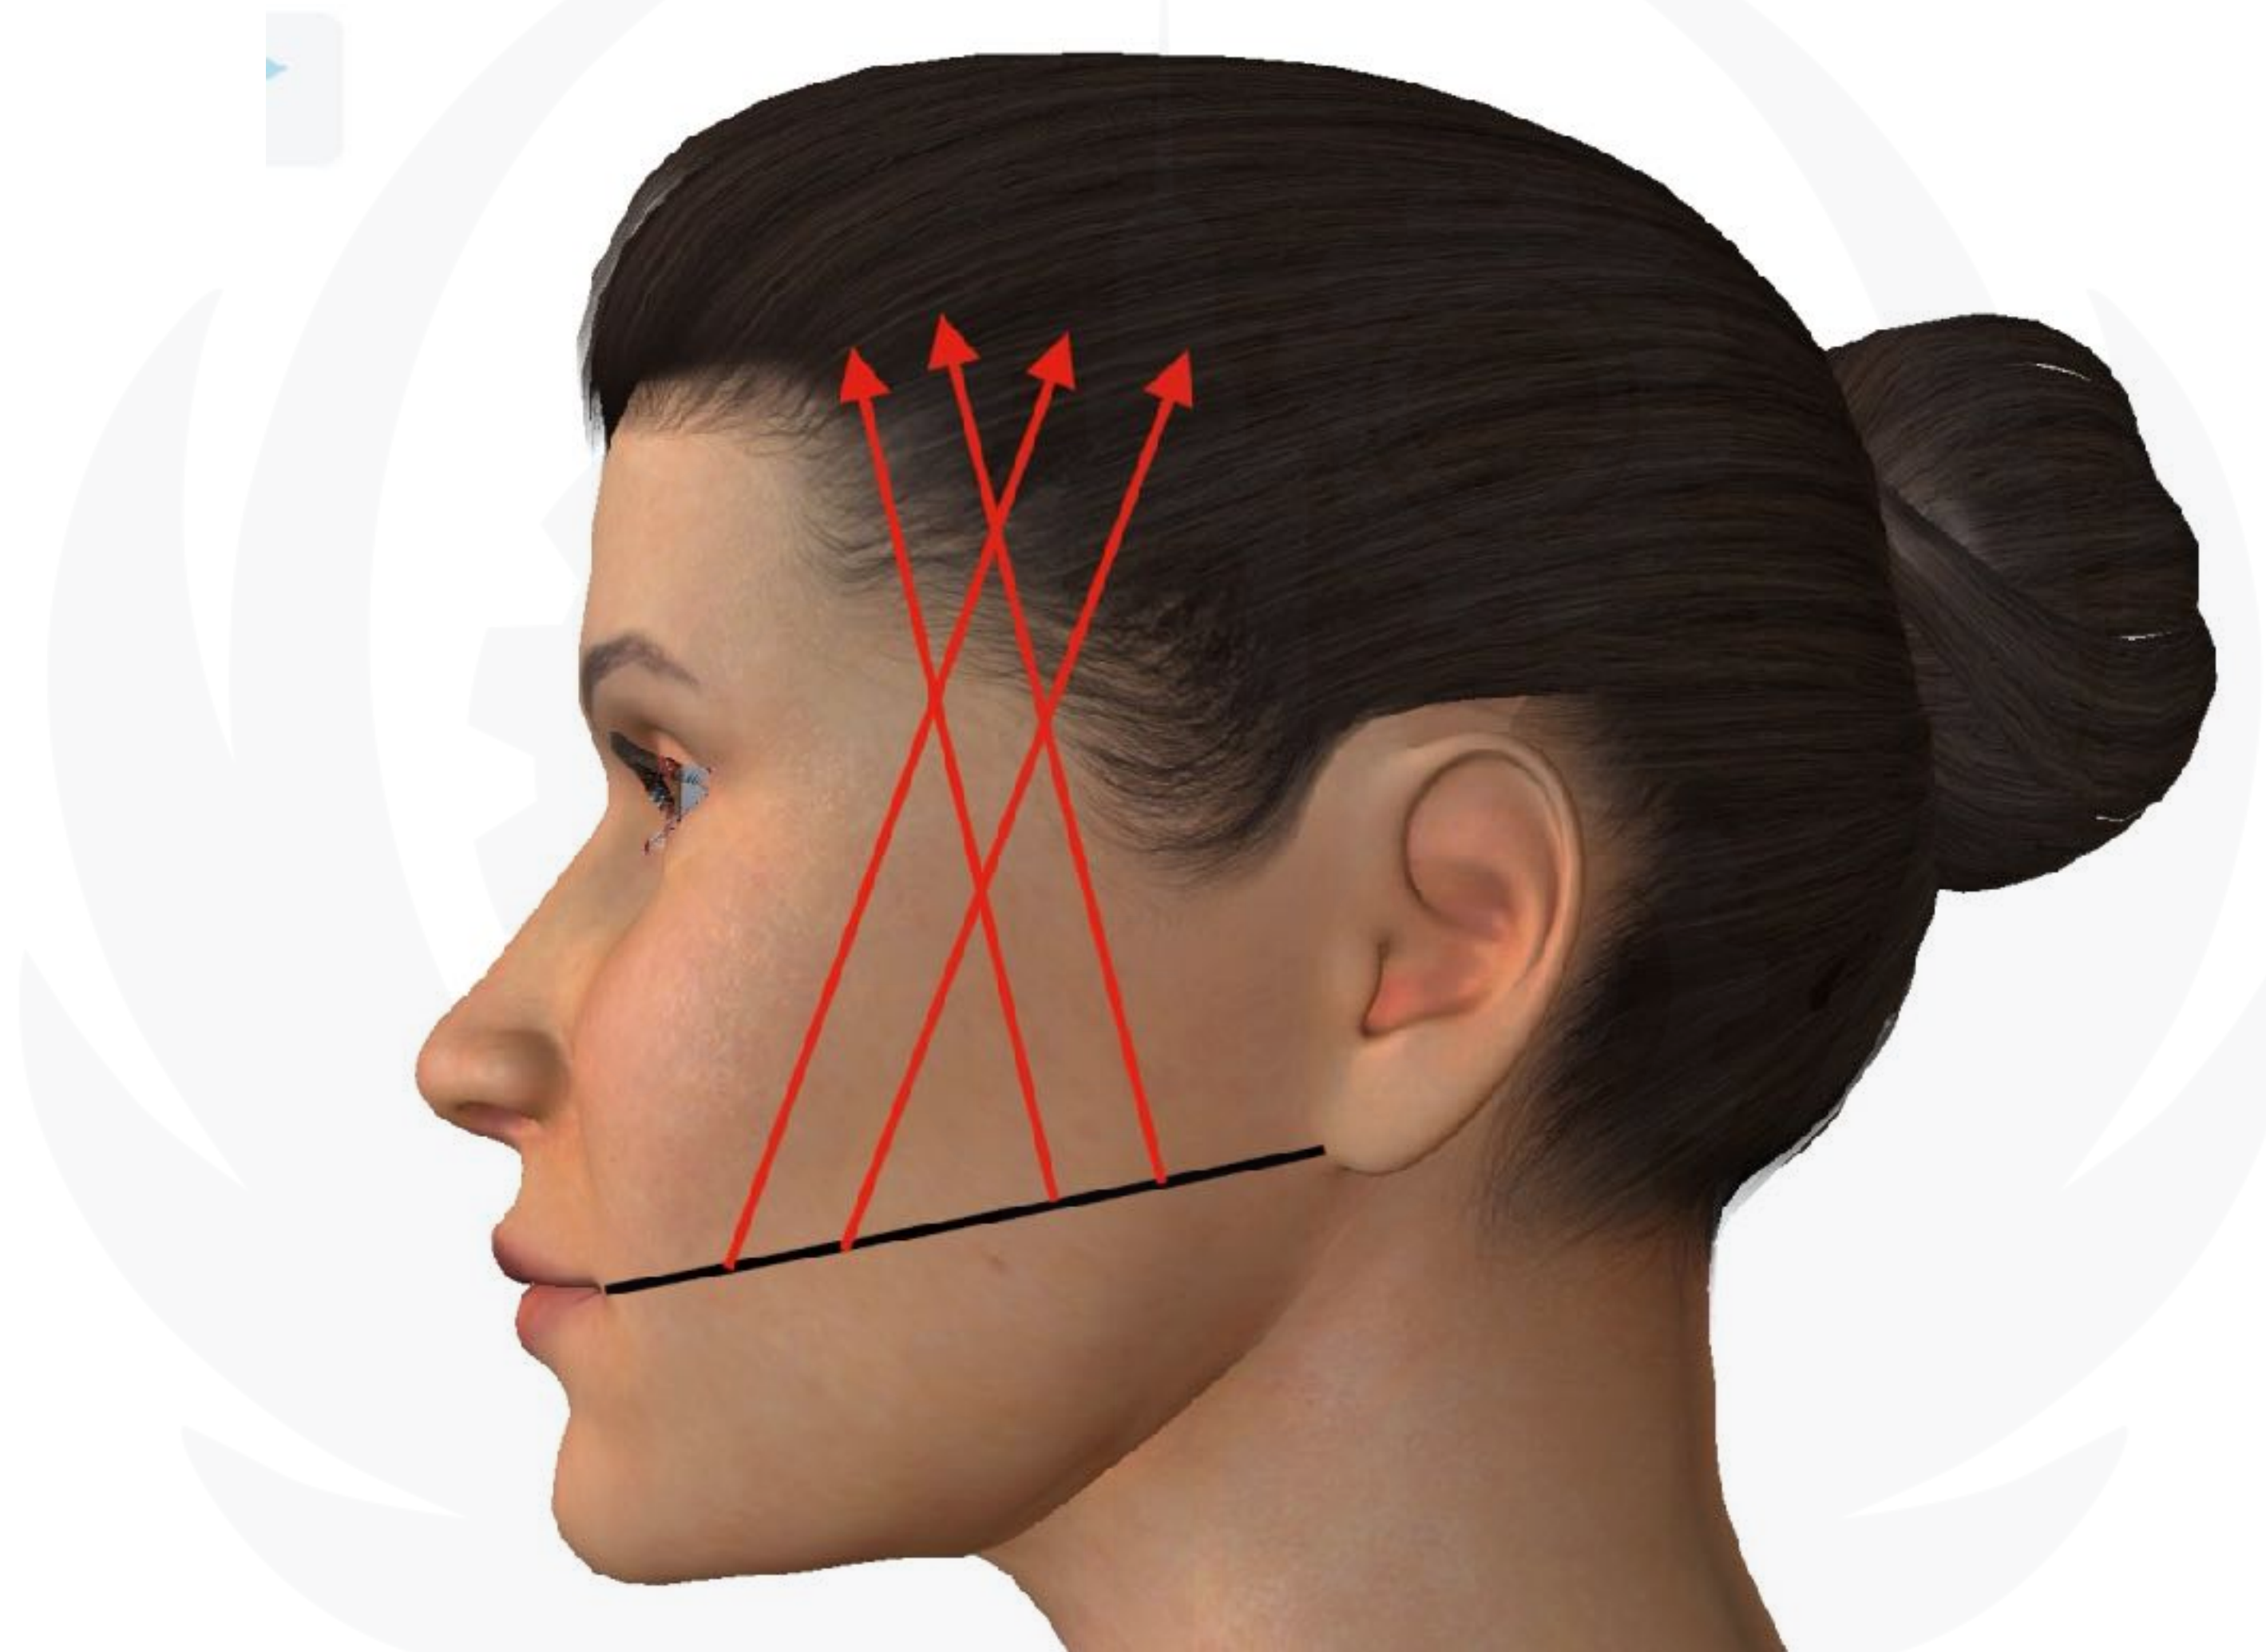


Установка нитей методом
«восходящая техника спейстред»

СХЕМА ИМПЛАНТАЦИИ Mint mini или Mint Fine

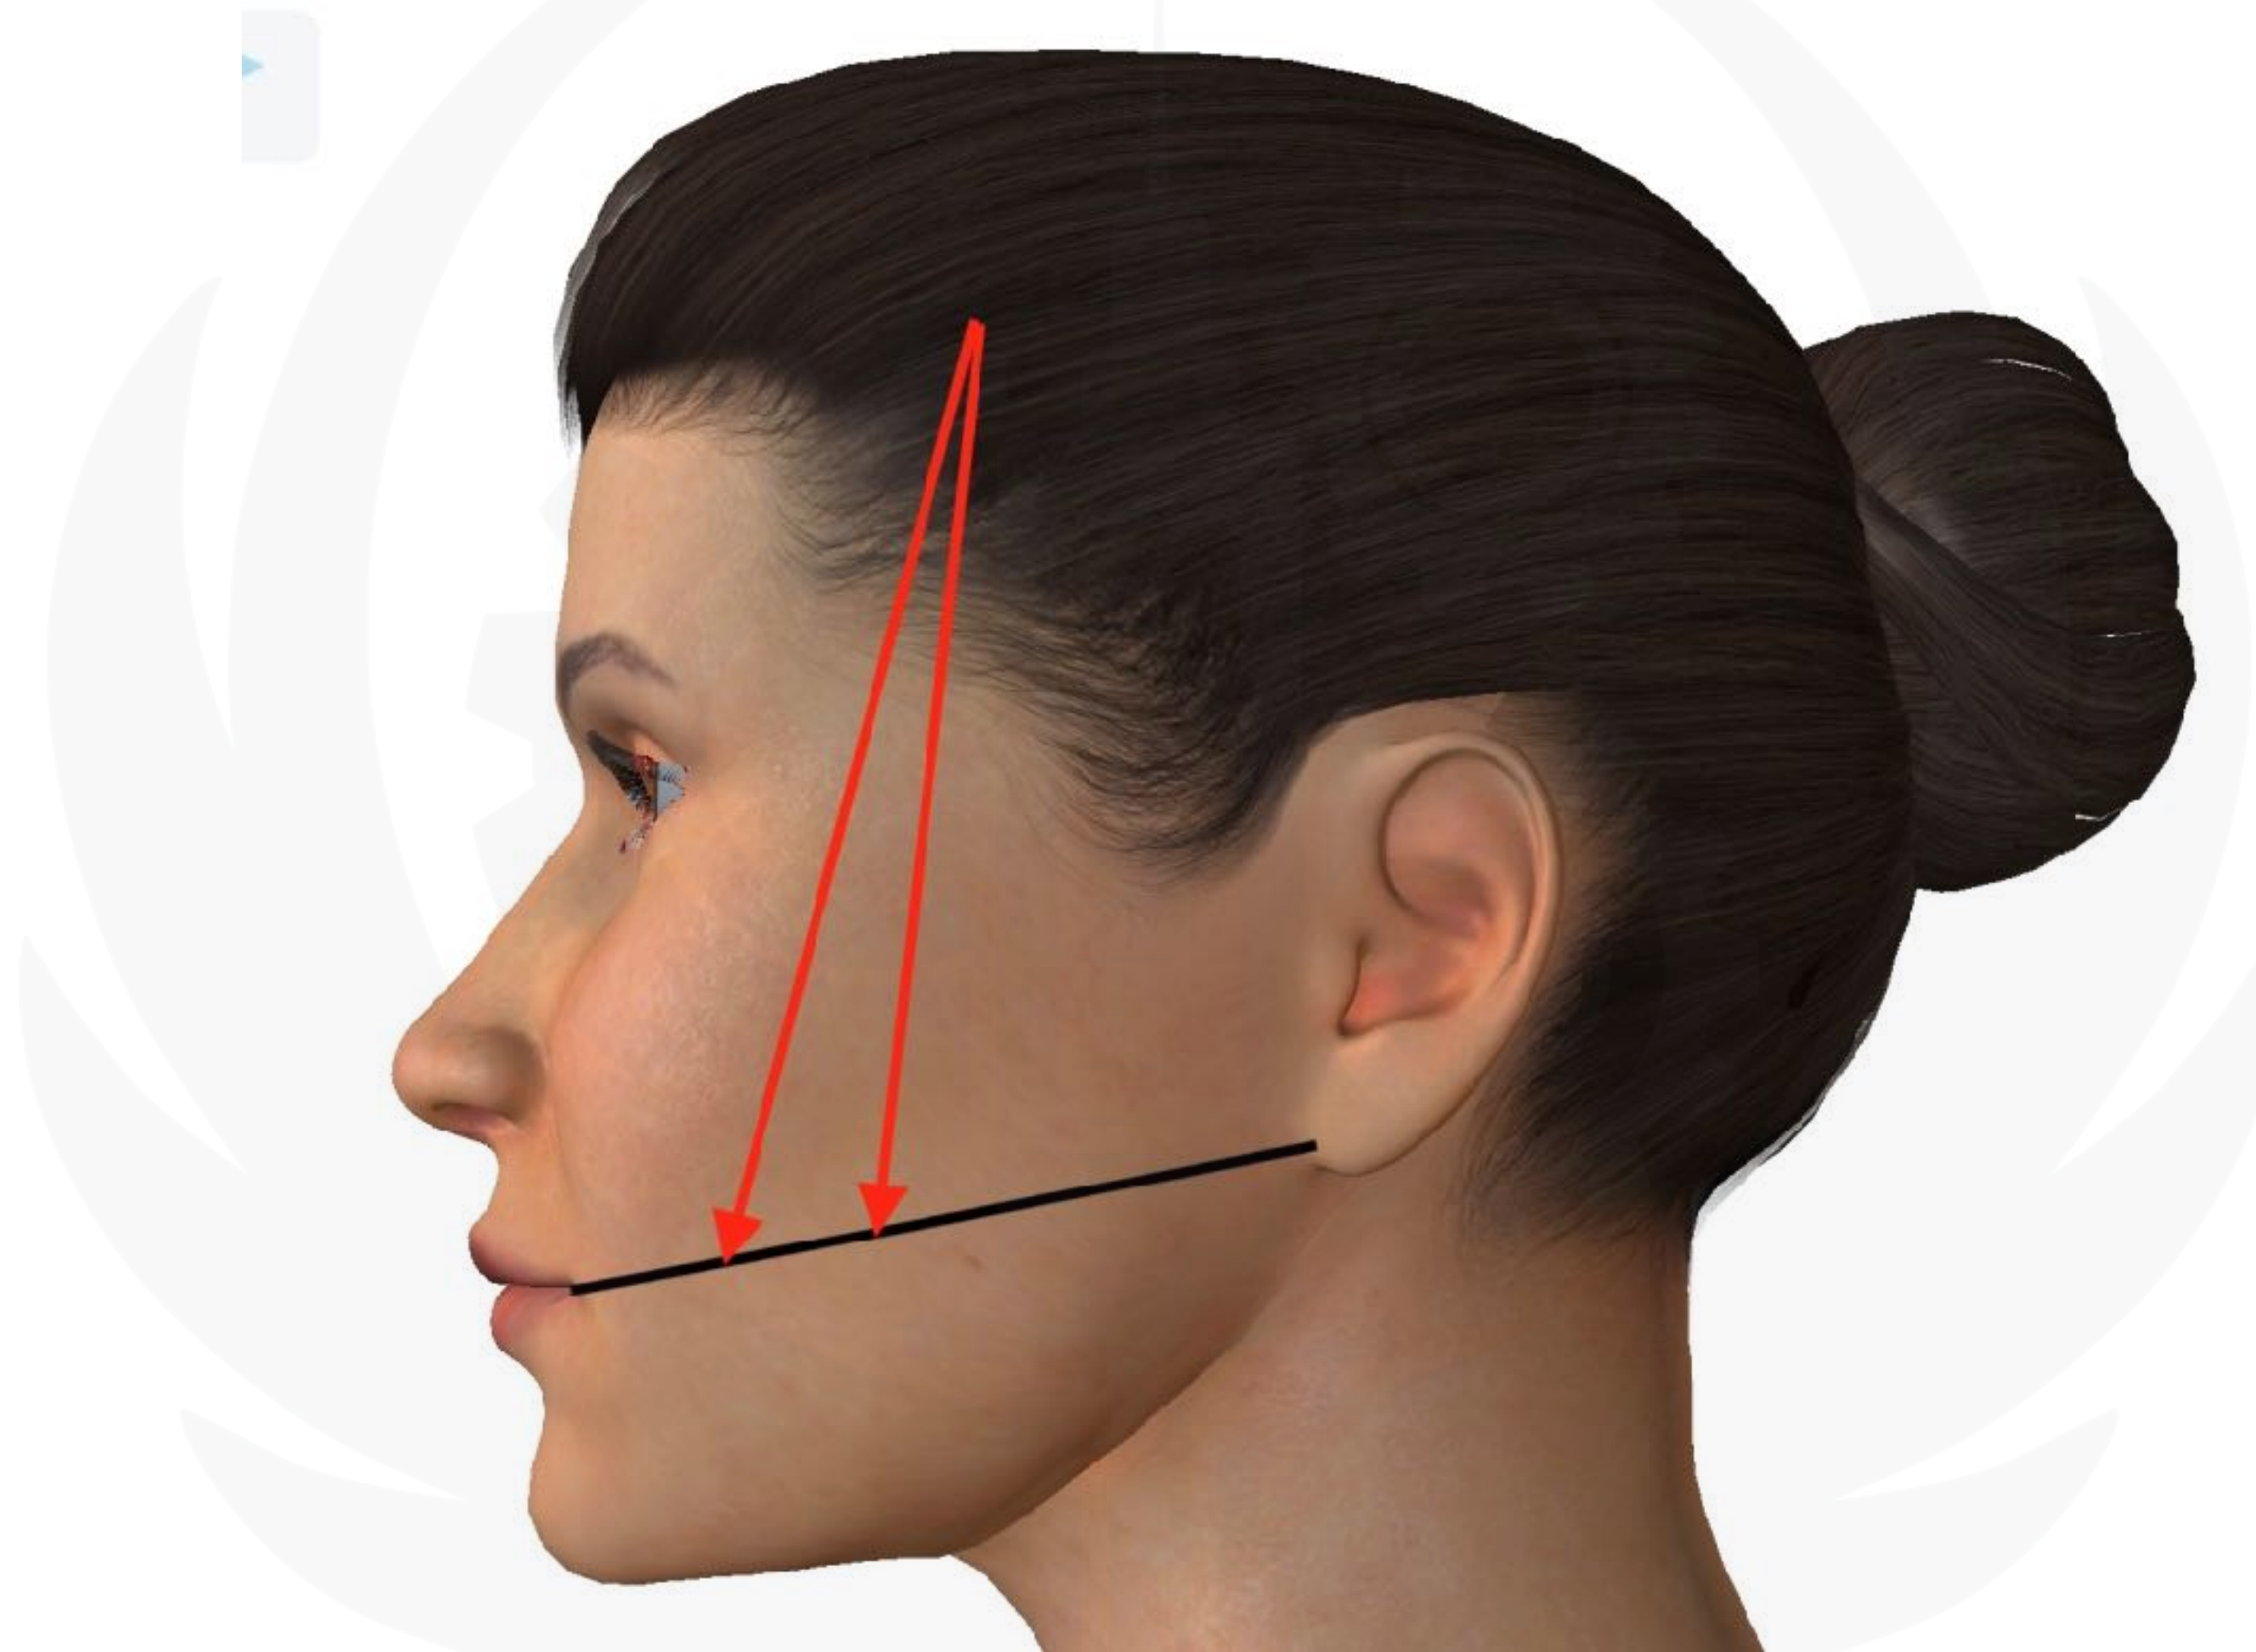


Установка нитей методом
«нисходящий лифтинг схема V»

СХЕМА ИМПЛАНТАЦИИ Mint Fine

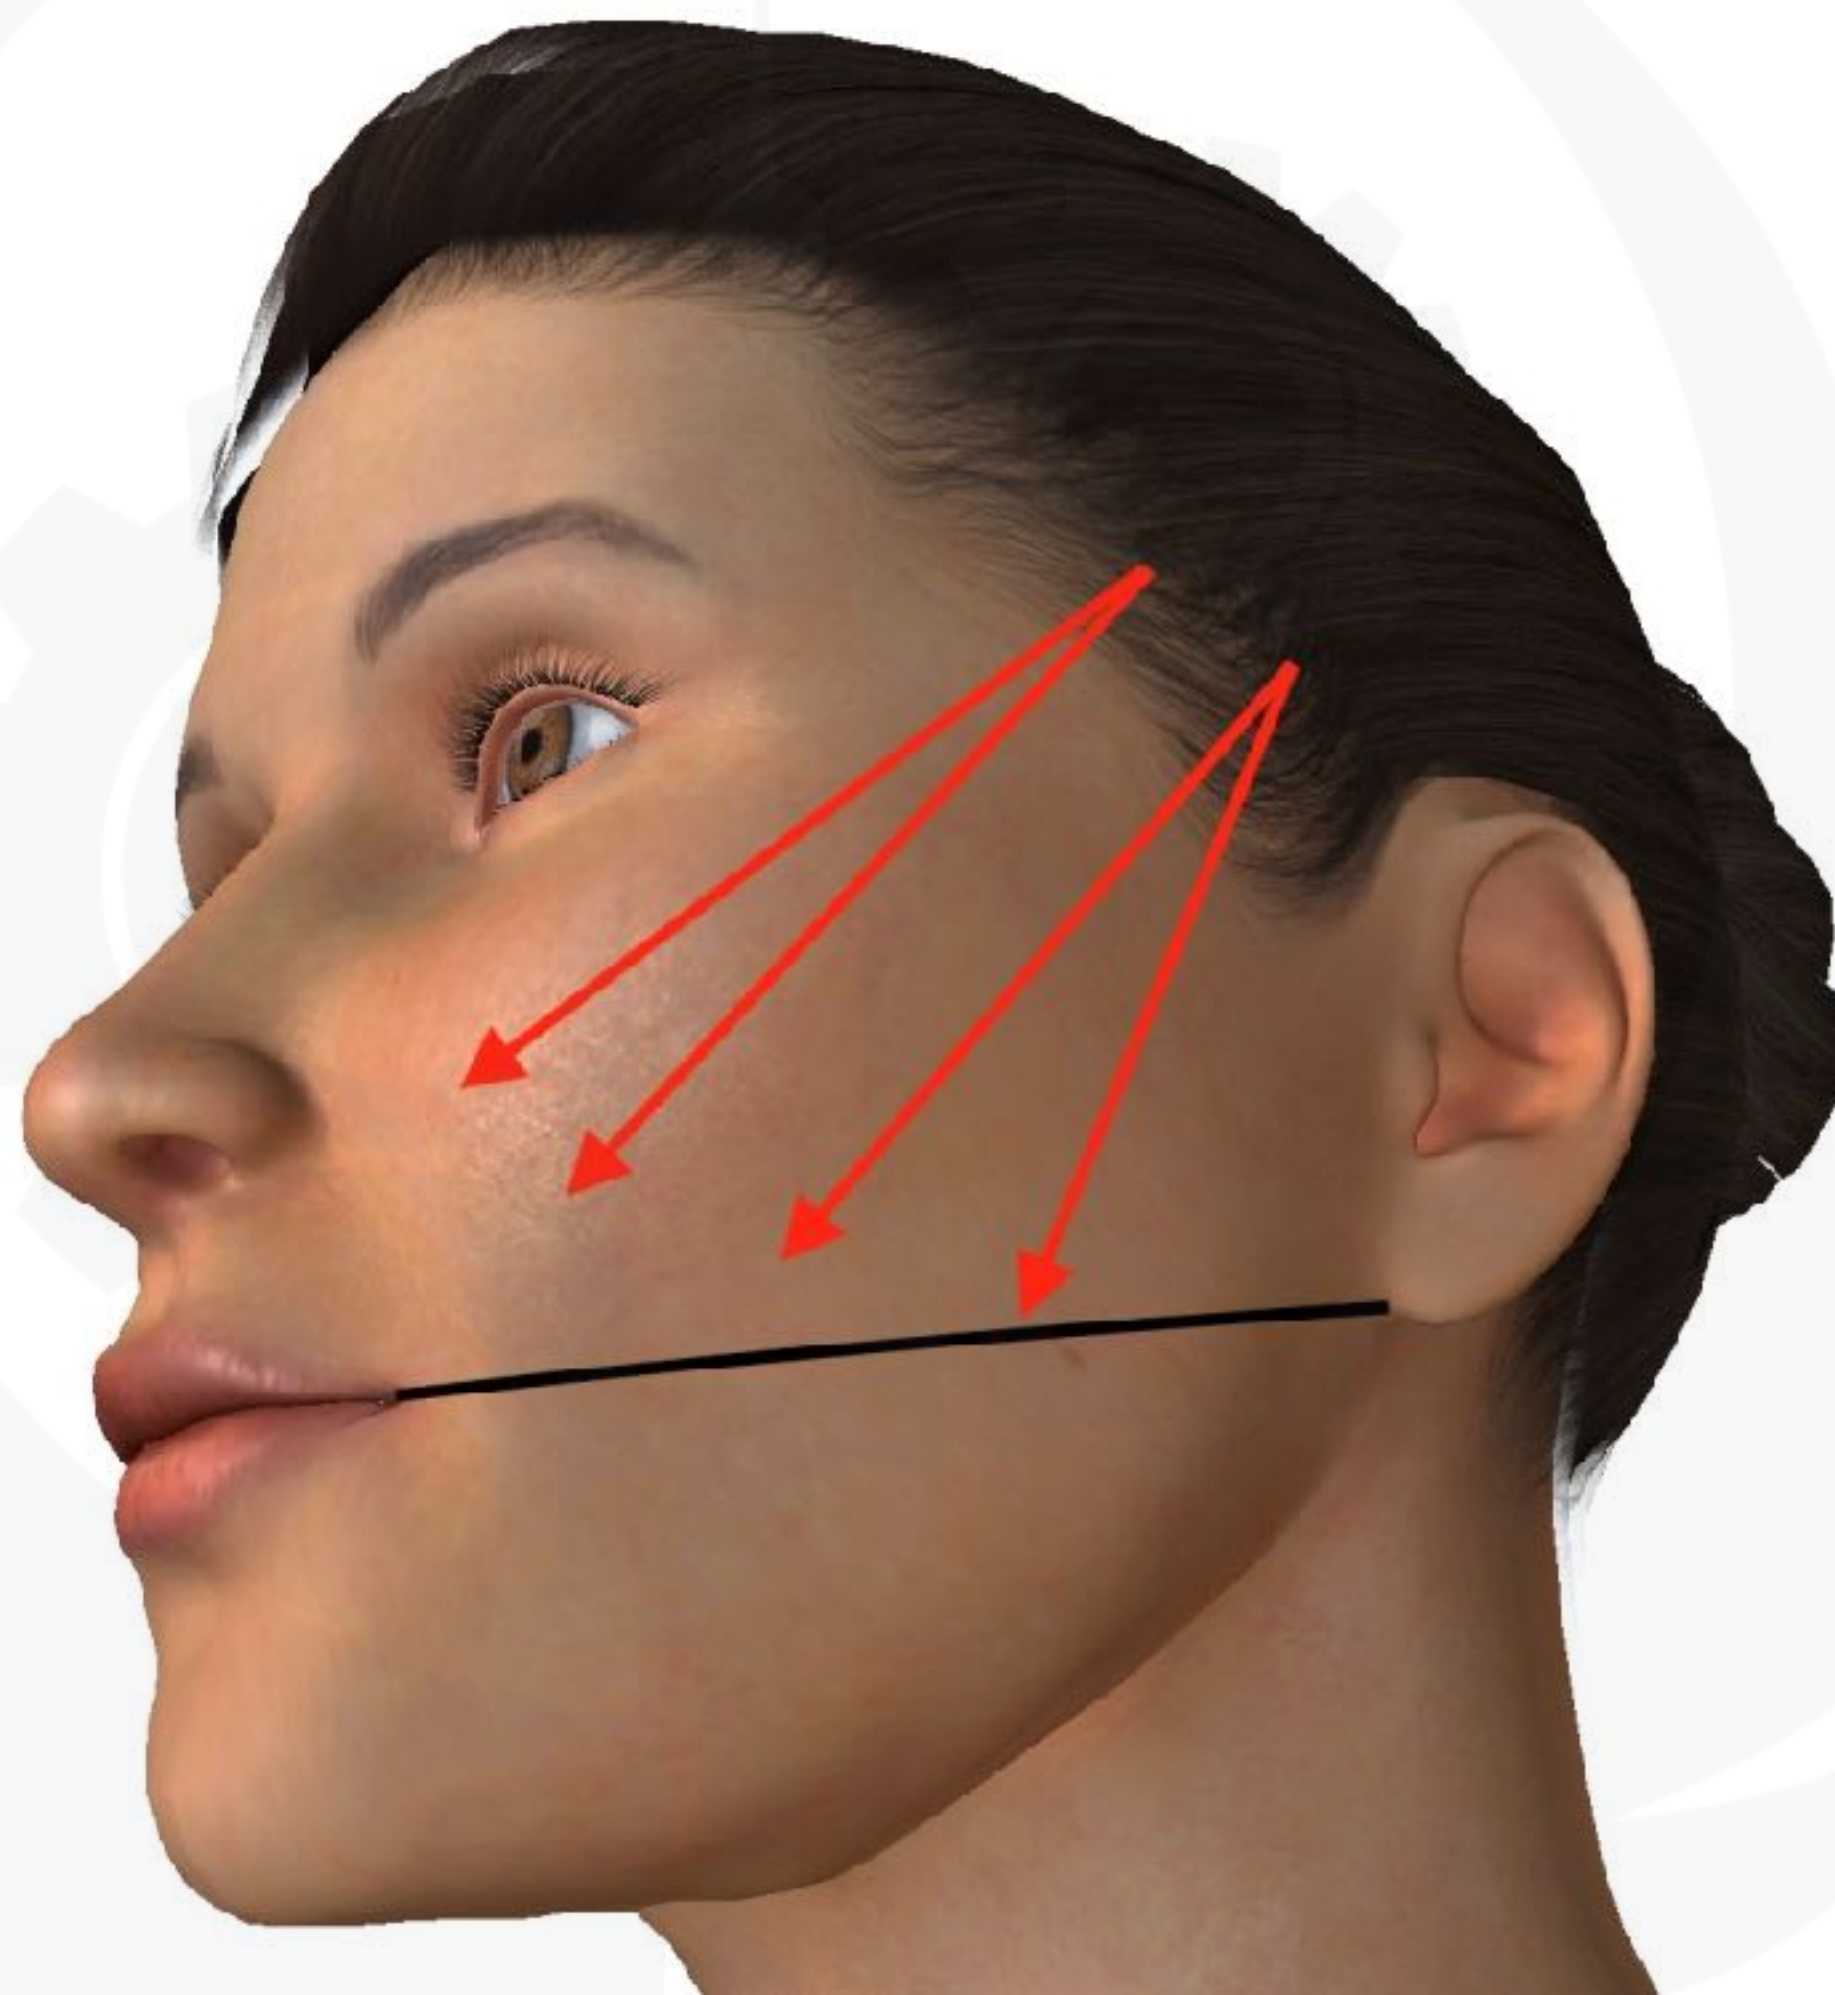


Установка нитей методом
«классическая схема»

СХЕМА ИМПЛАНТАЦИИ Mint Fine

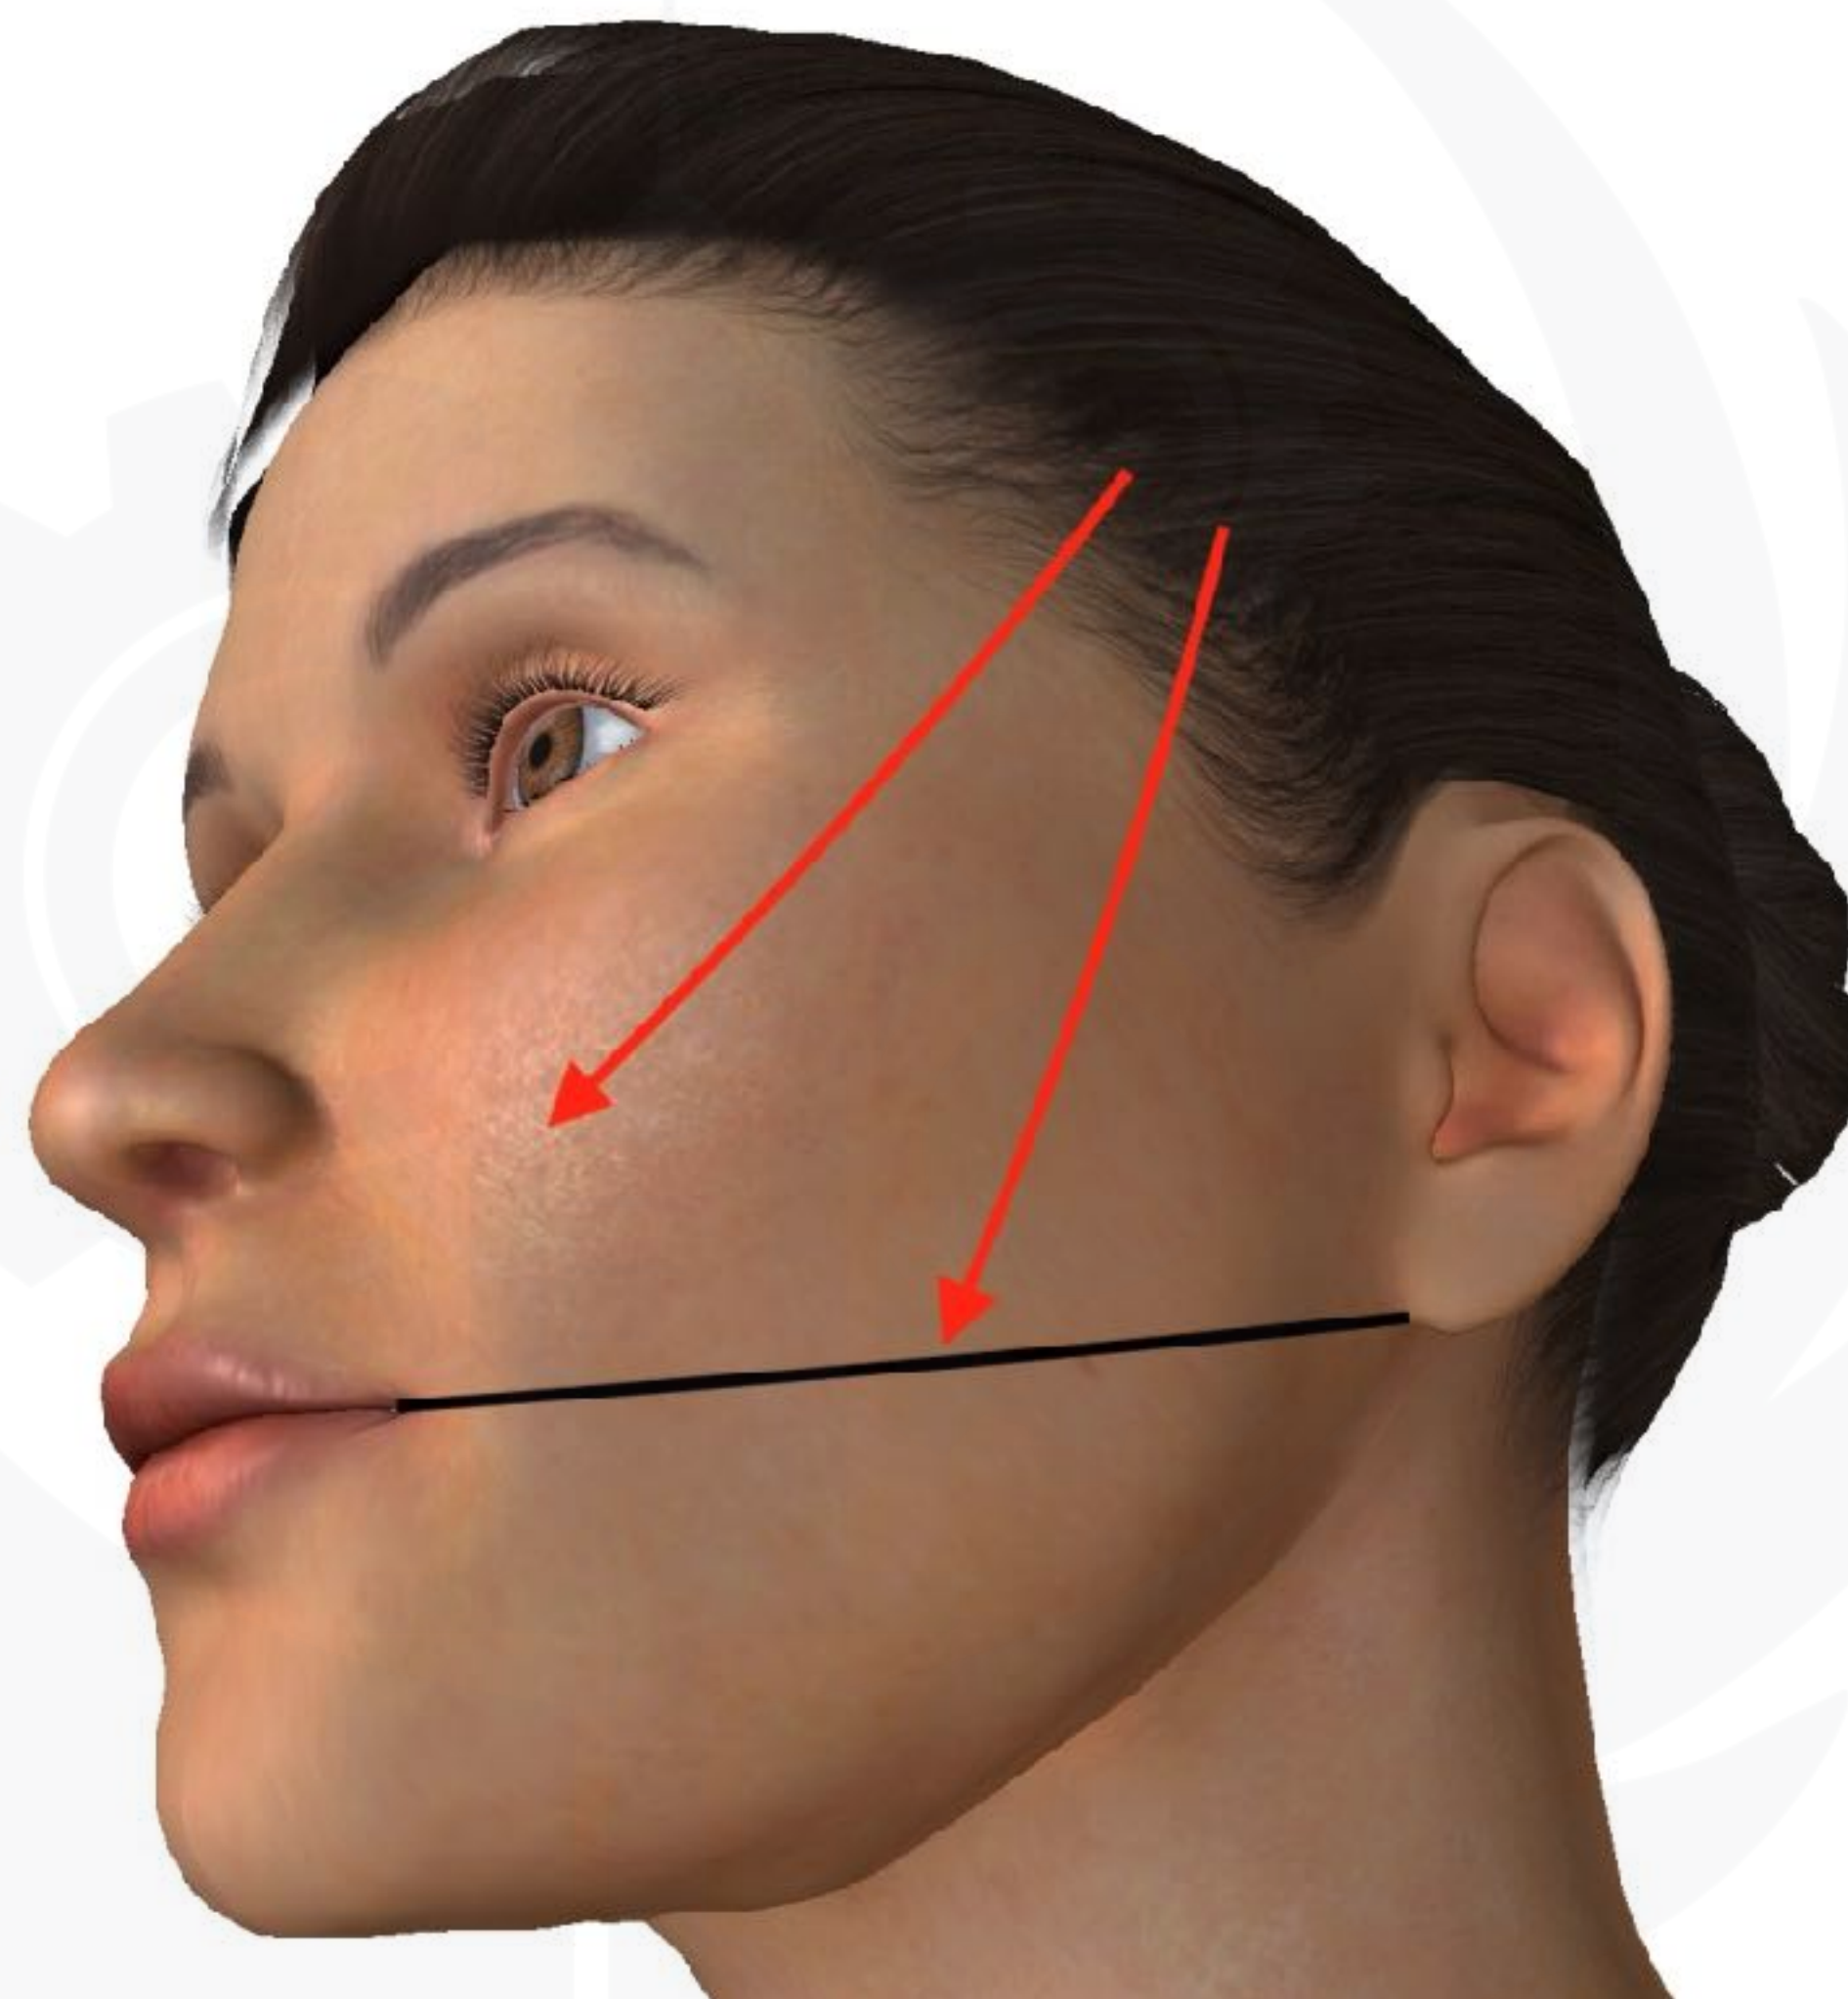


Установка нитей методом
«параллельная установка»

СХЕМА ИМПЛАНТАЦИИ Mint Fine

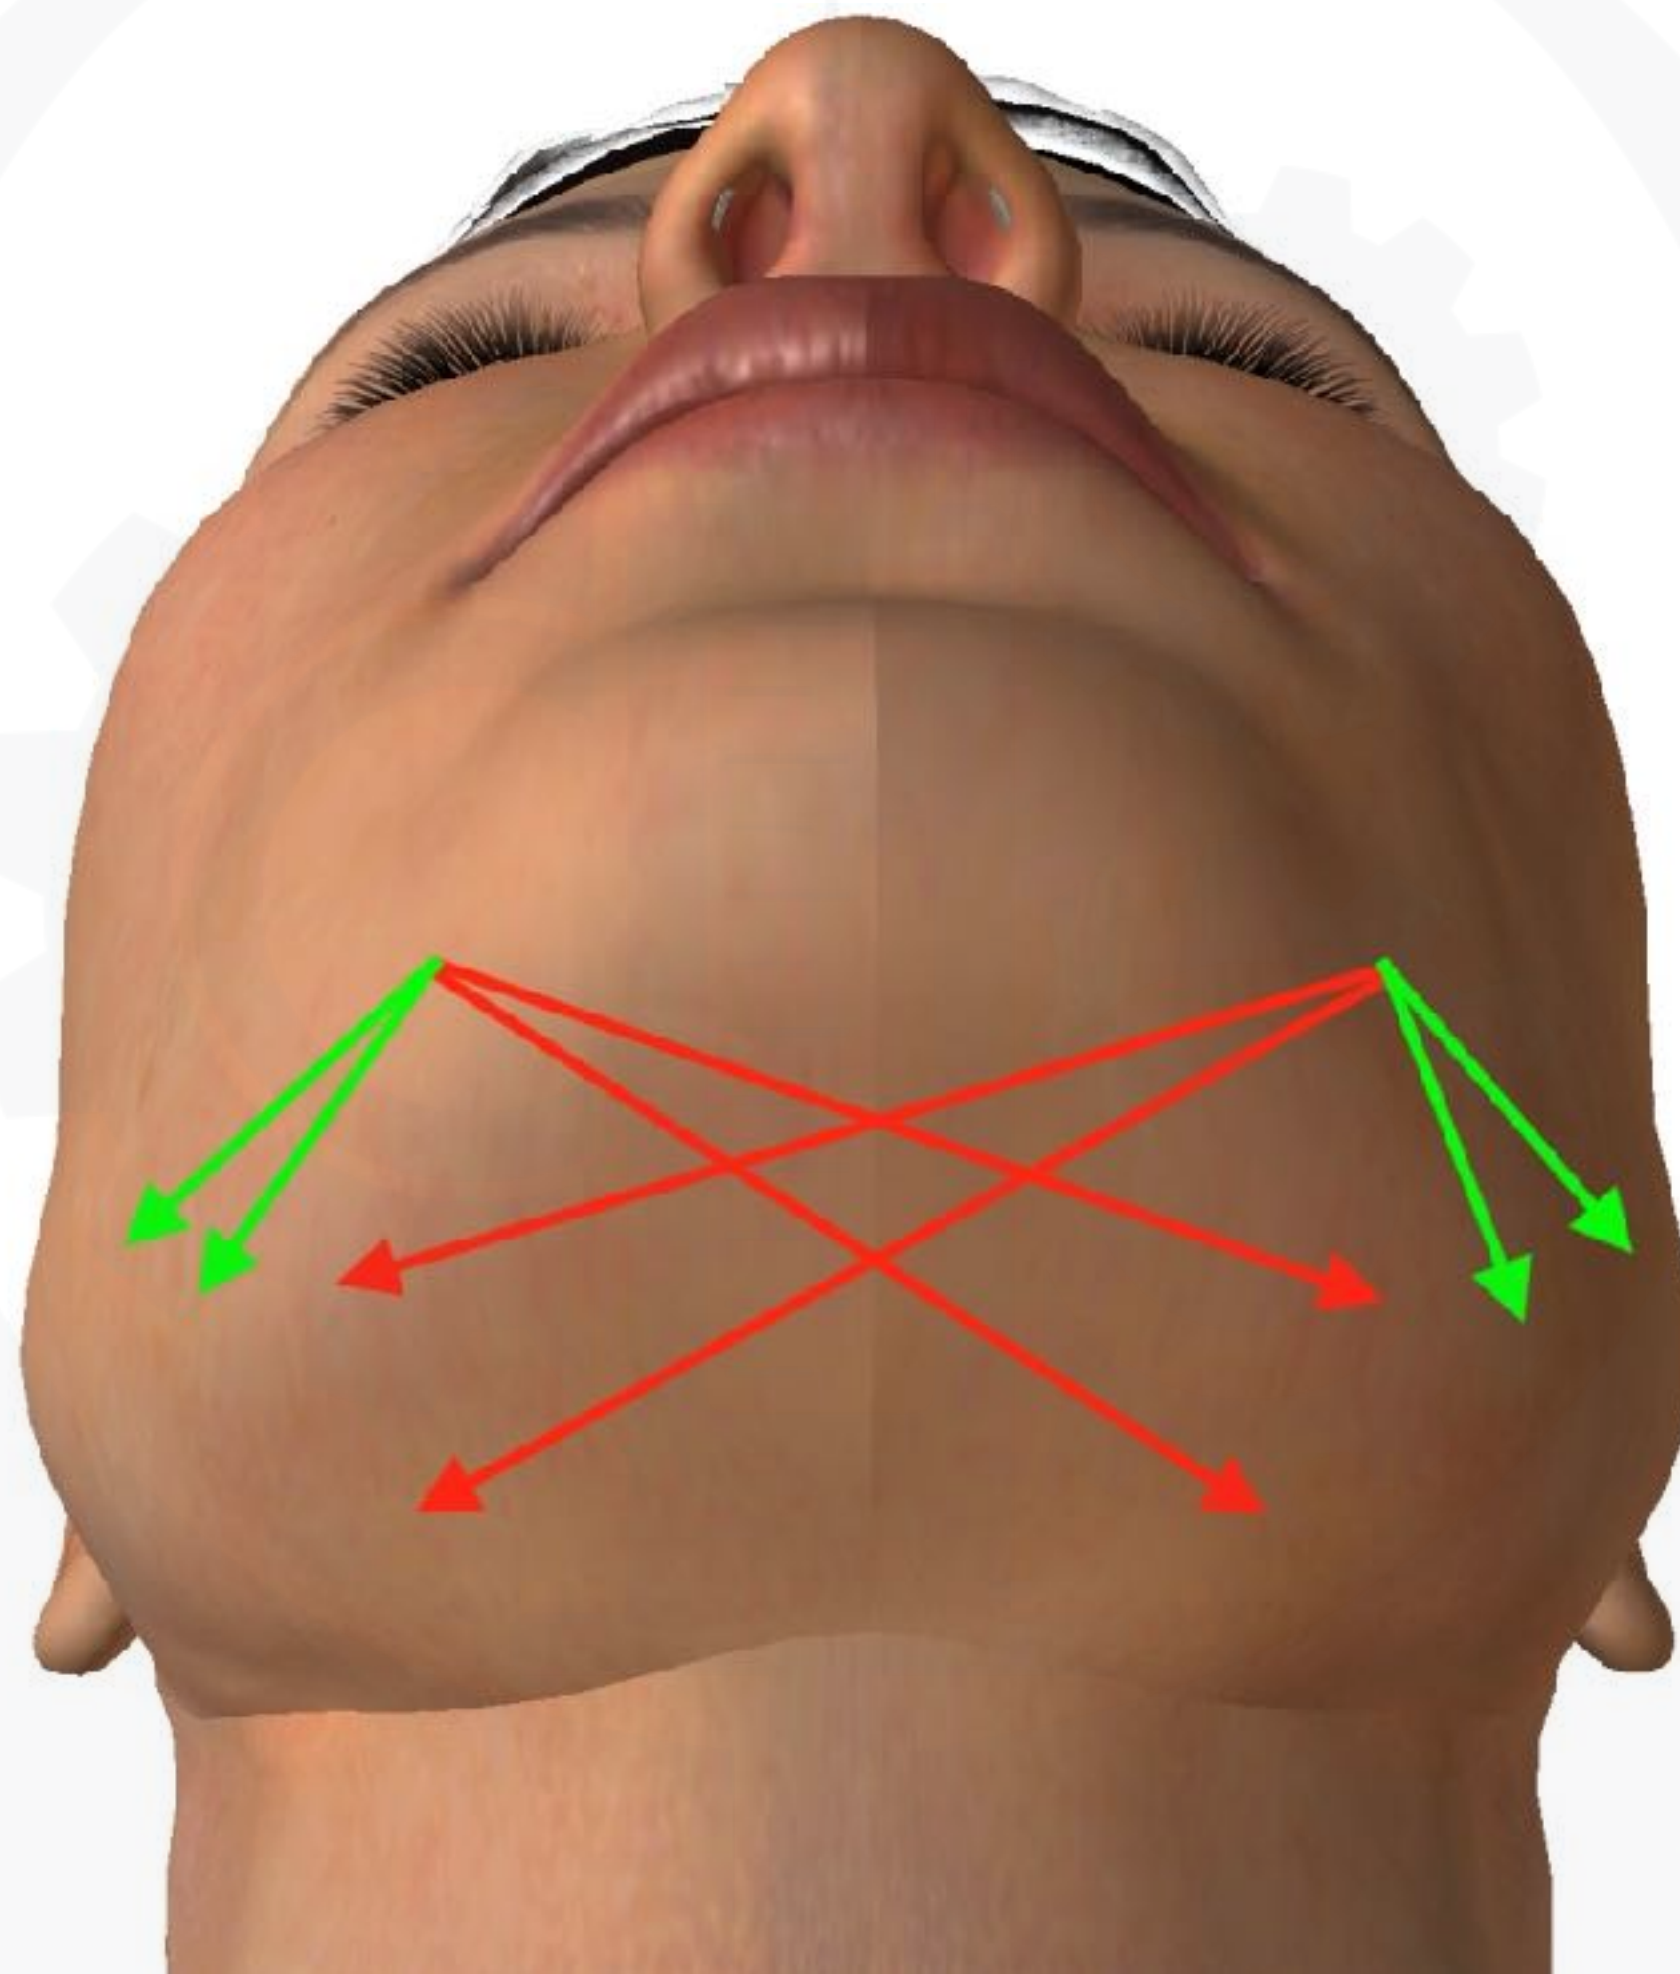


Установка нитей методом
«альтернативный гамак с разворотом»

СХЕМА ИМПЛАНТАЦИИ Mint Fine

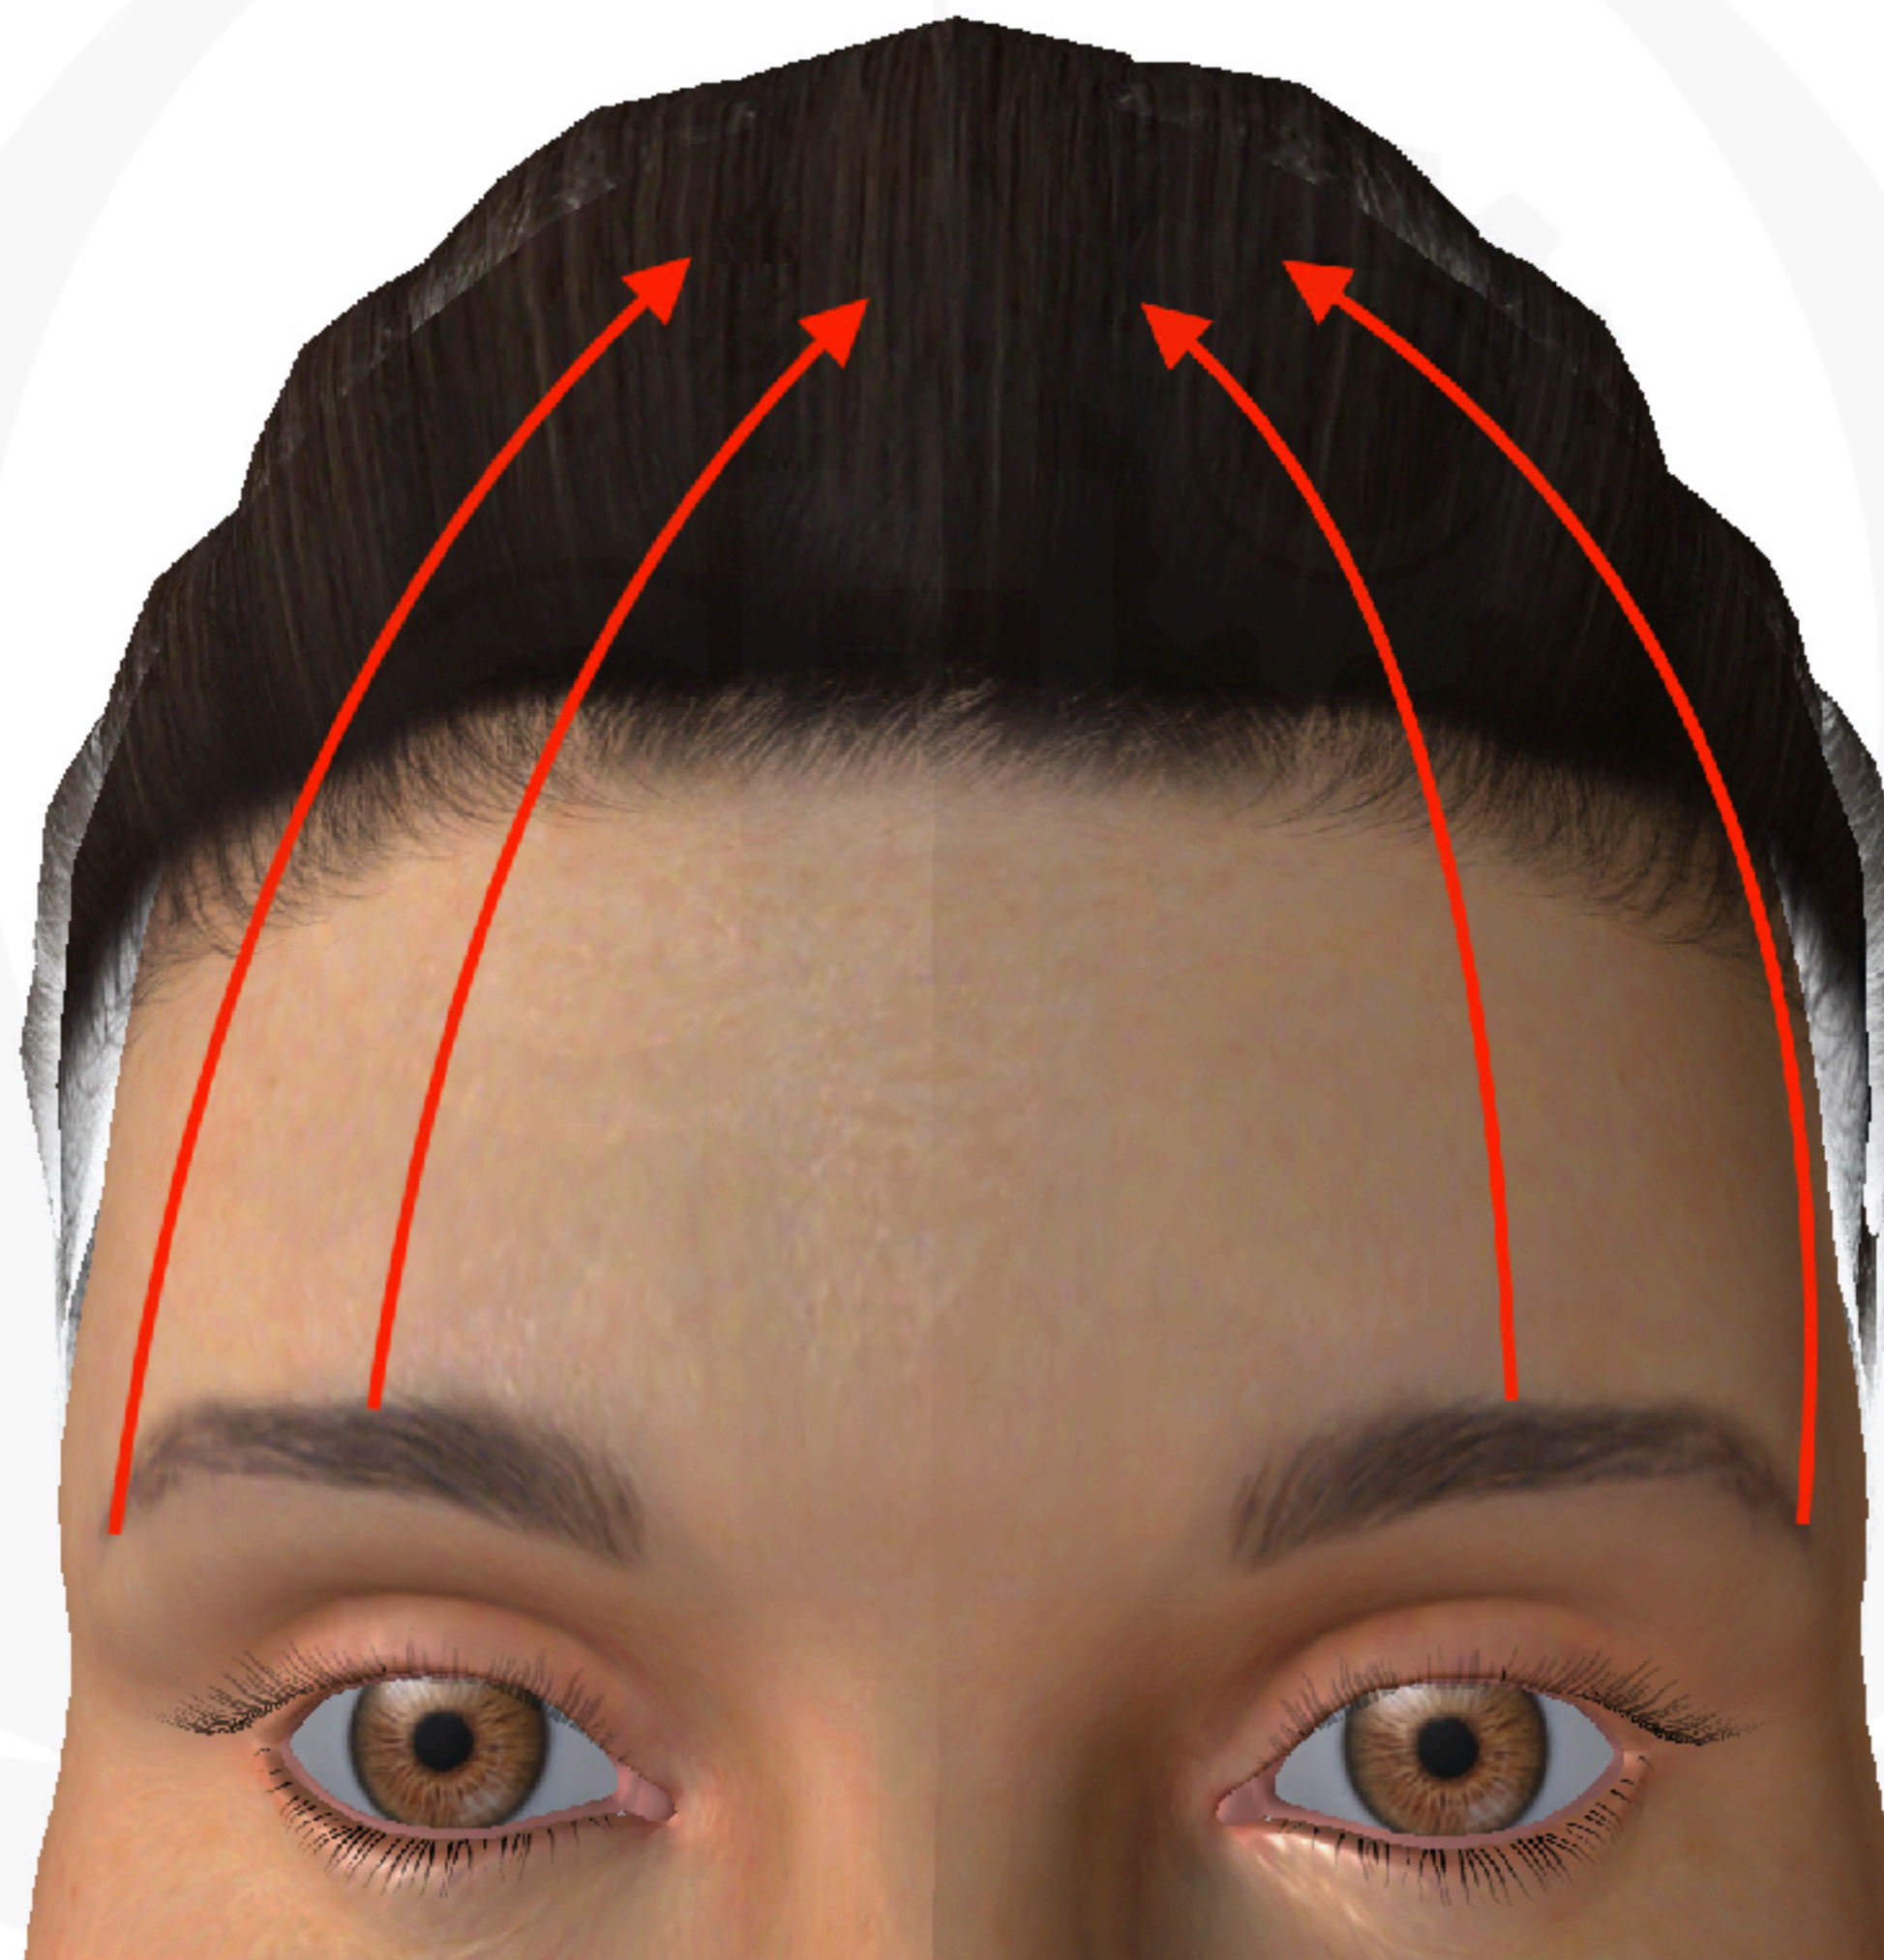


Установка нитей методом
«восходящая техника броулифт»

СХЕМА ИМПЛАНТАЦИИ Mint Fine

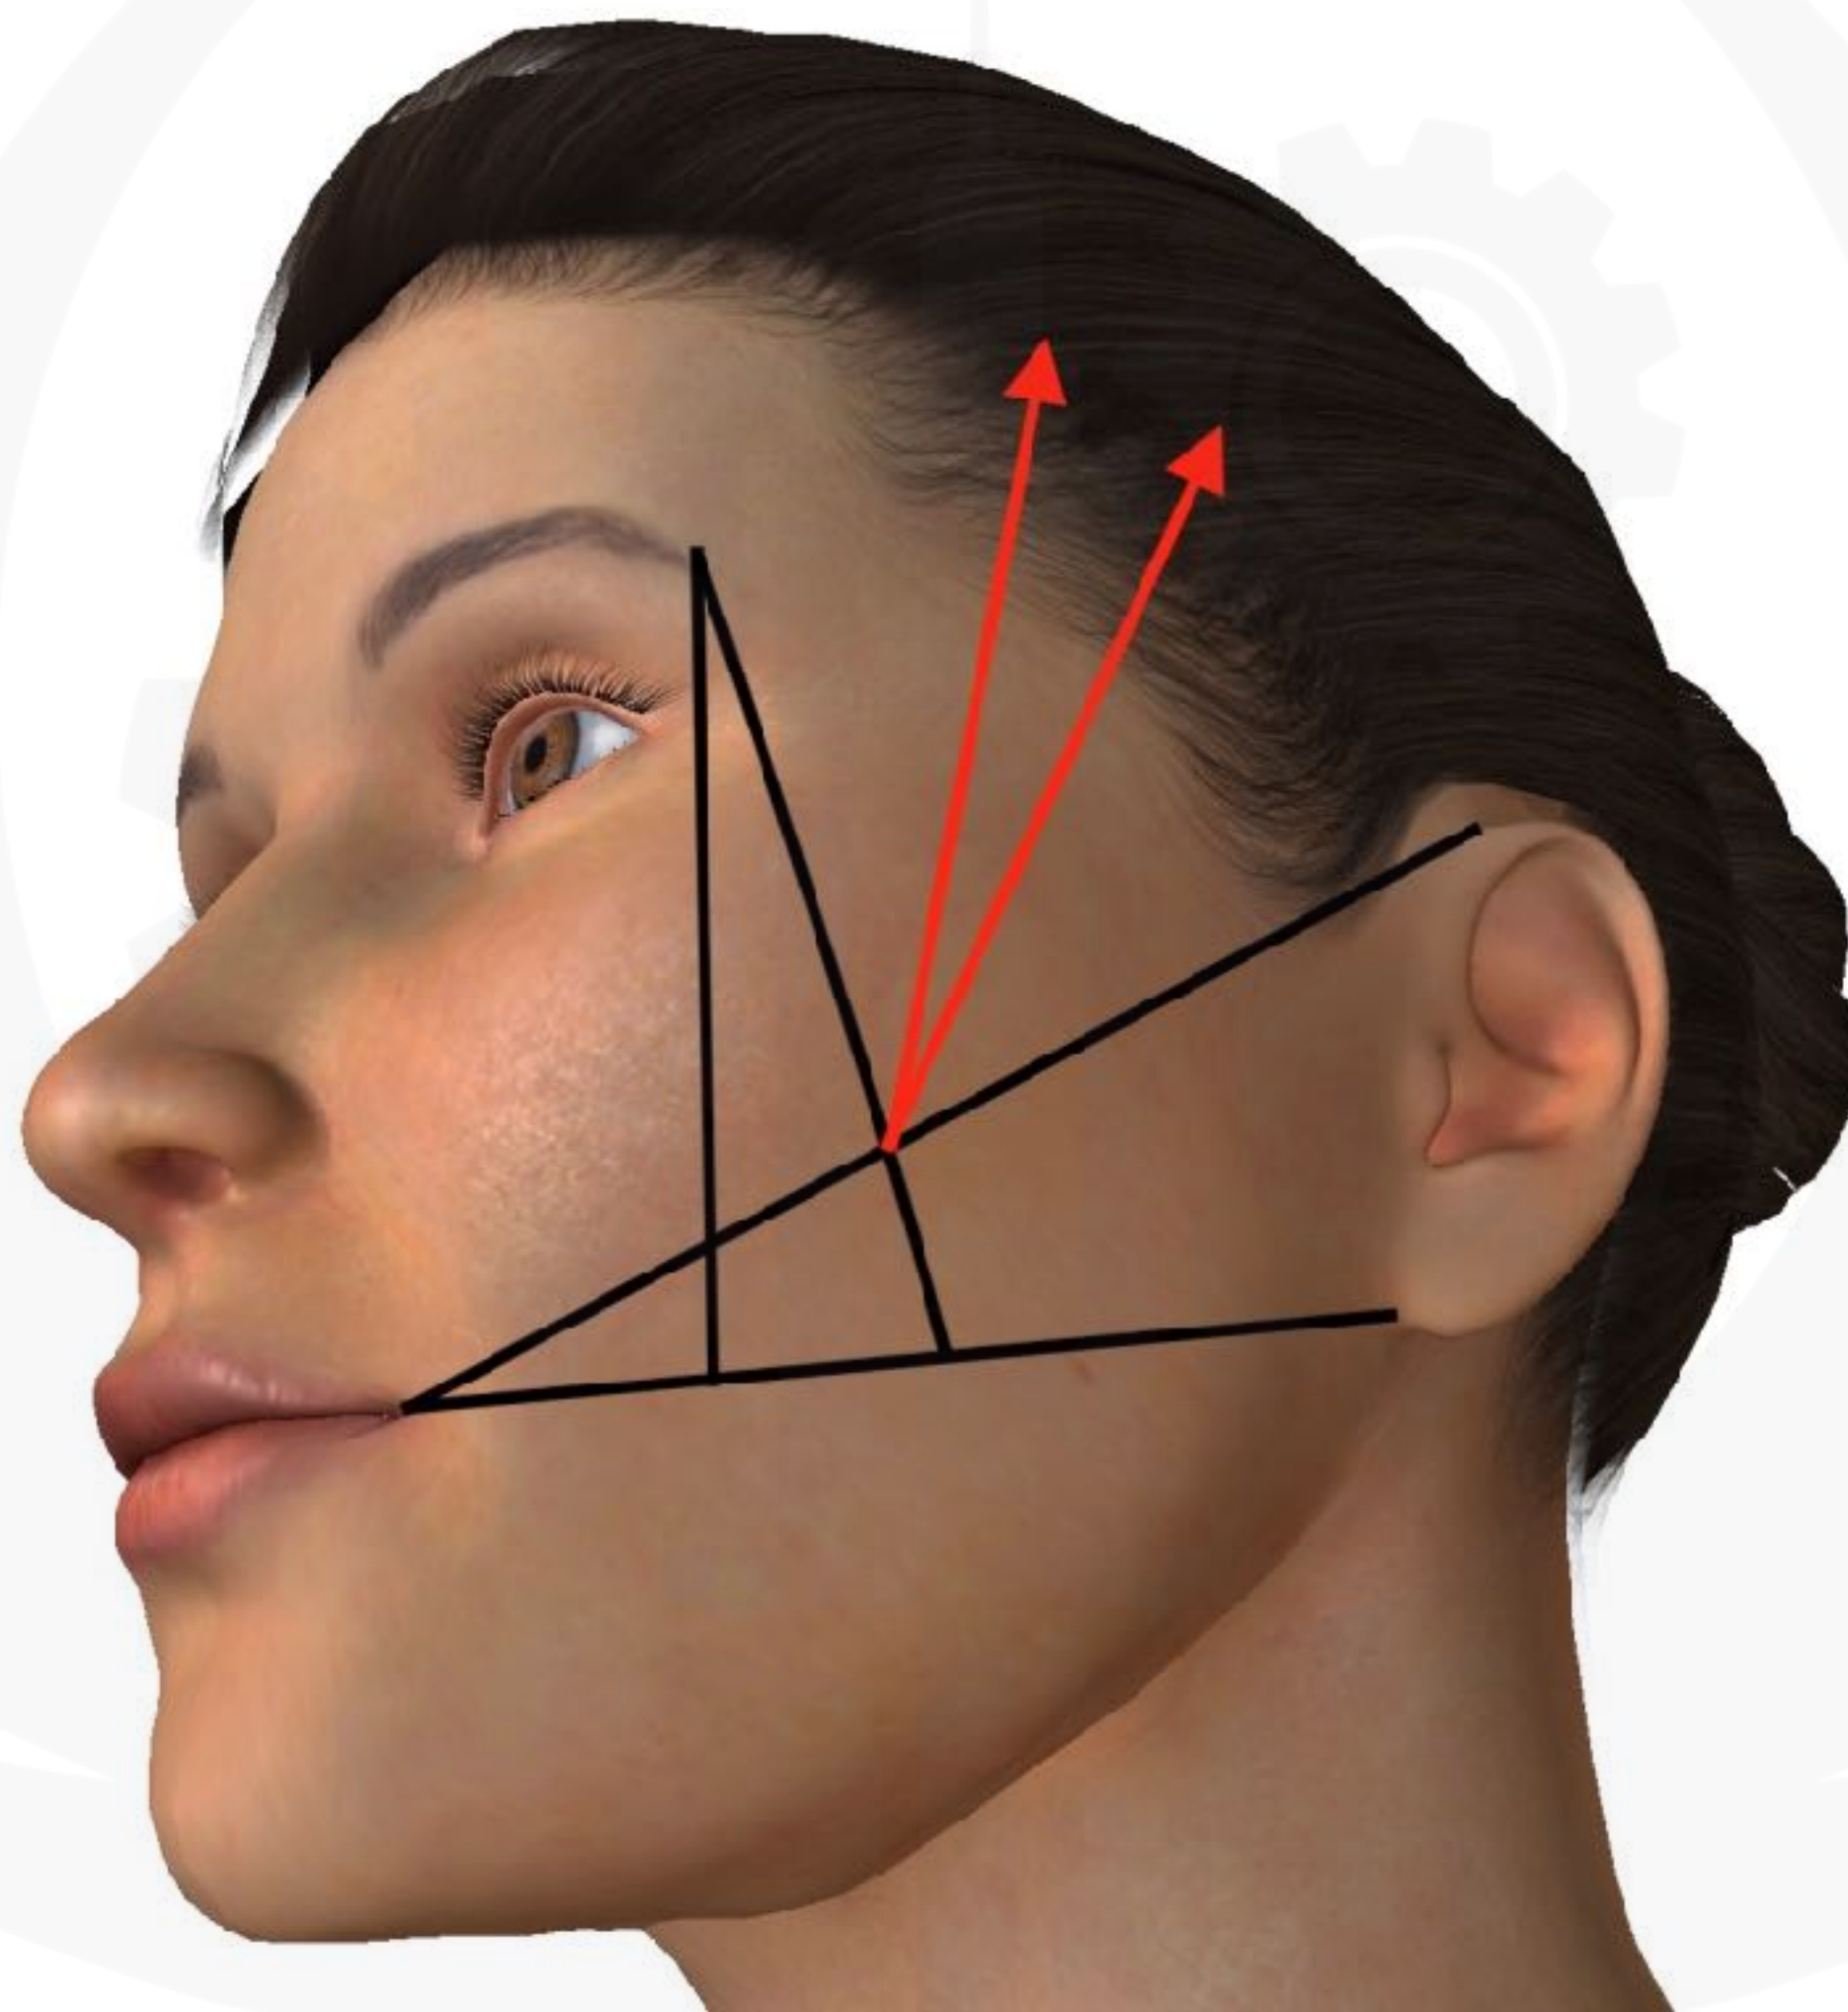


Установка нитей методом
«восходящая техника скуловой лифтинг»

СХЕМА ИМПЛАНТАЦИИ Mint Fine

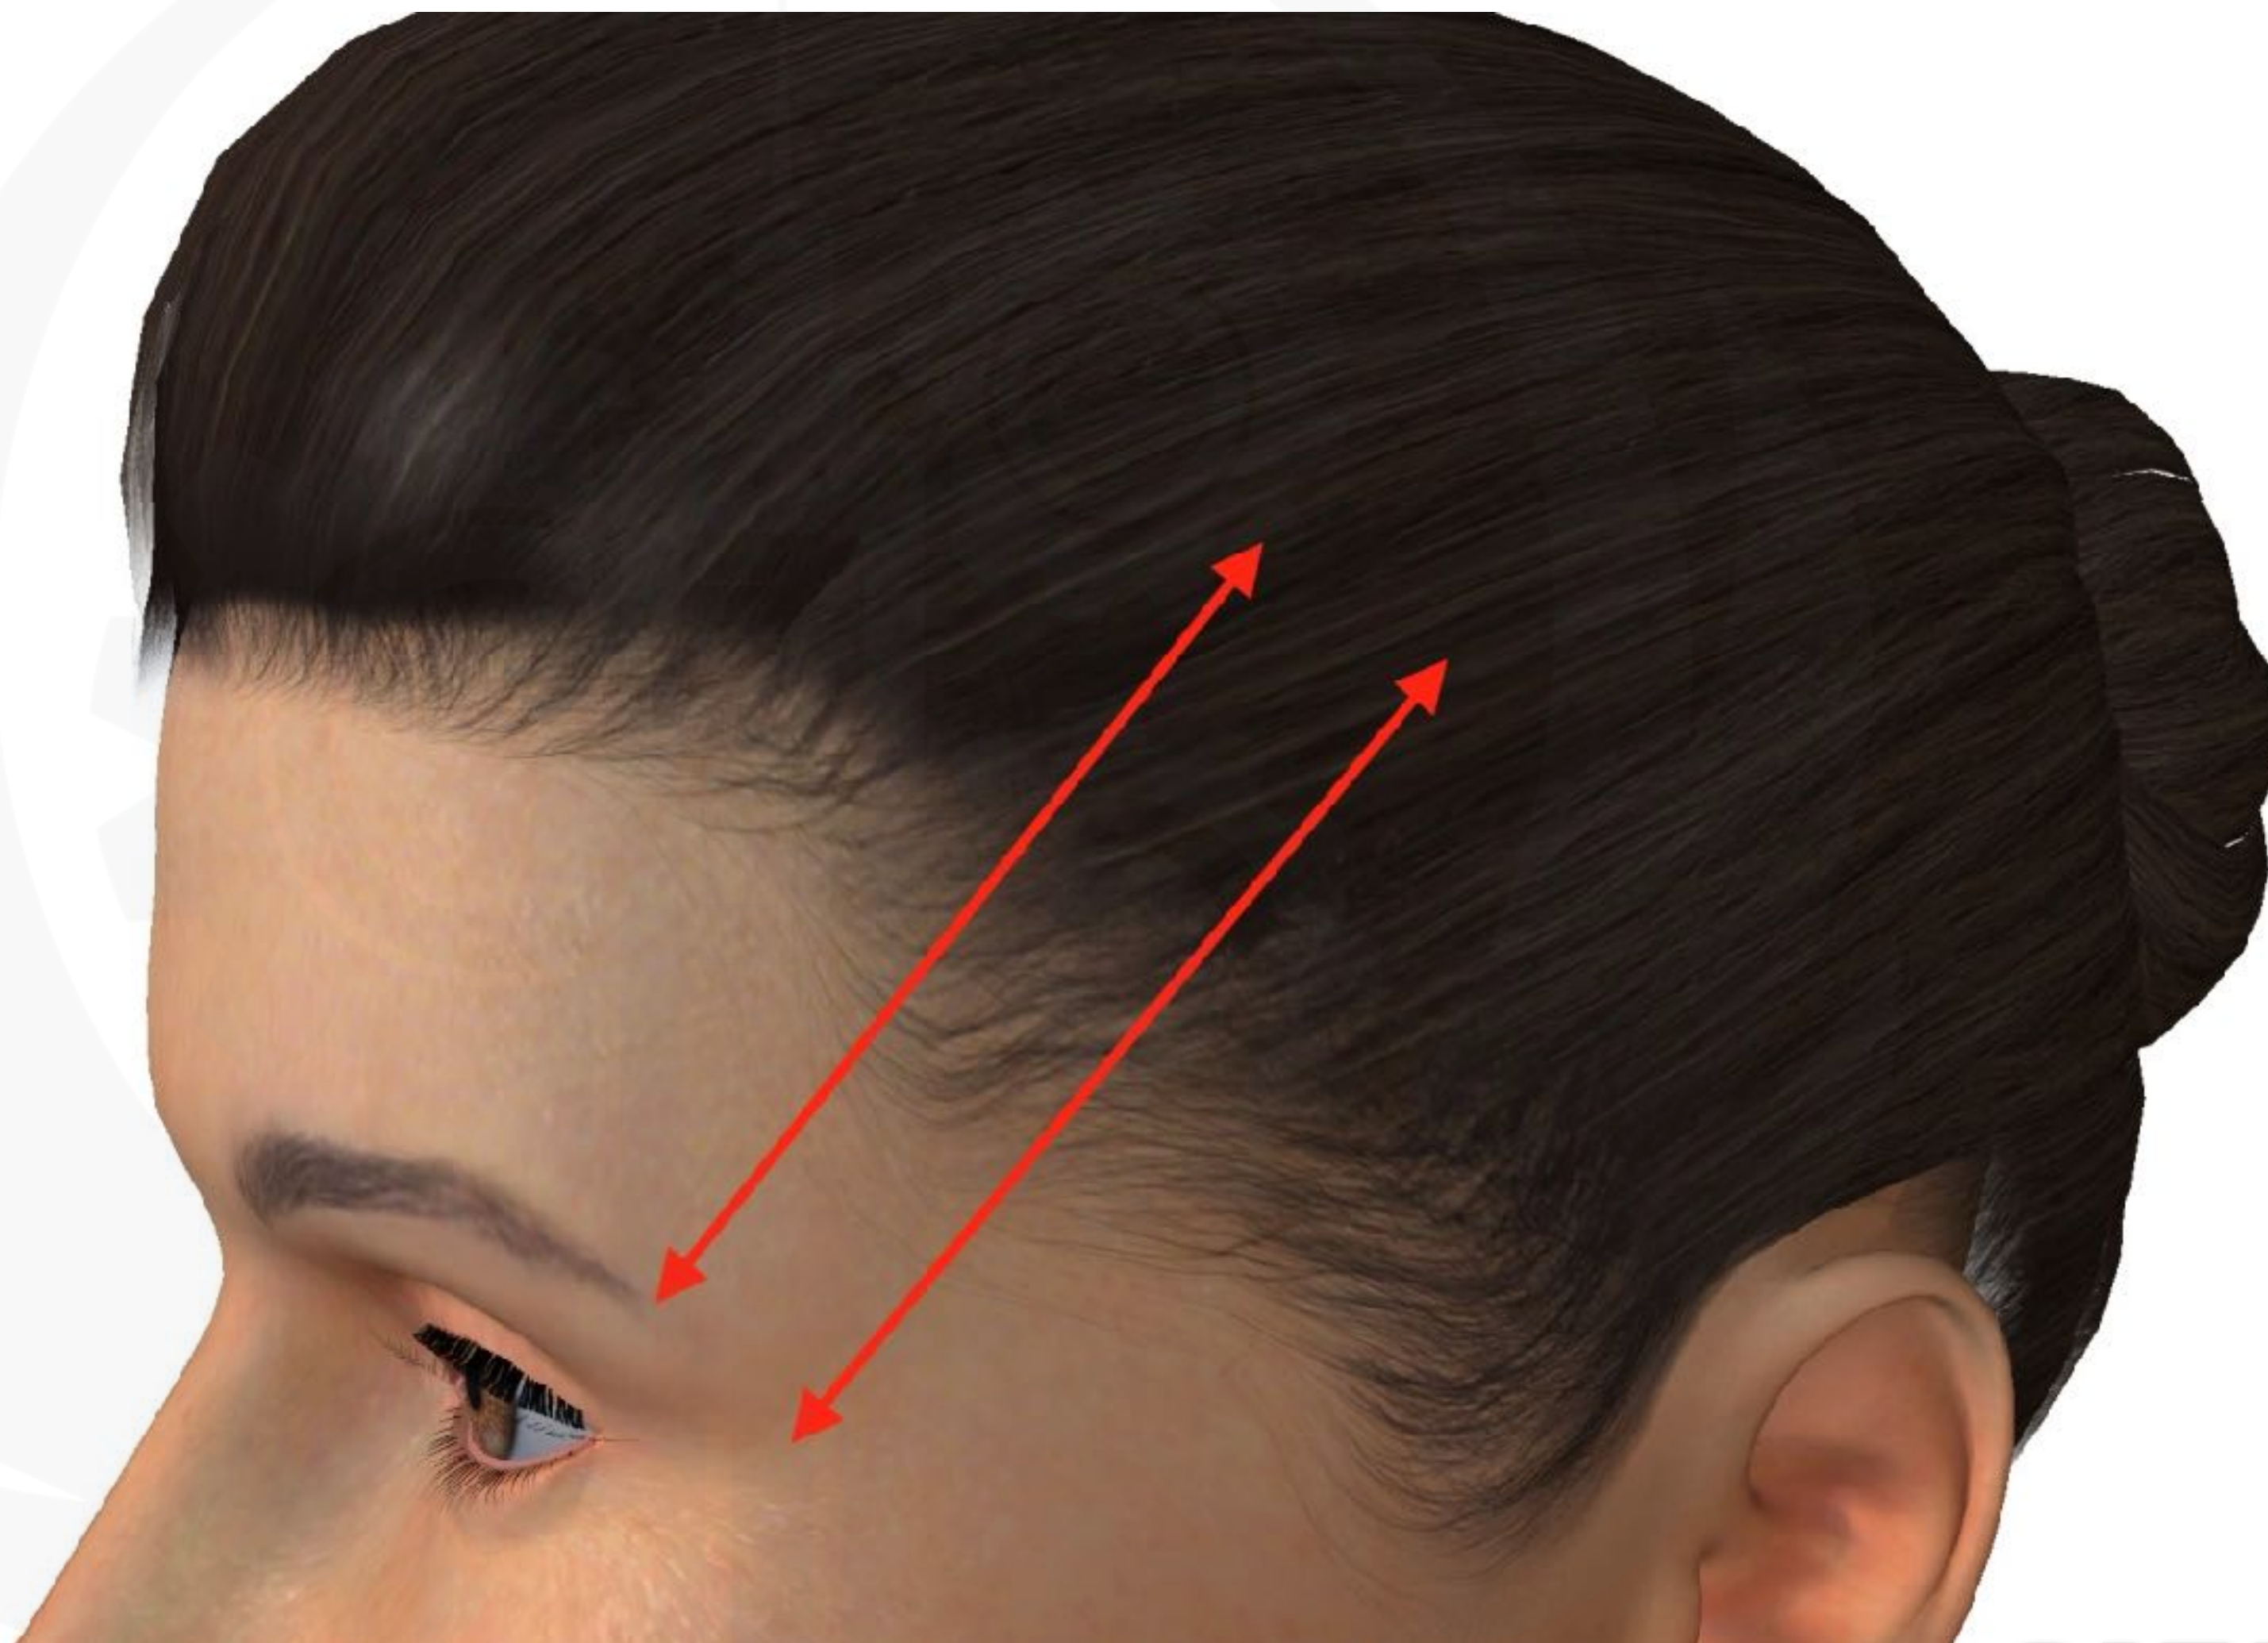


Установка нитей методом
«ЛИСЬИ ГЛАЗКИ»

СХЕМА ИМПЛАНТАЦИИ Mint Fine

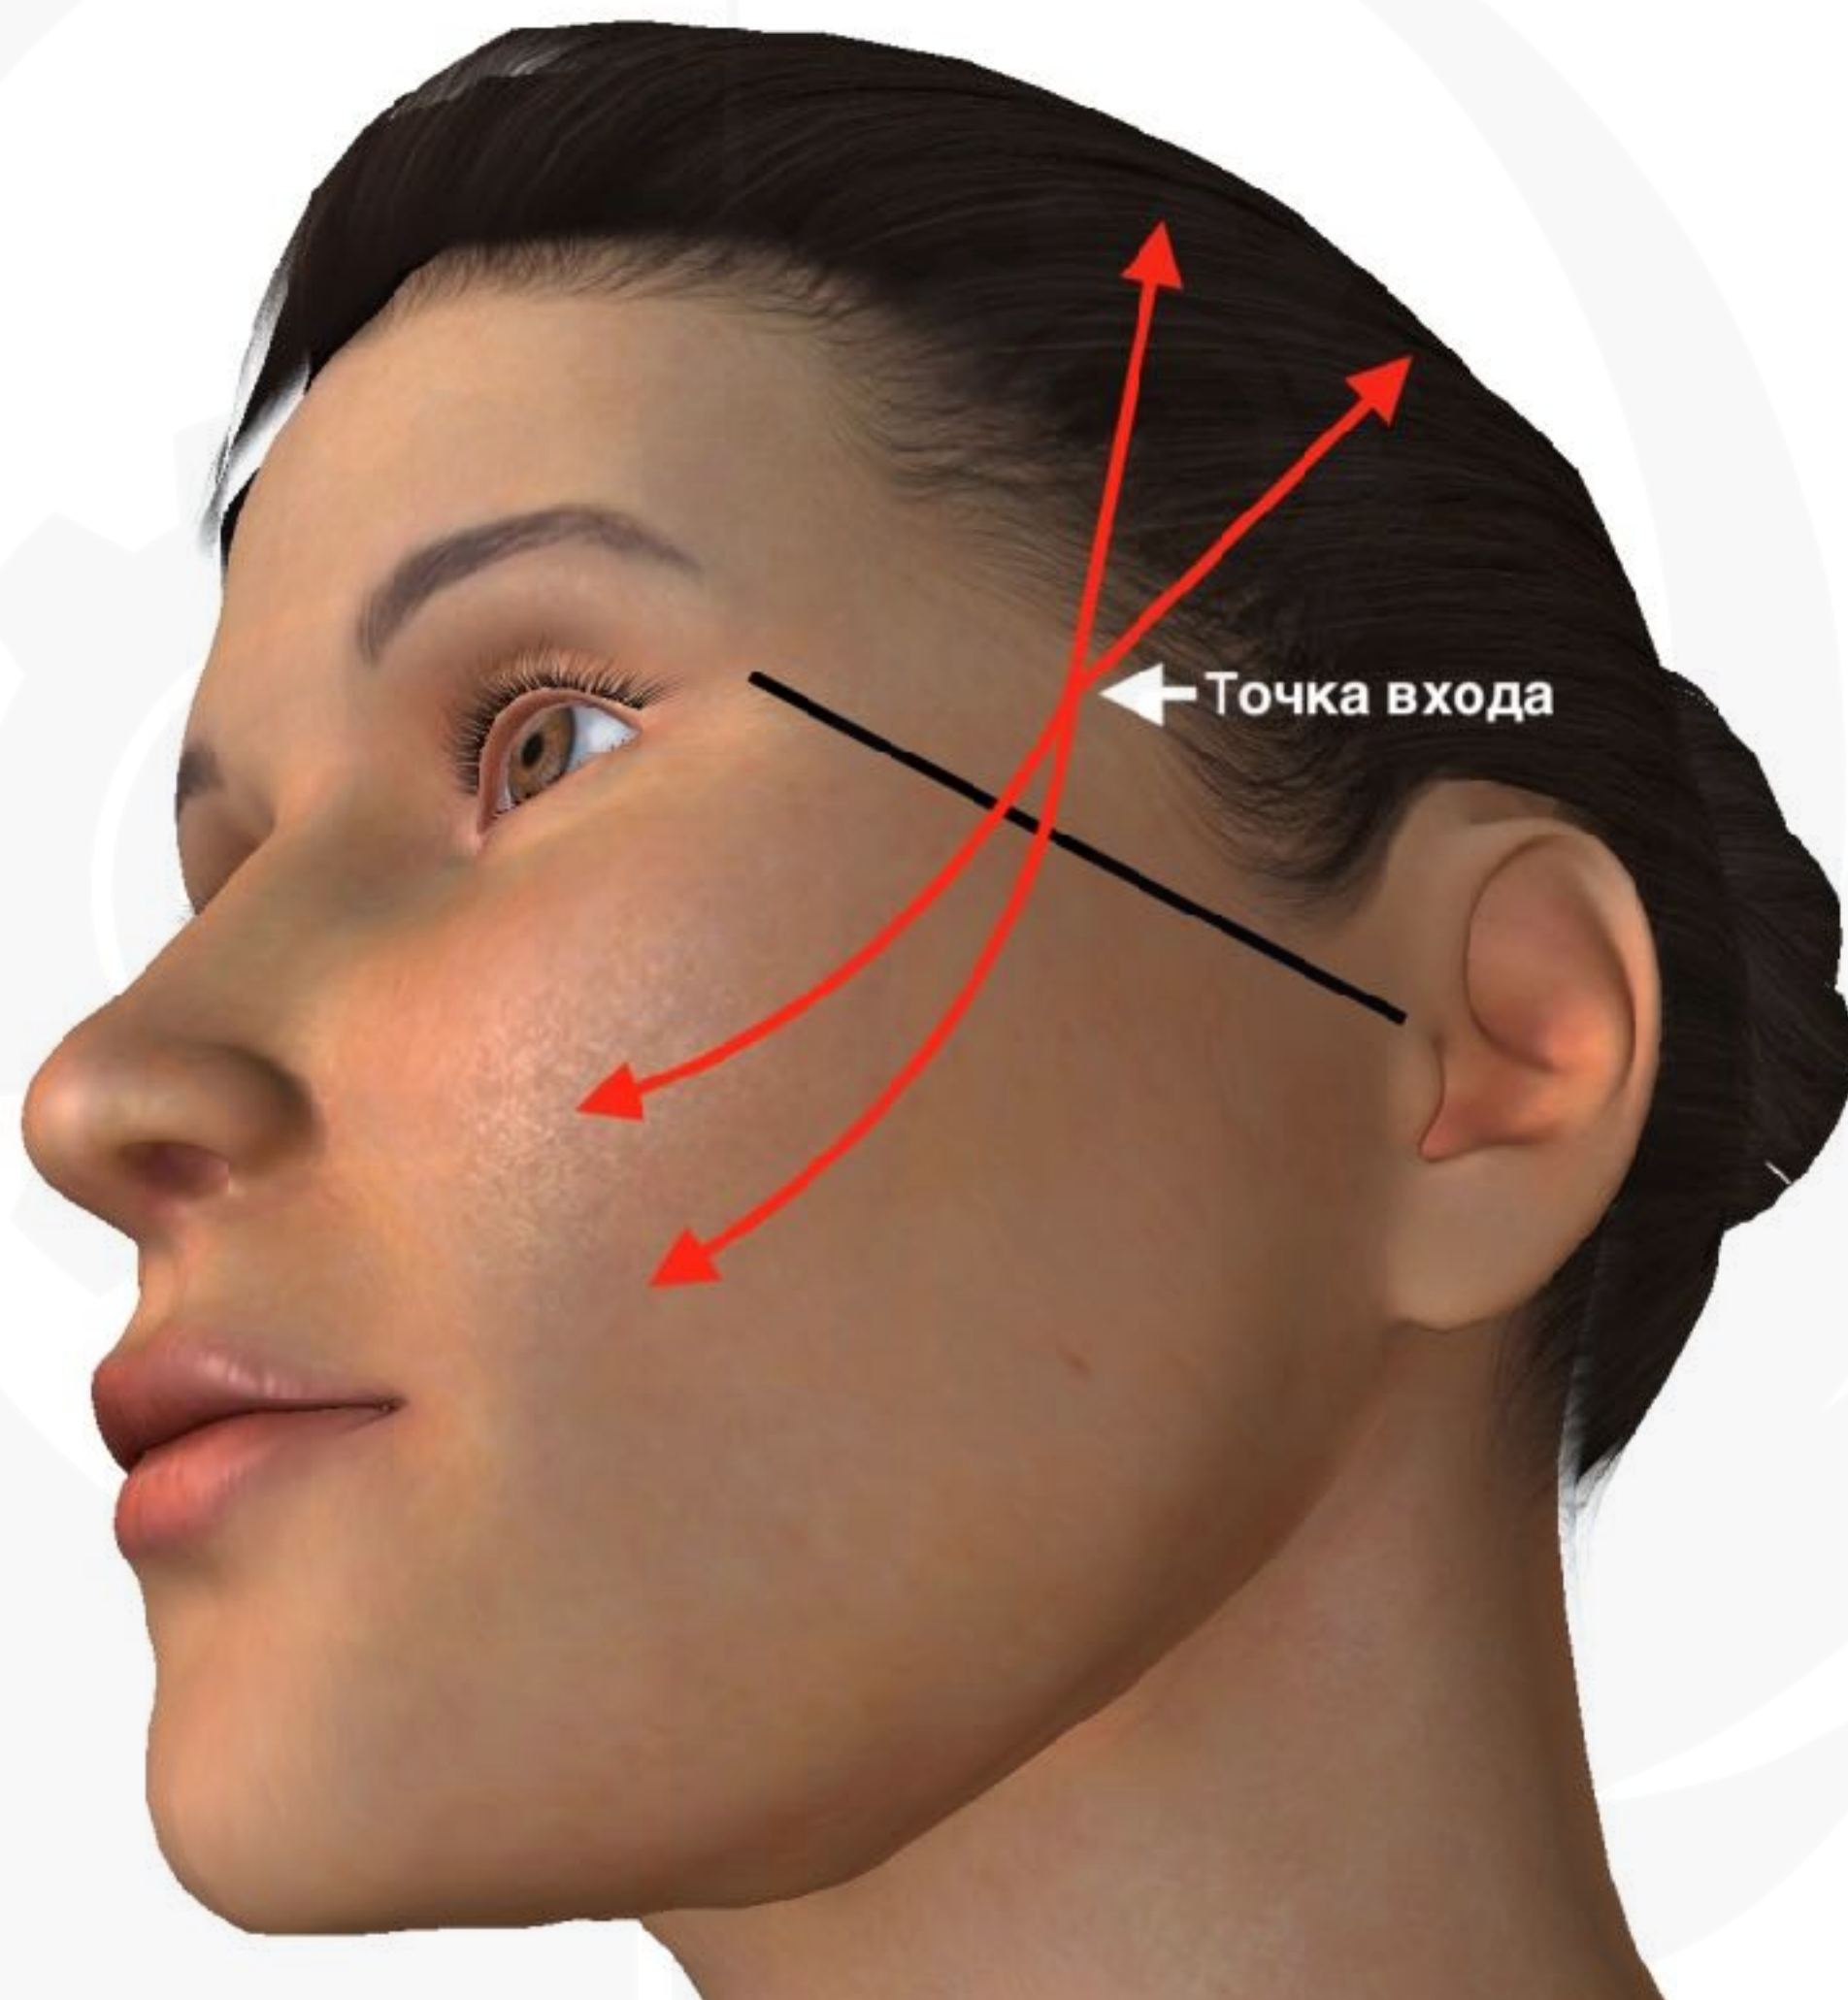


Установка нитей методом
«скуловой лифтинг с разворотом»

СХЕМА ИМПЛАНТАЦИИ Mint Fine

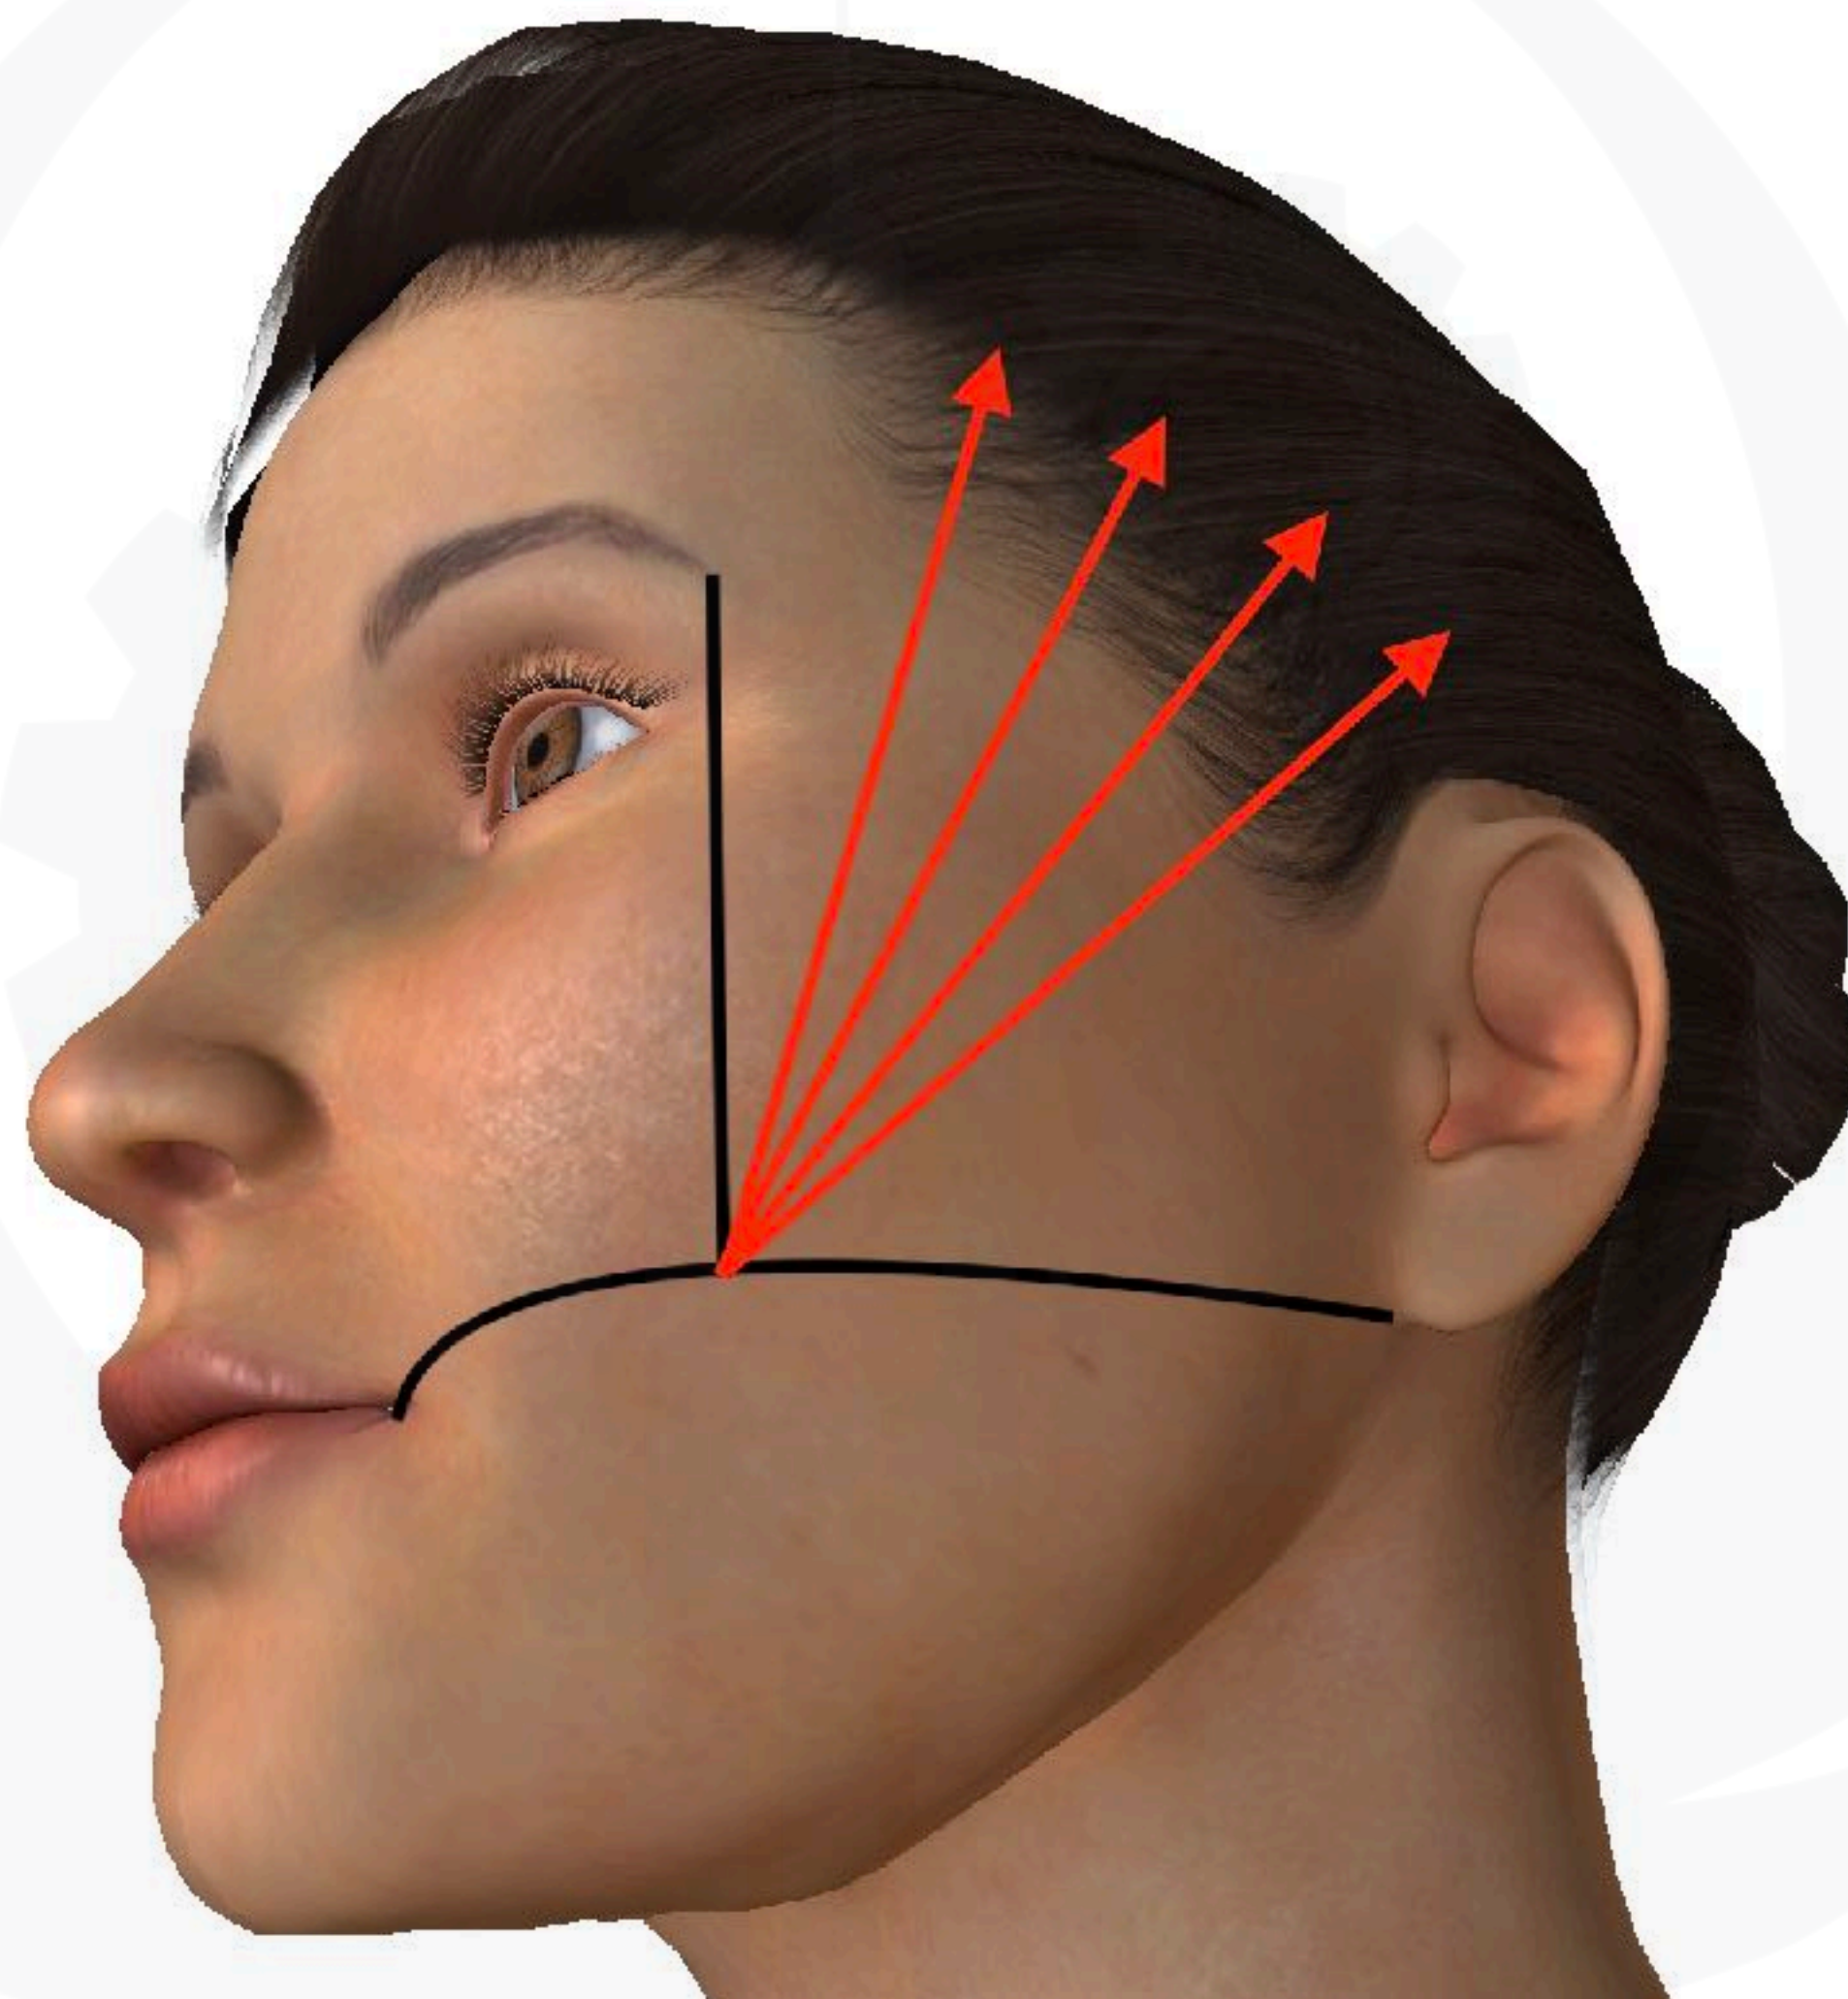

Установка нитей методом
«веерный восходящий лифтинг антибрыль»

СХЕМА ИМПЛАНТАЦИИ Mint Fine

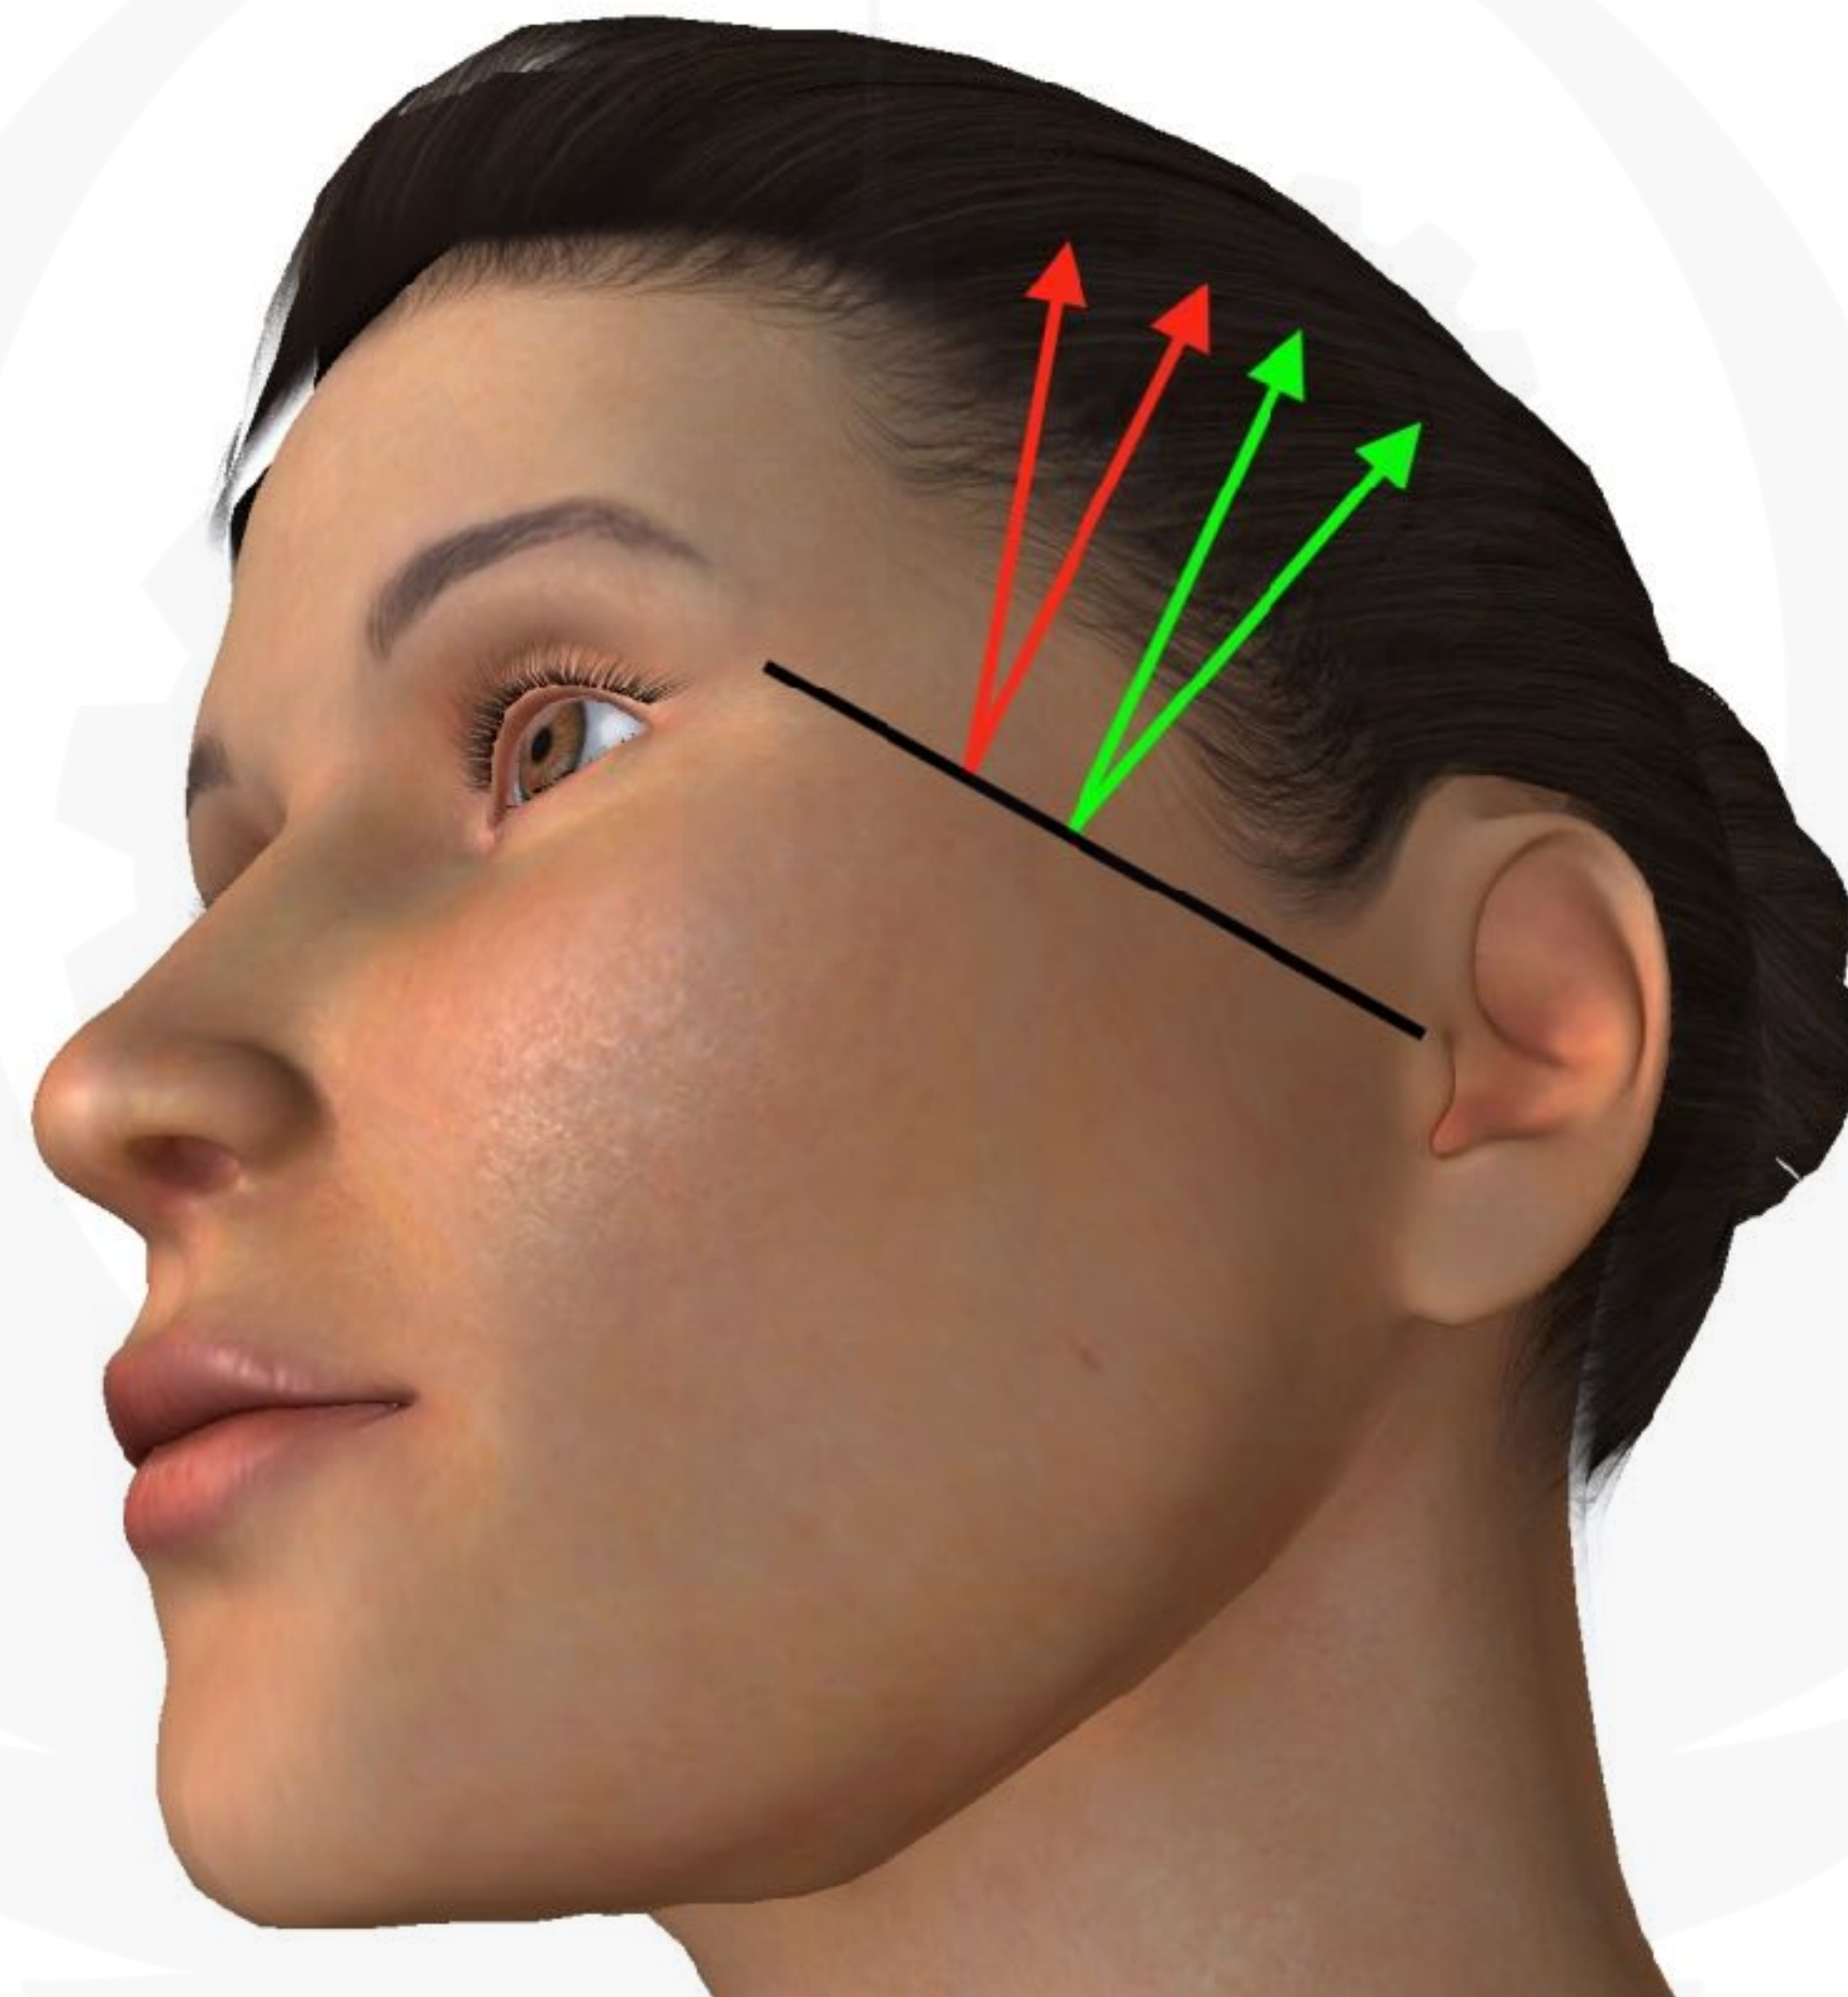


Установка нитей методом
«лифтинг височной зоны треугольная схема»

Результаты

Важное изобретение
человечества



Результаты

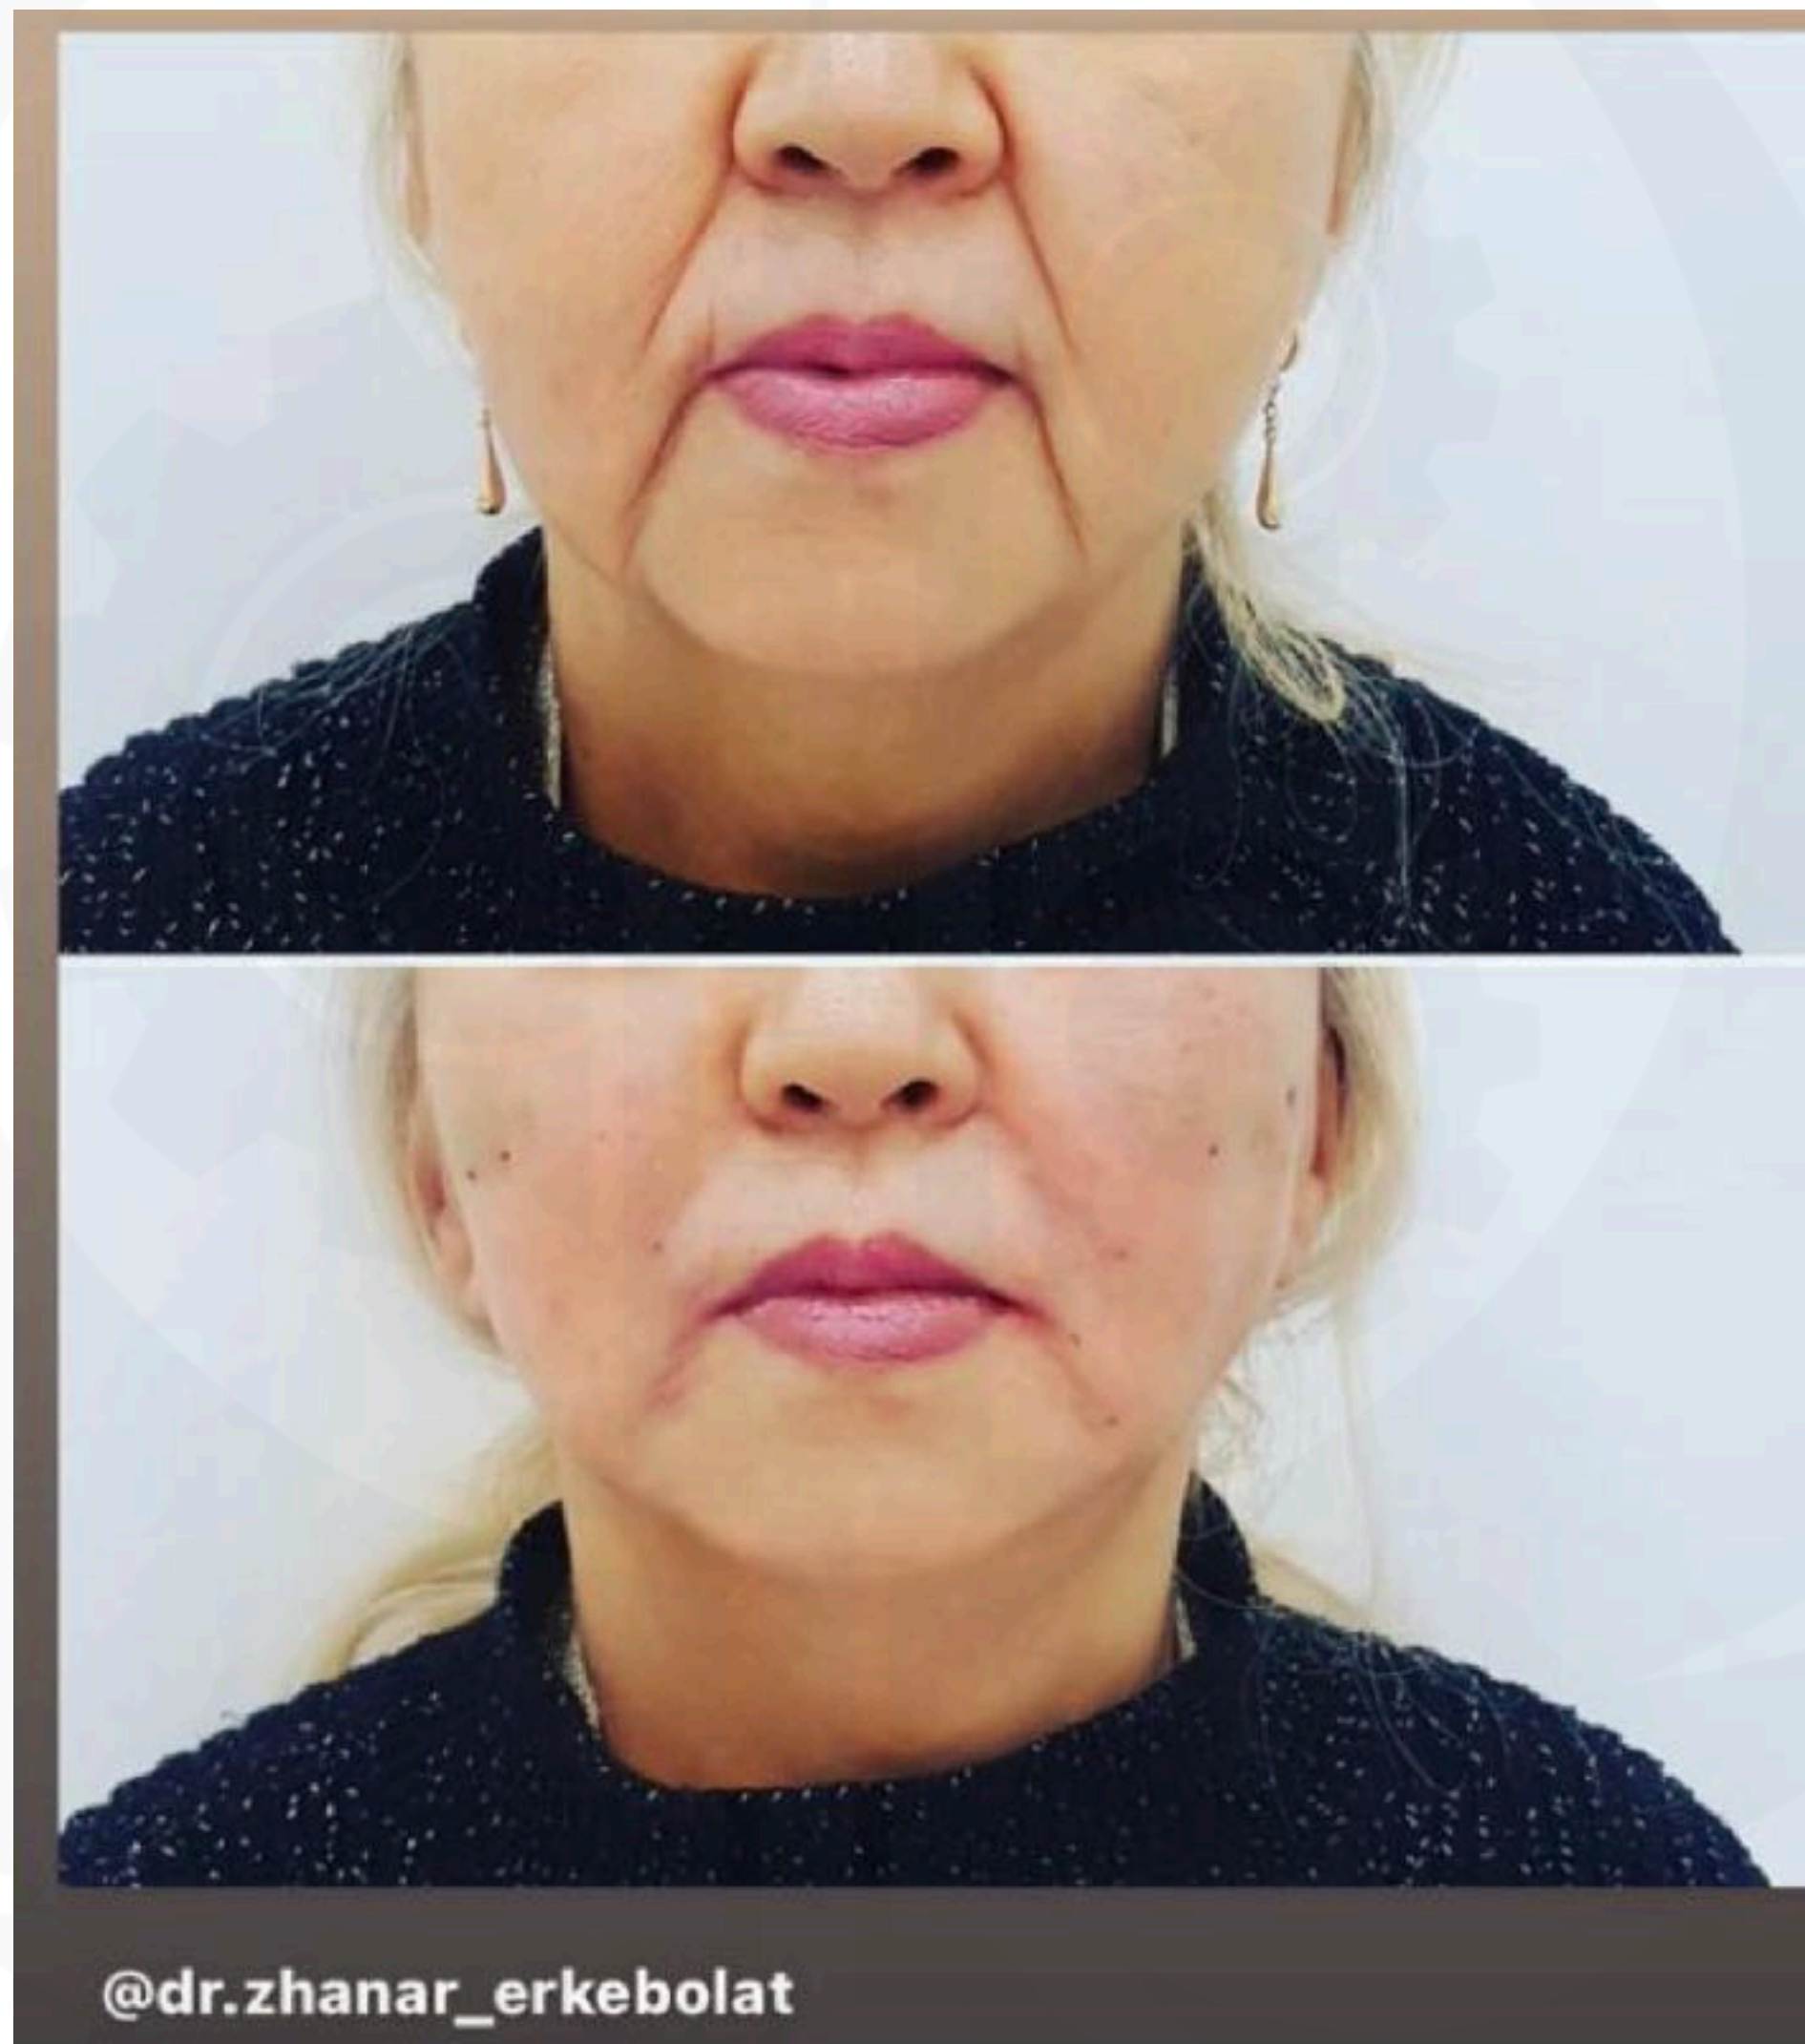


Результаты



@dr.madina_budakova

Результаты

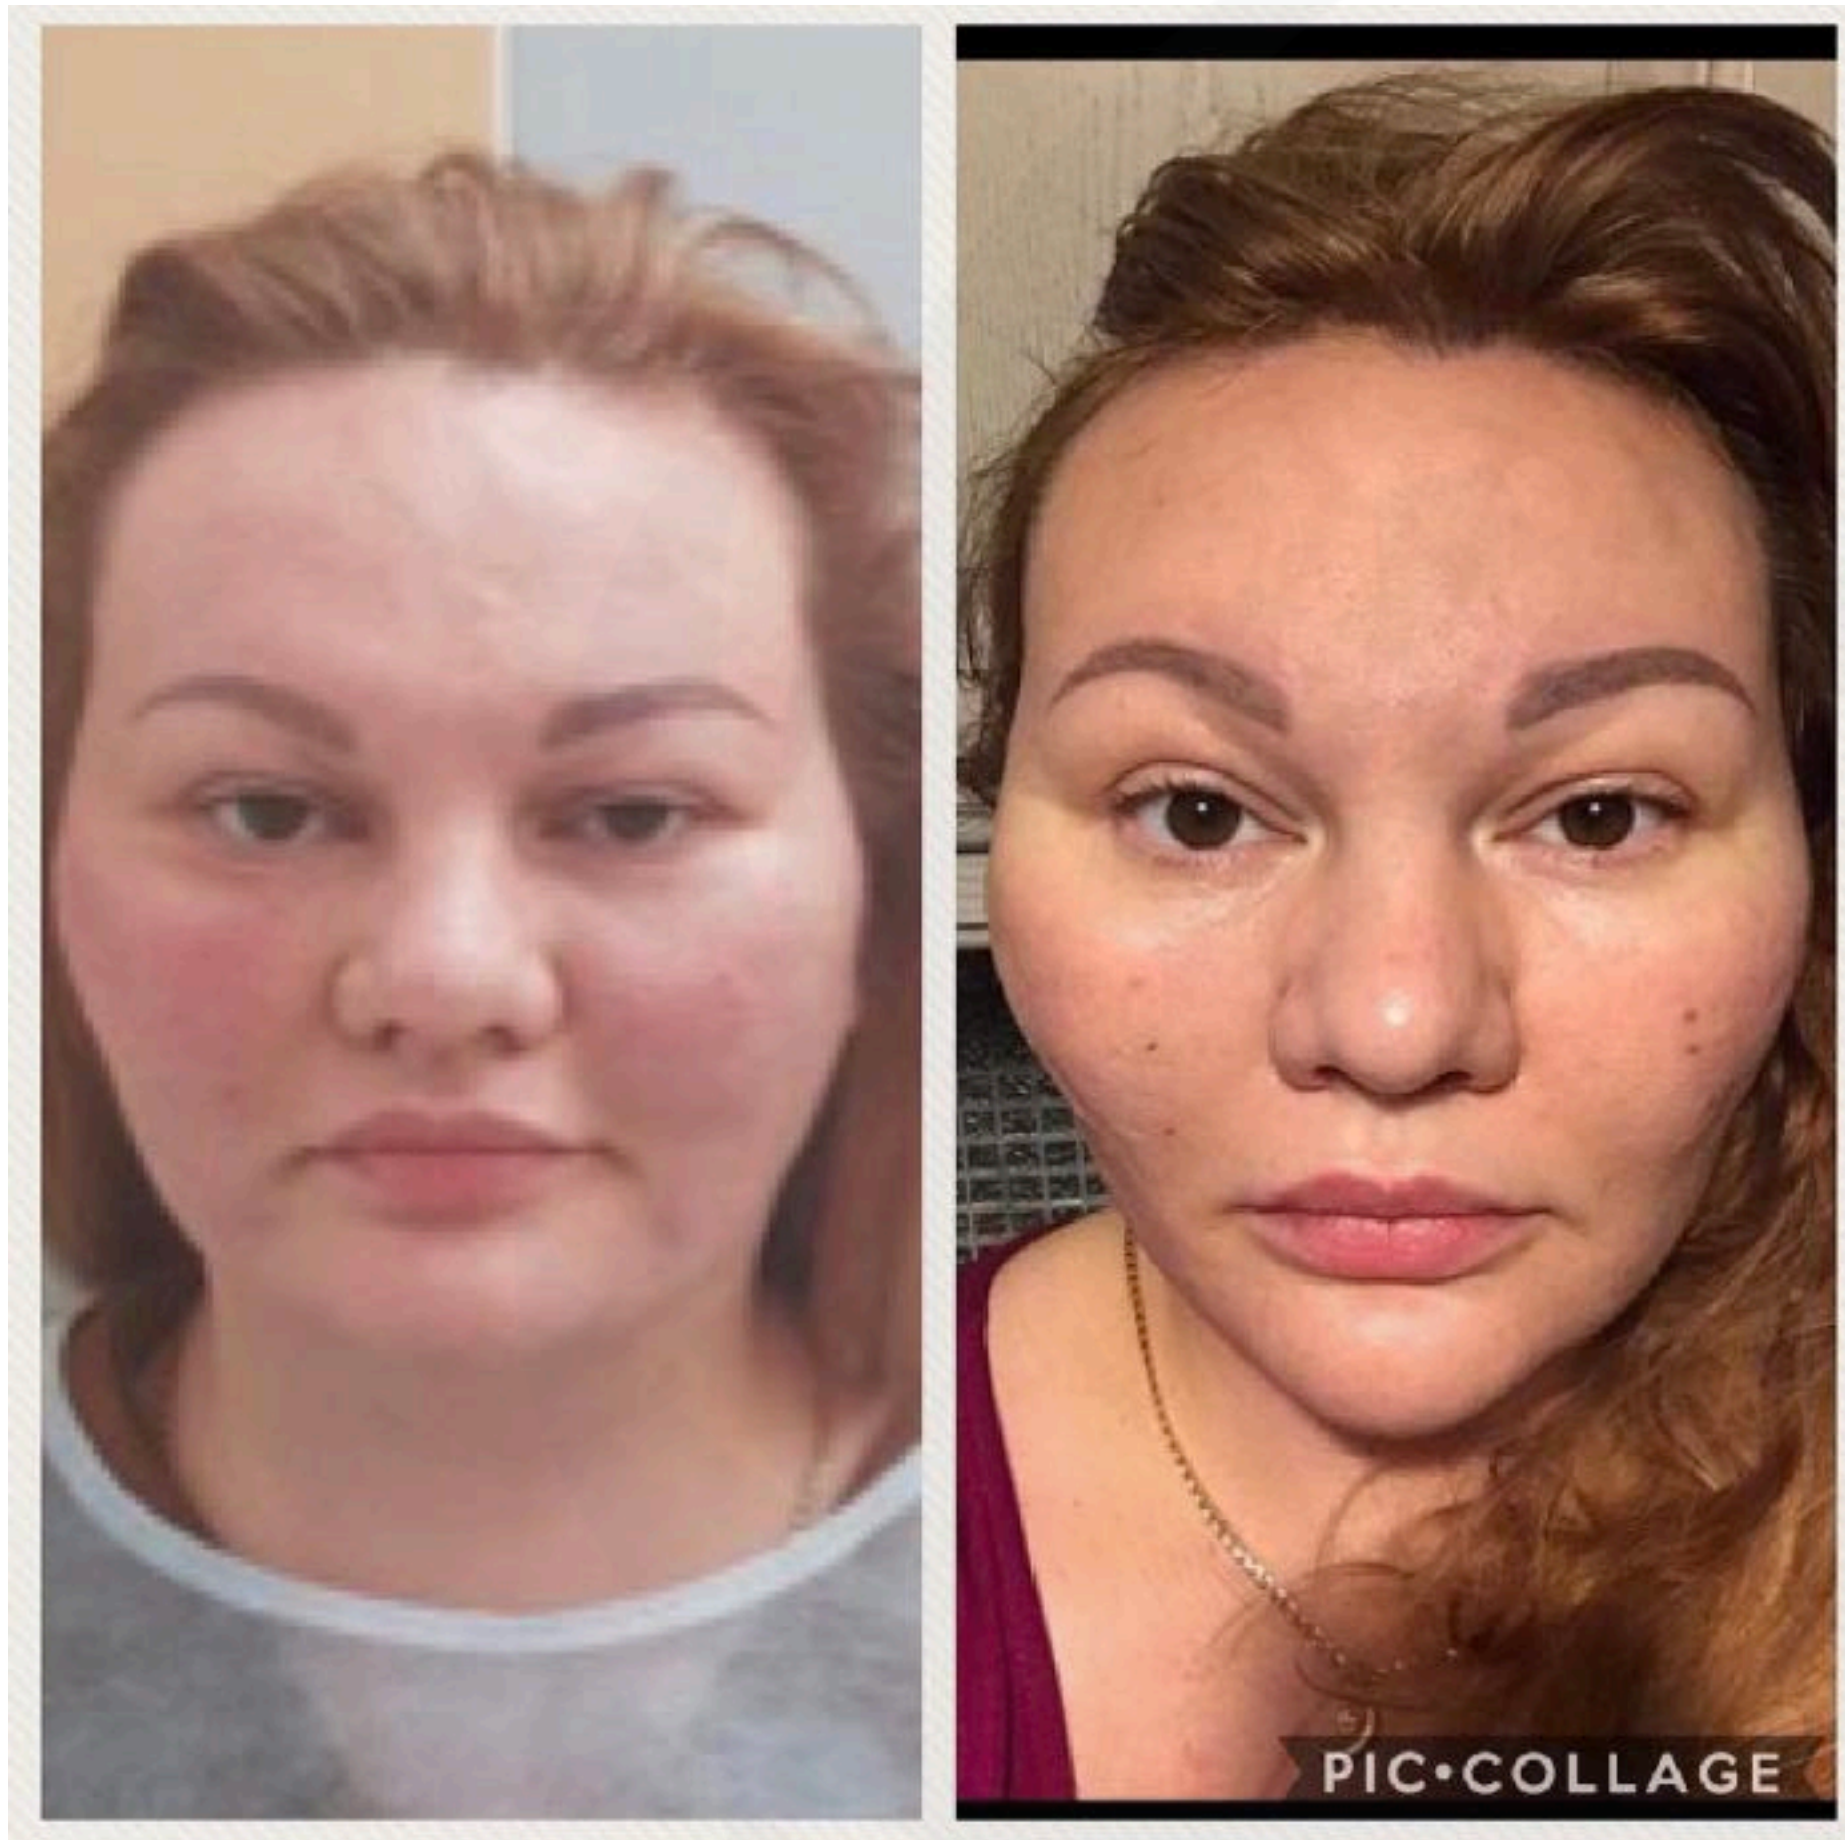


Ноябрь 2018




Спустя 6 месяцев

Результаты

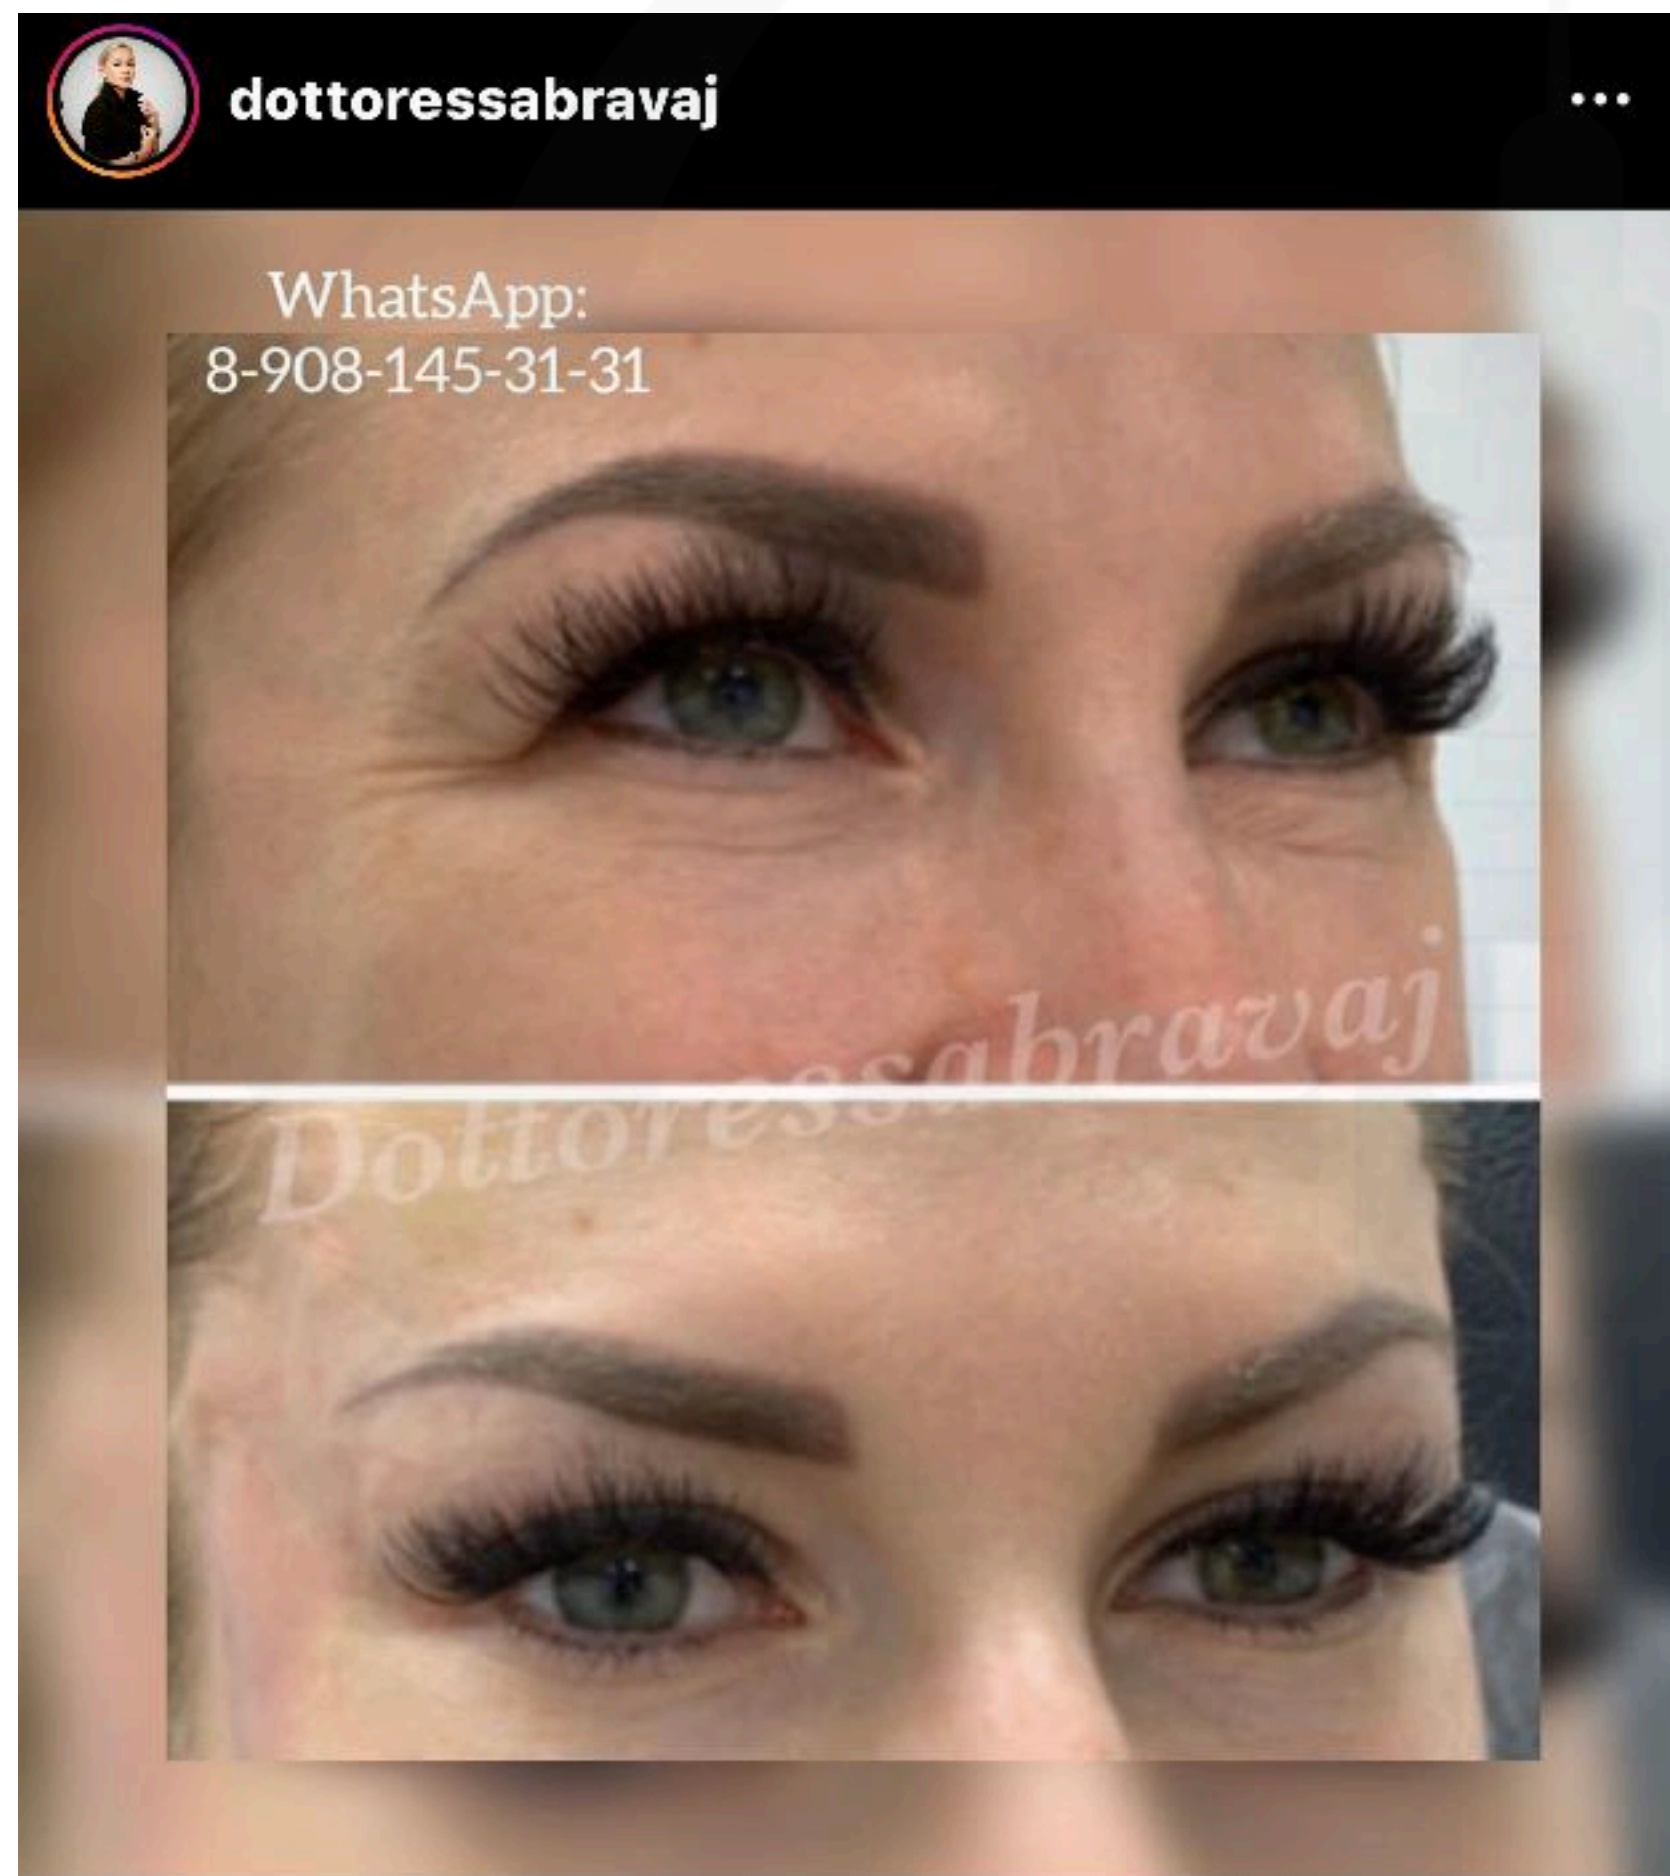

Результаты

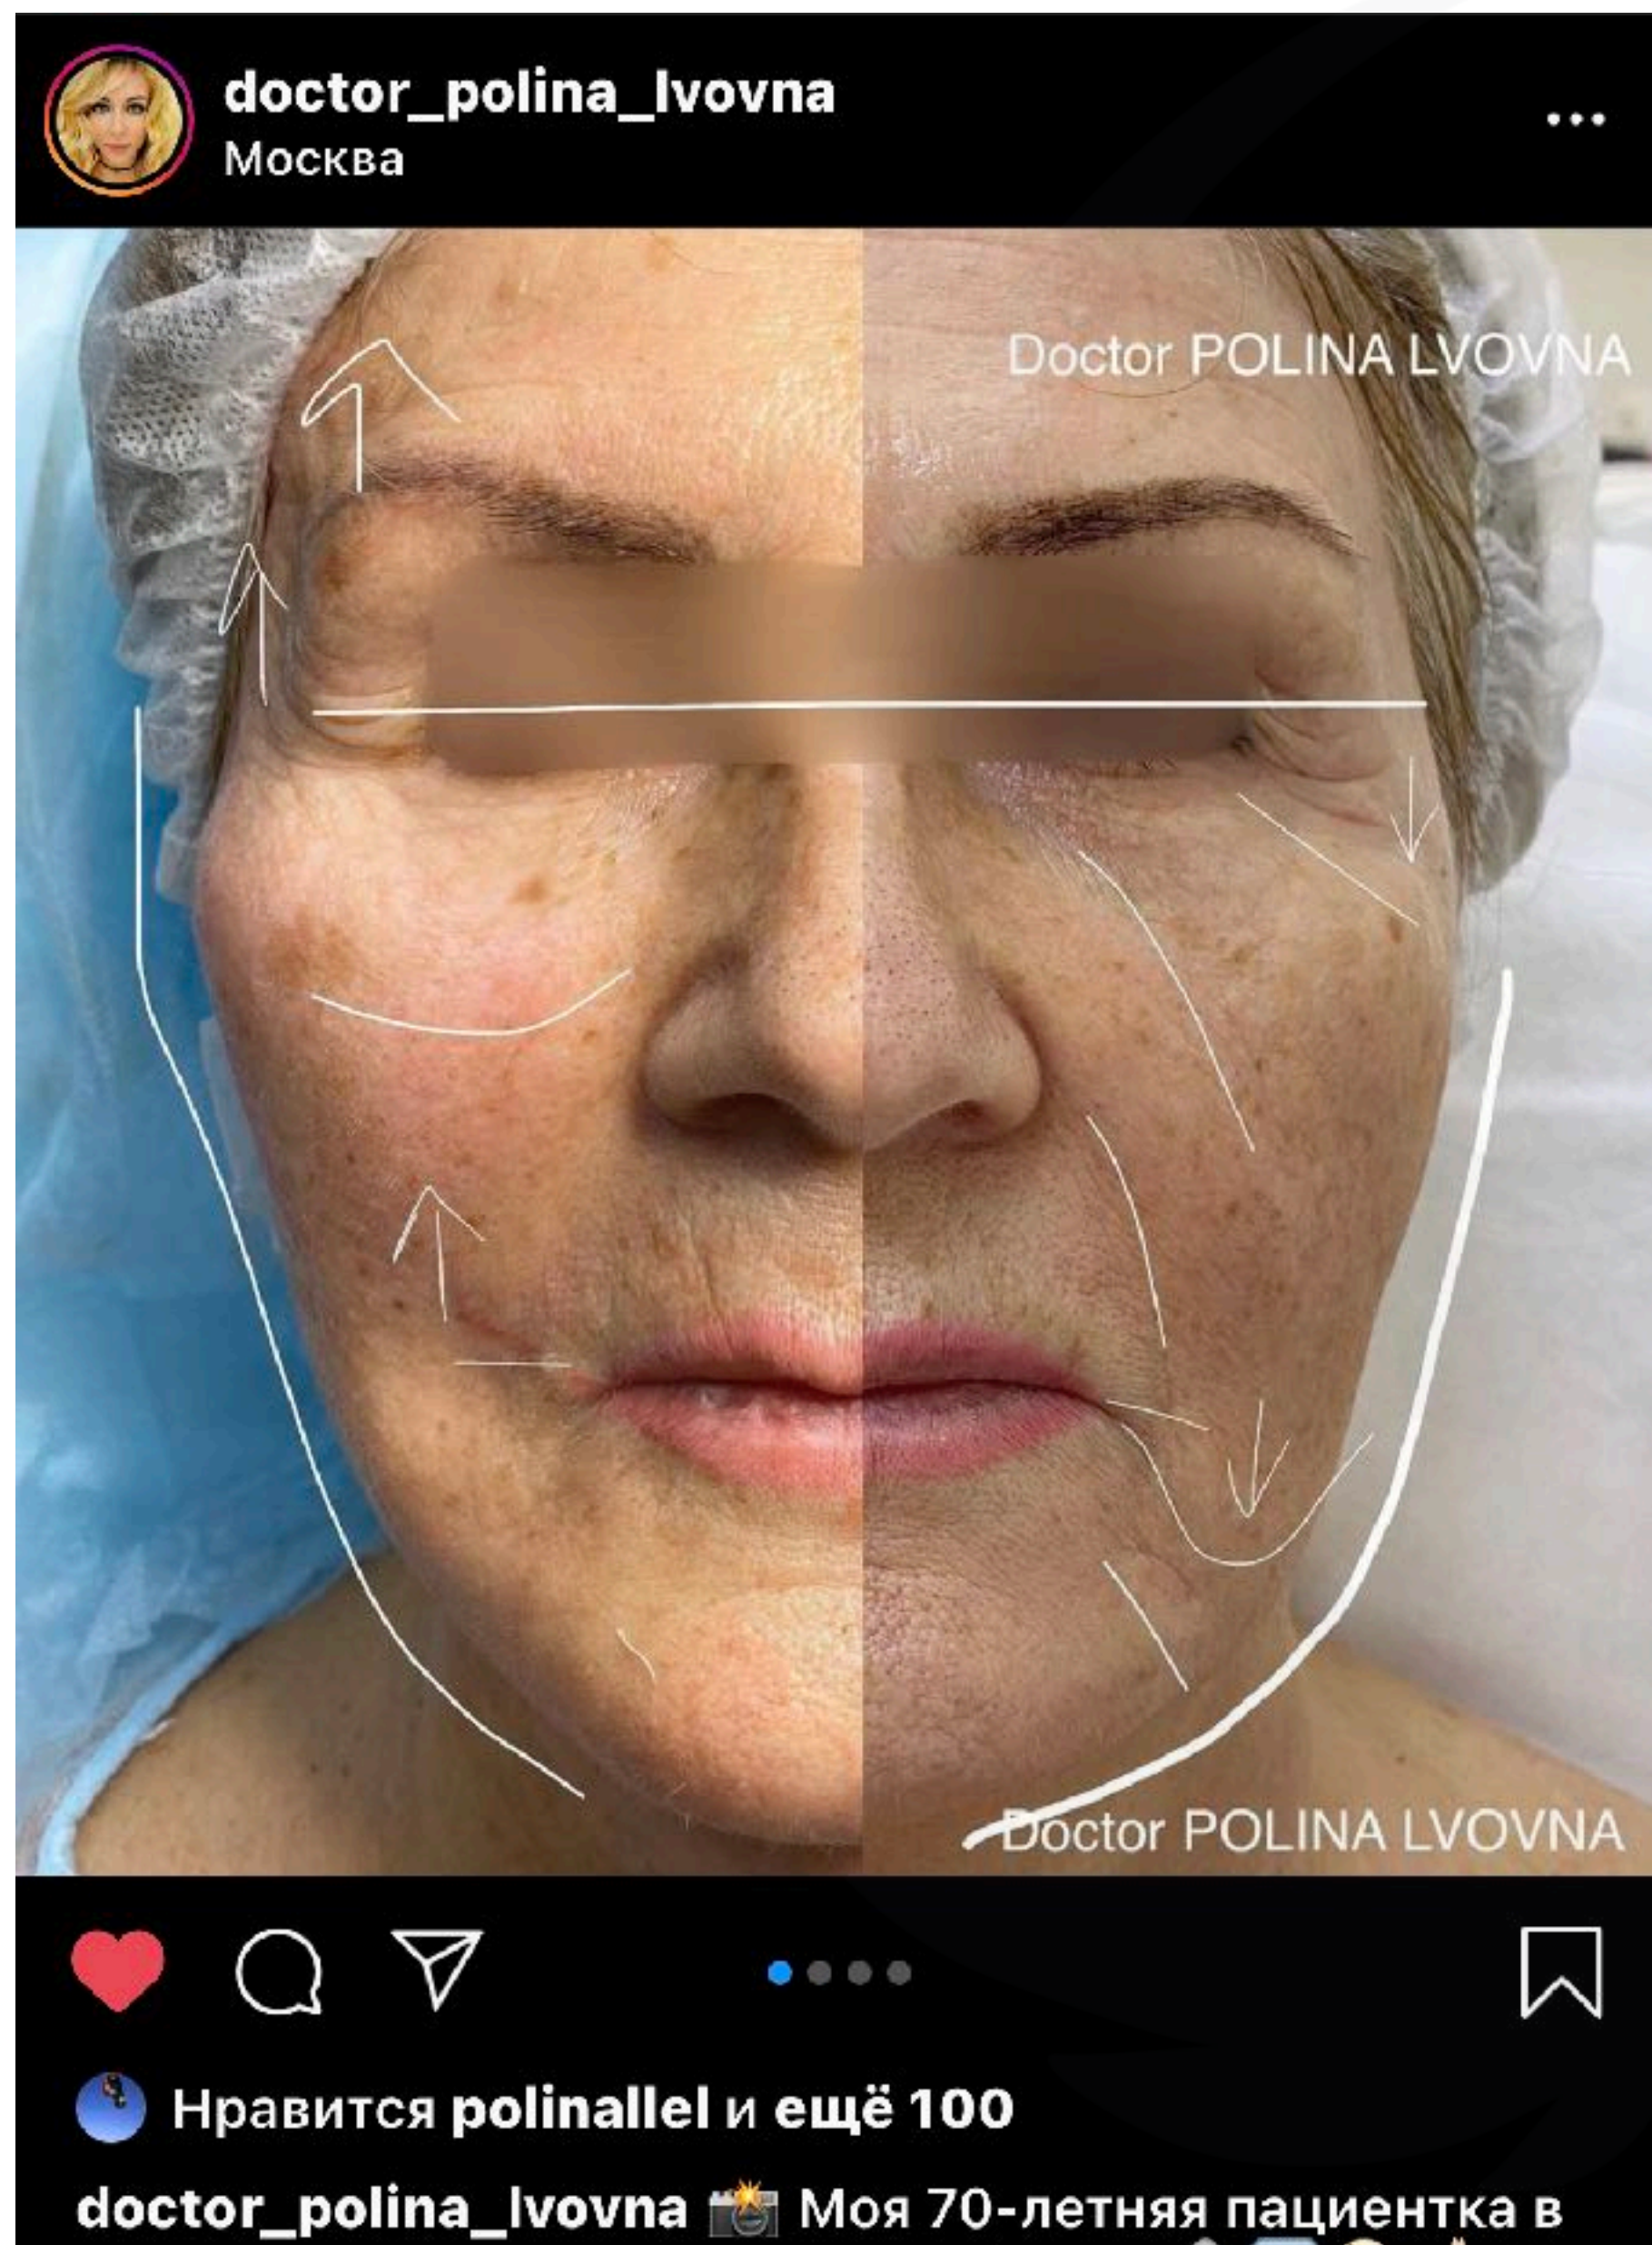

Результат V – LIFT Нить mint mini



Результат V – LIFT Нити mint fine



Результат V – LIFT Нить mint mini



Результат V – LIFT Нижней трети на mint easy



Результат V – LIFT Нити mint fine



Результаты




Результаты





Результат V – LIFT Нить mint mini и mint lift



Результаты

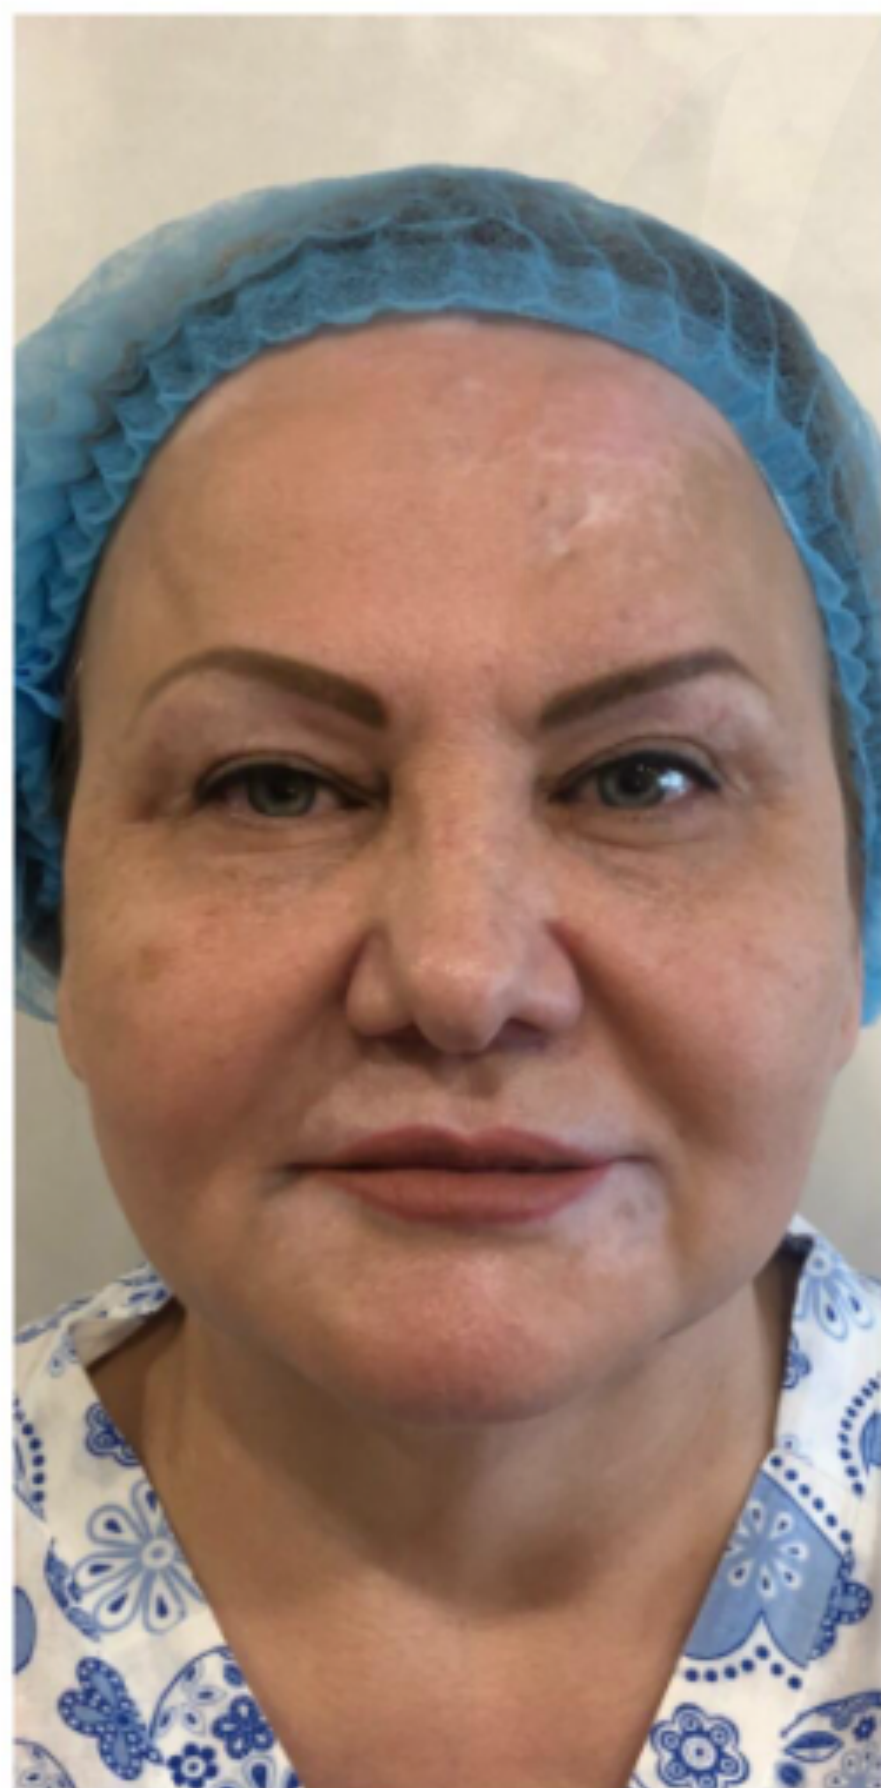

Результаты

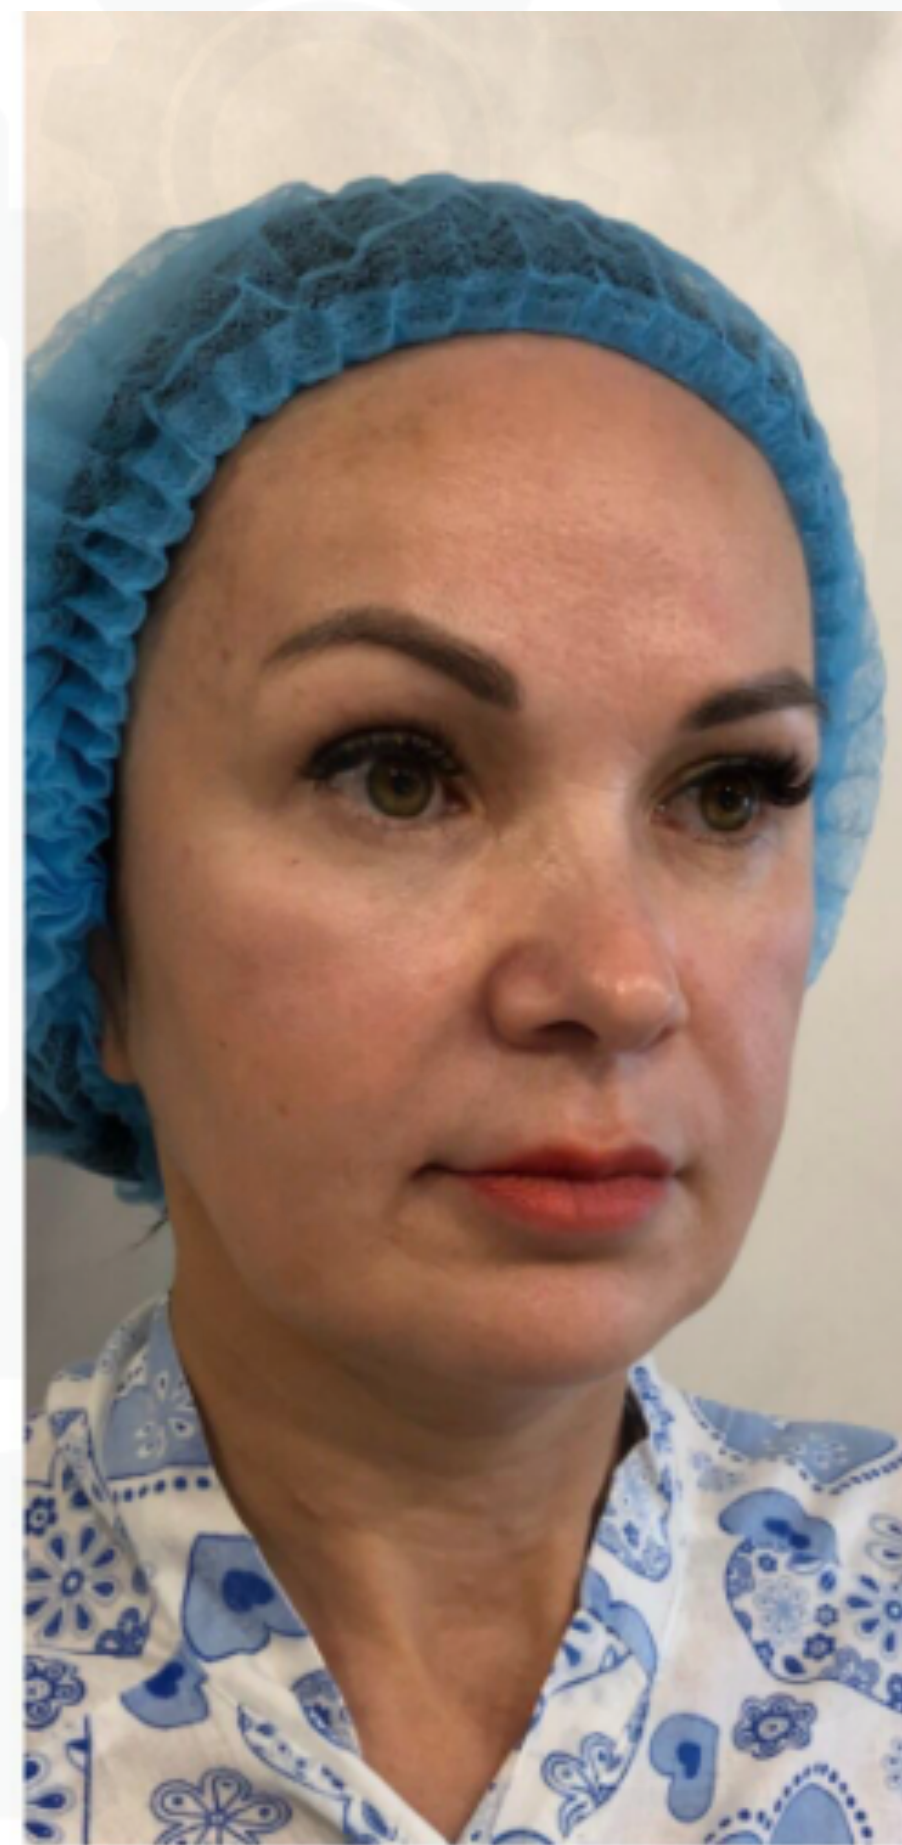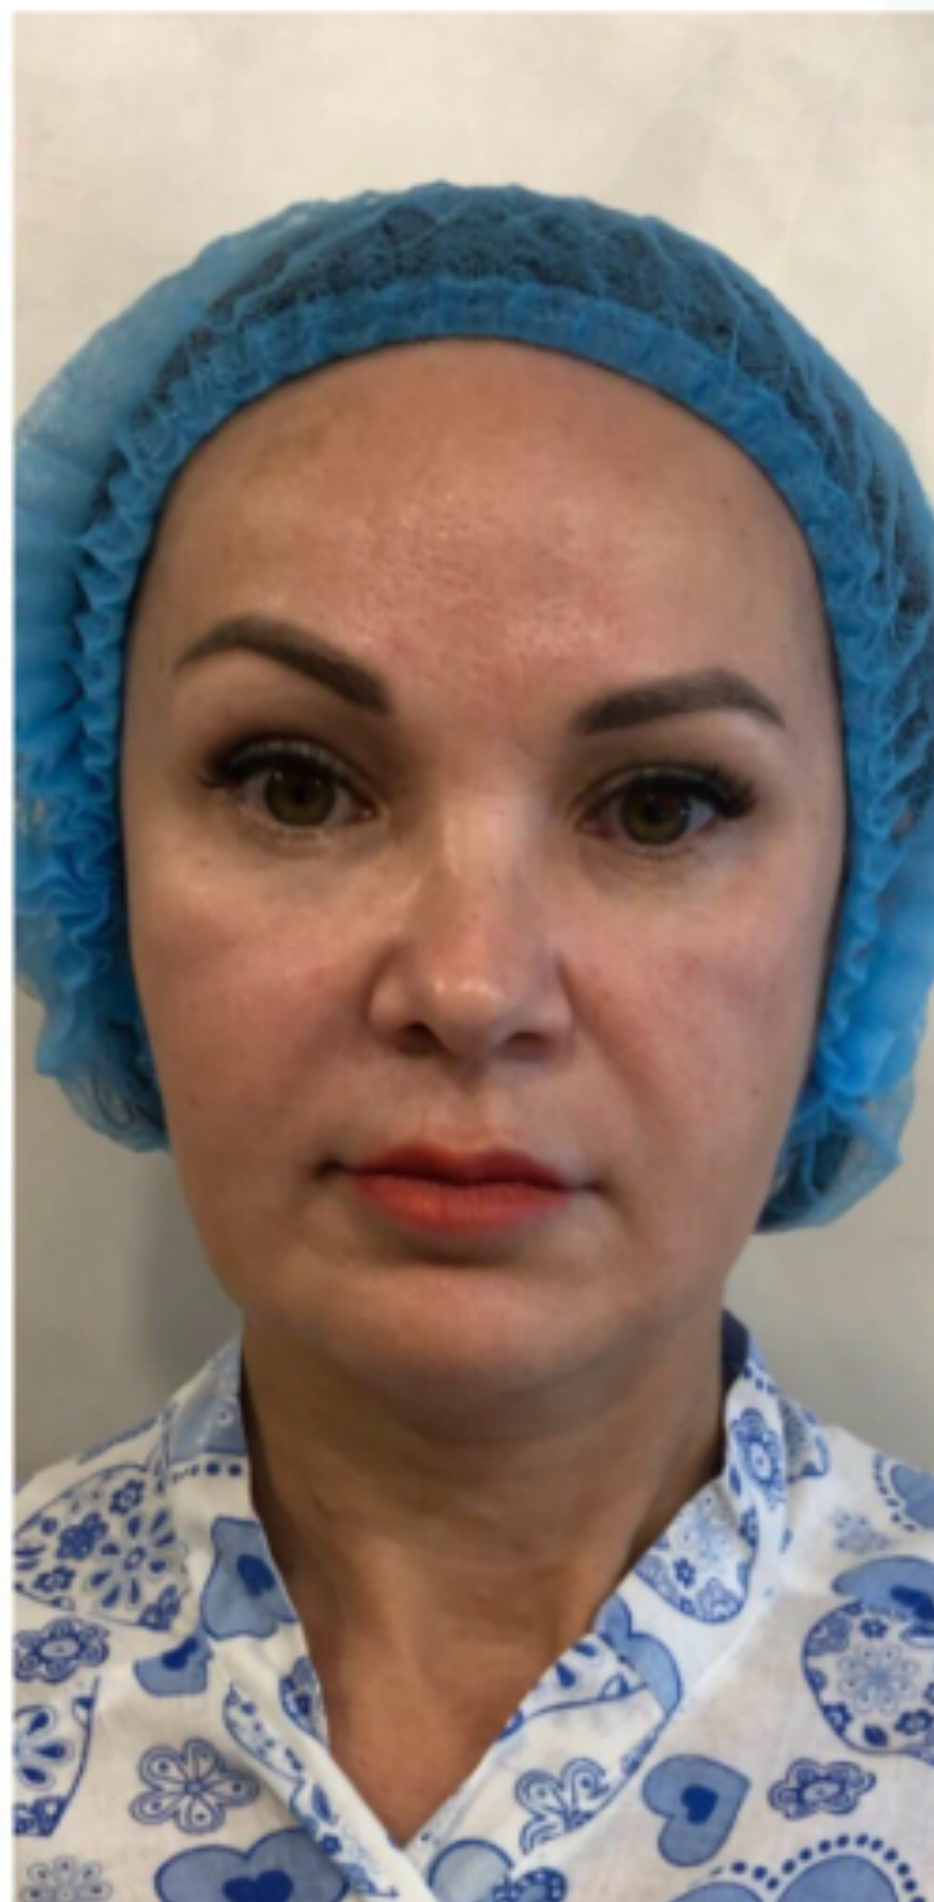

Результаты



Результаты




Результаты




Результаты



Результаты

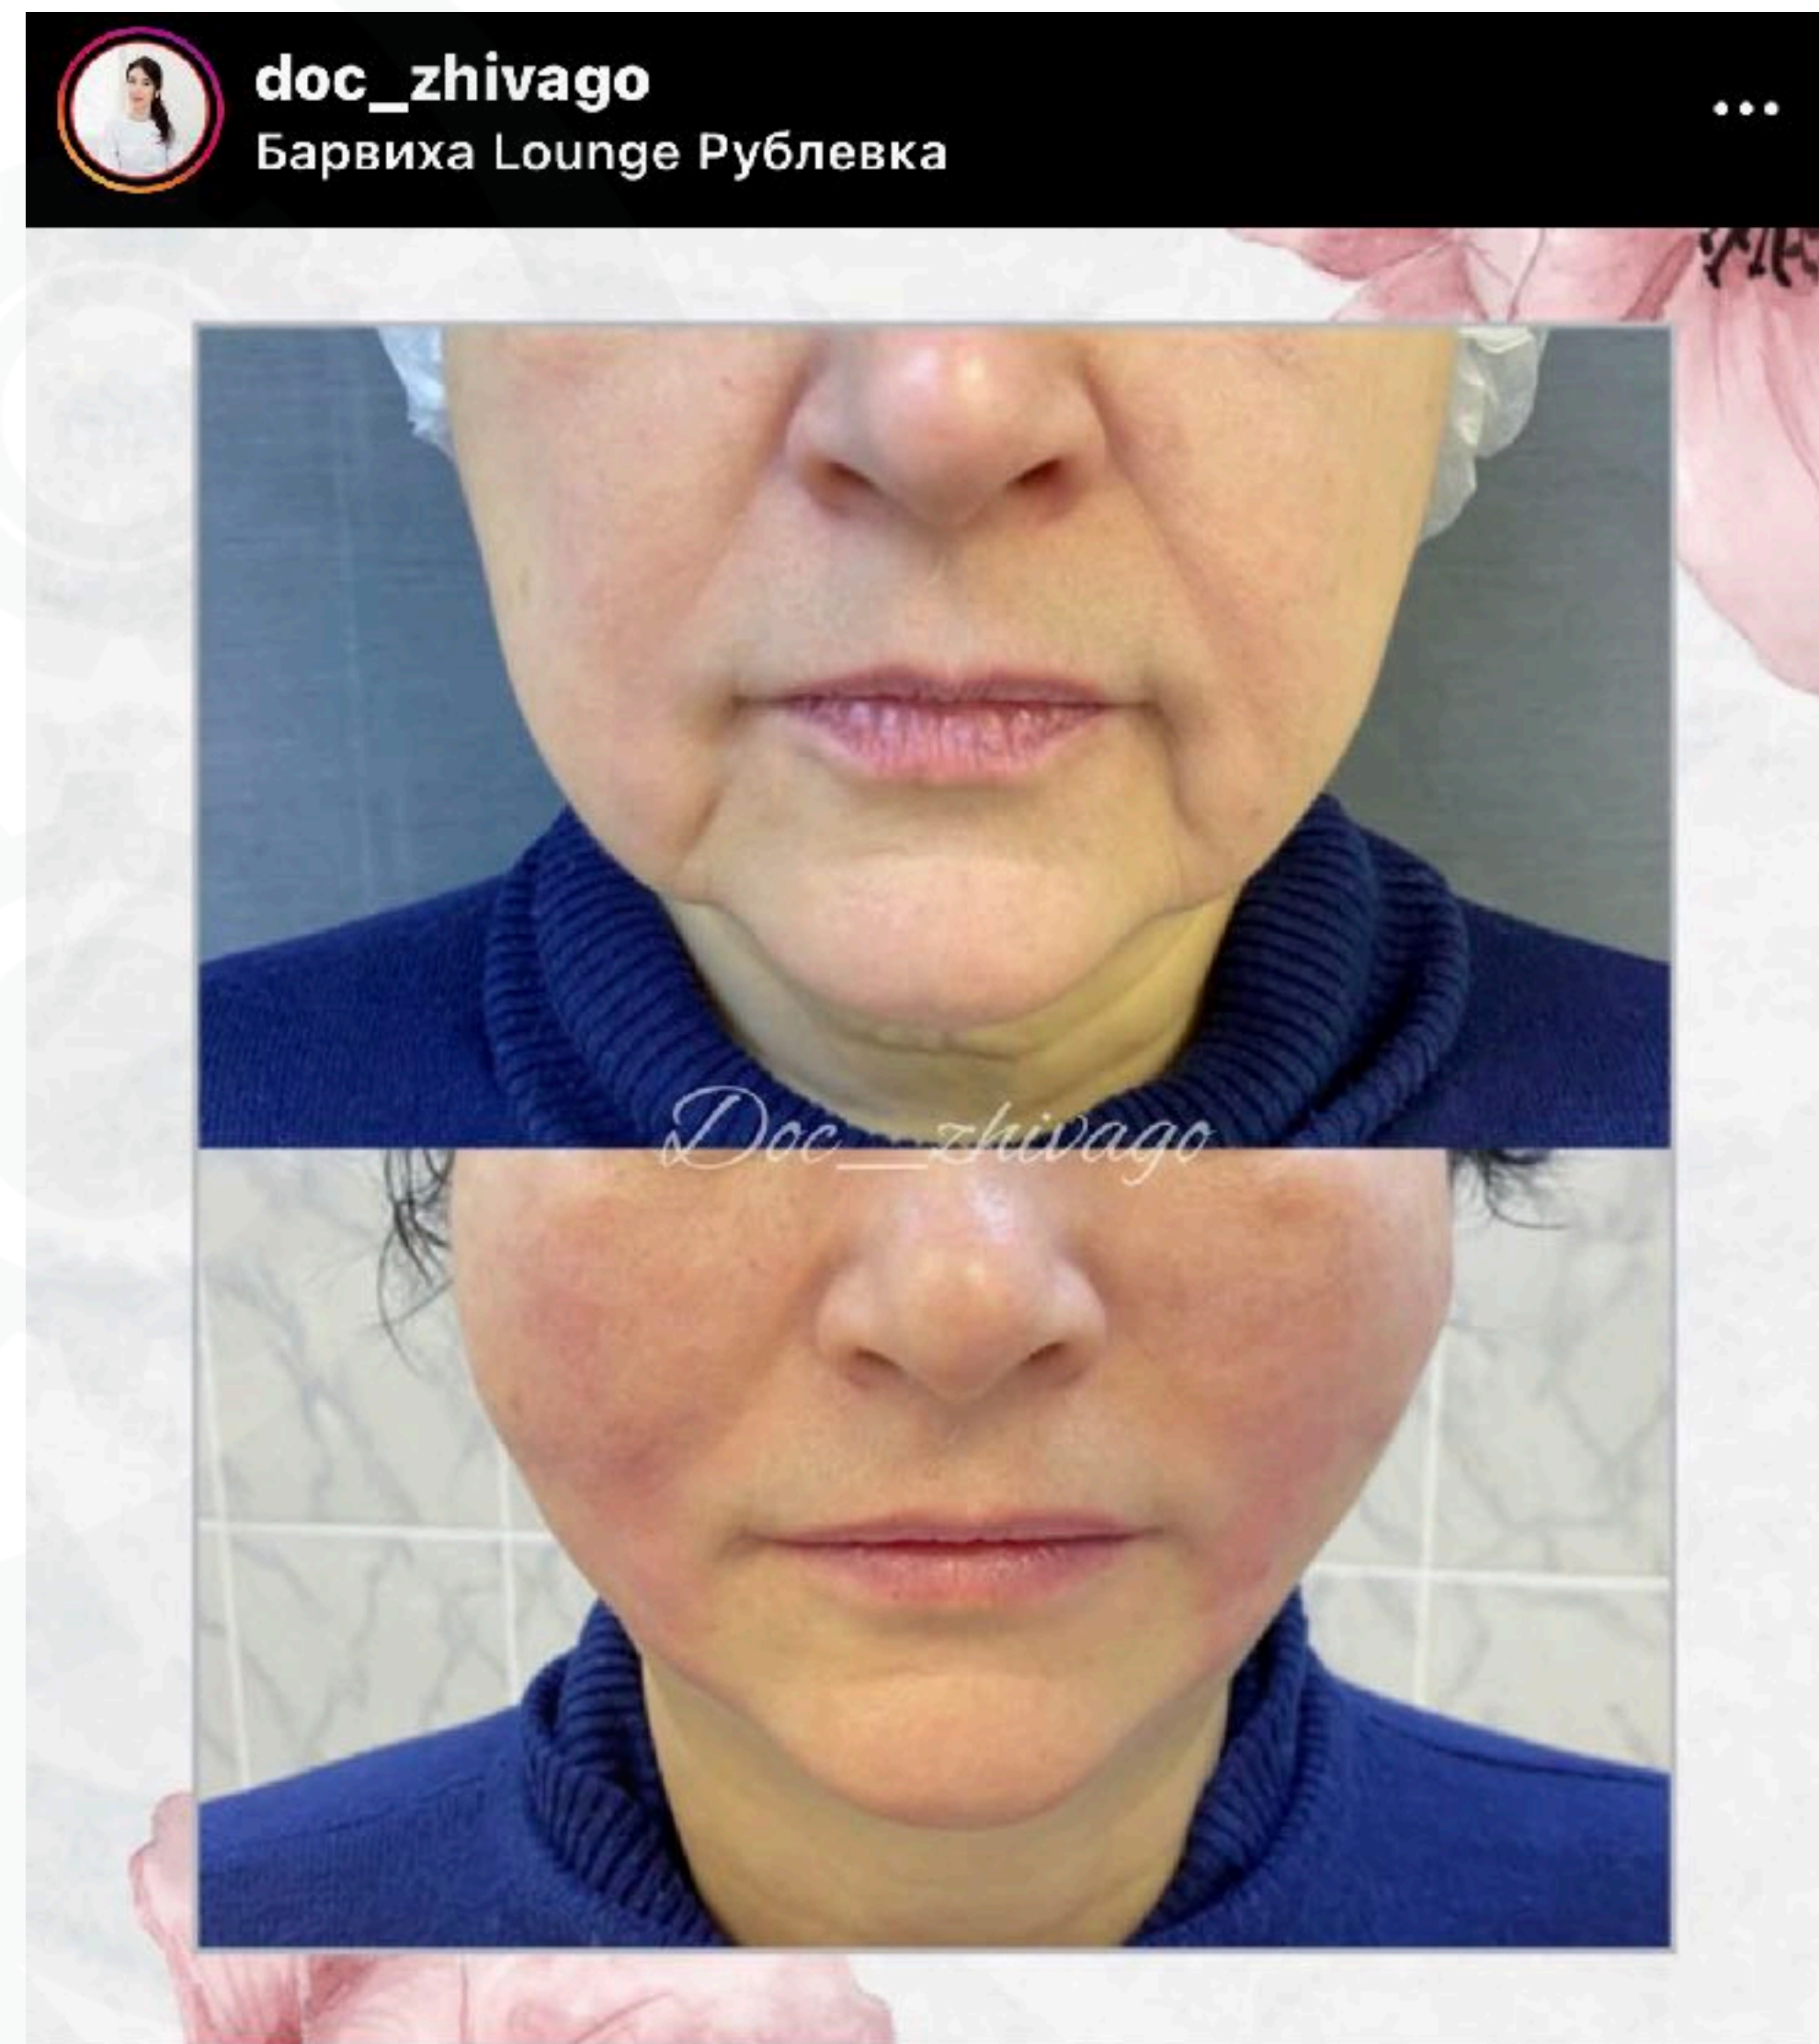

Результаты

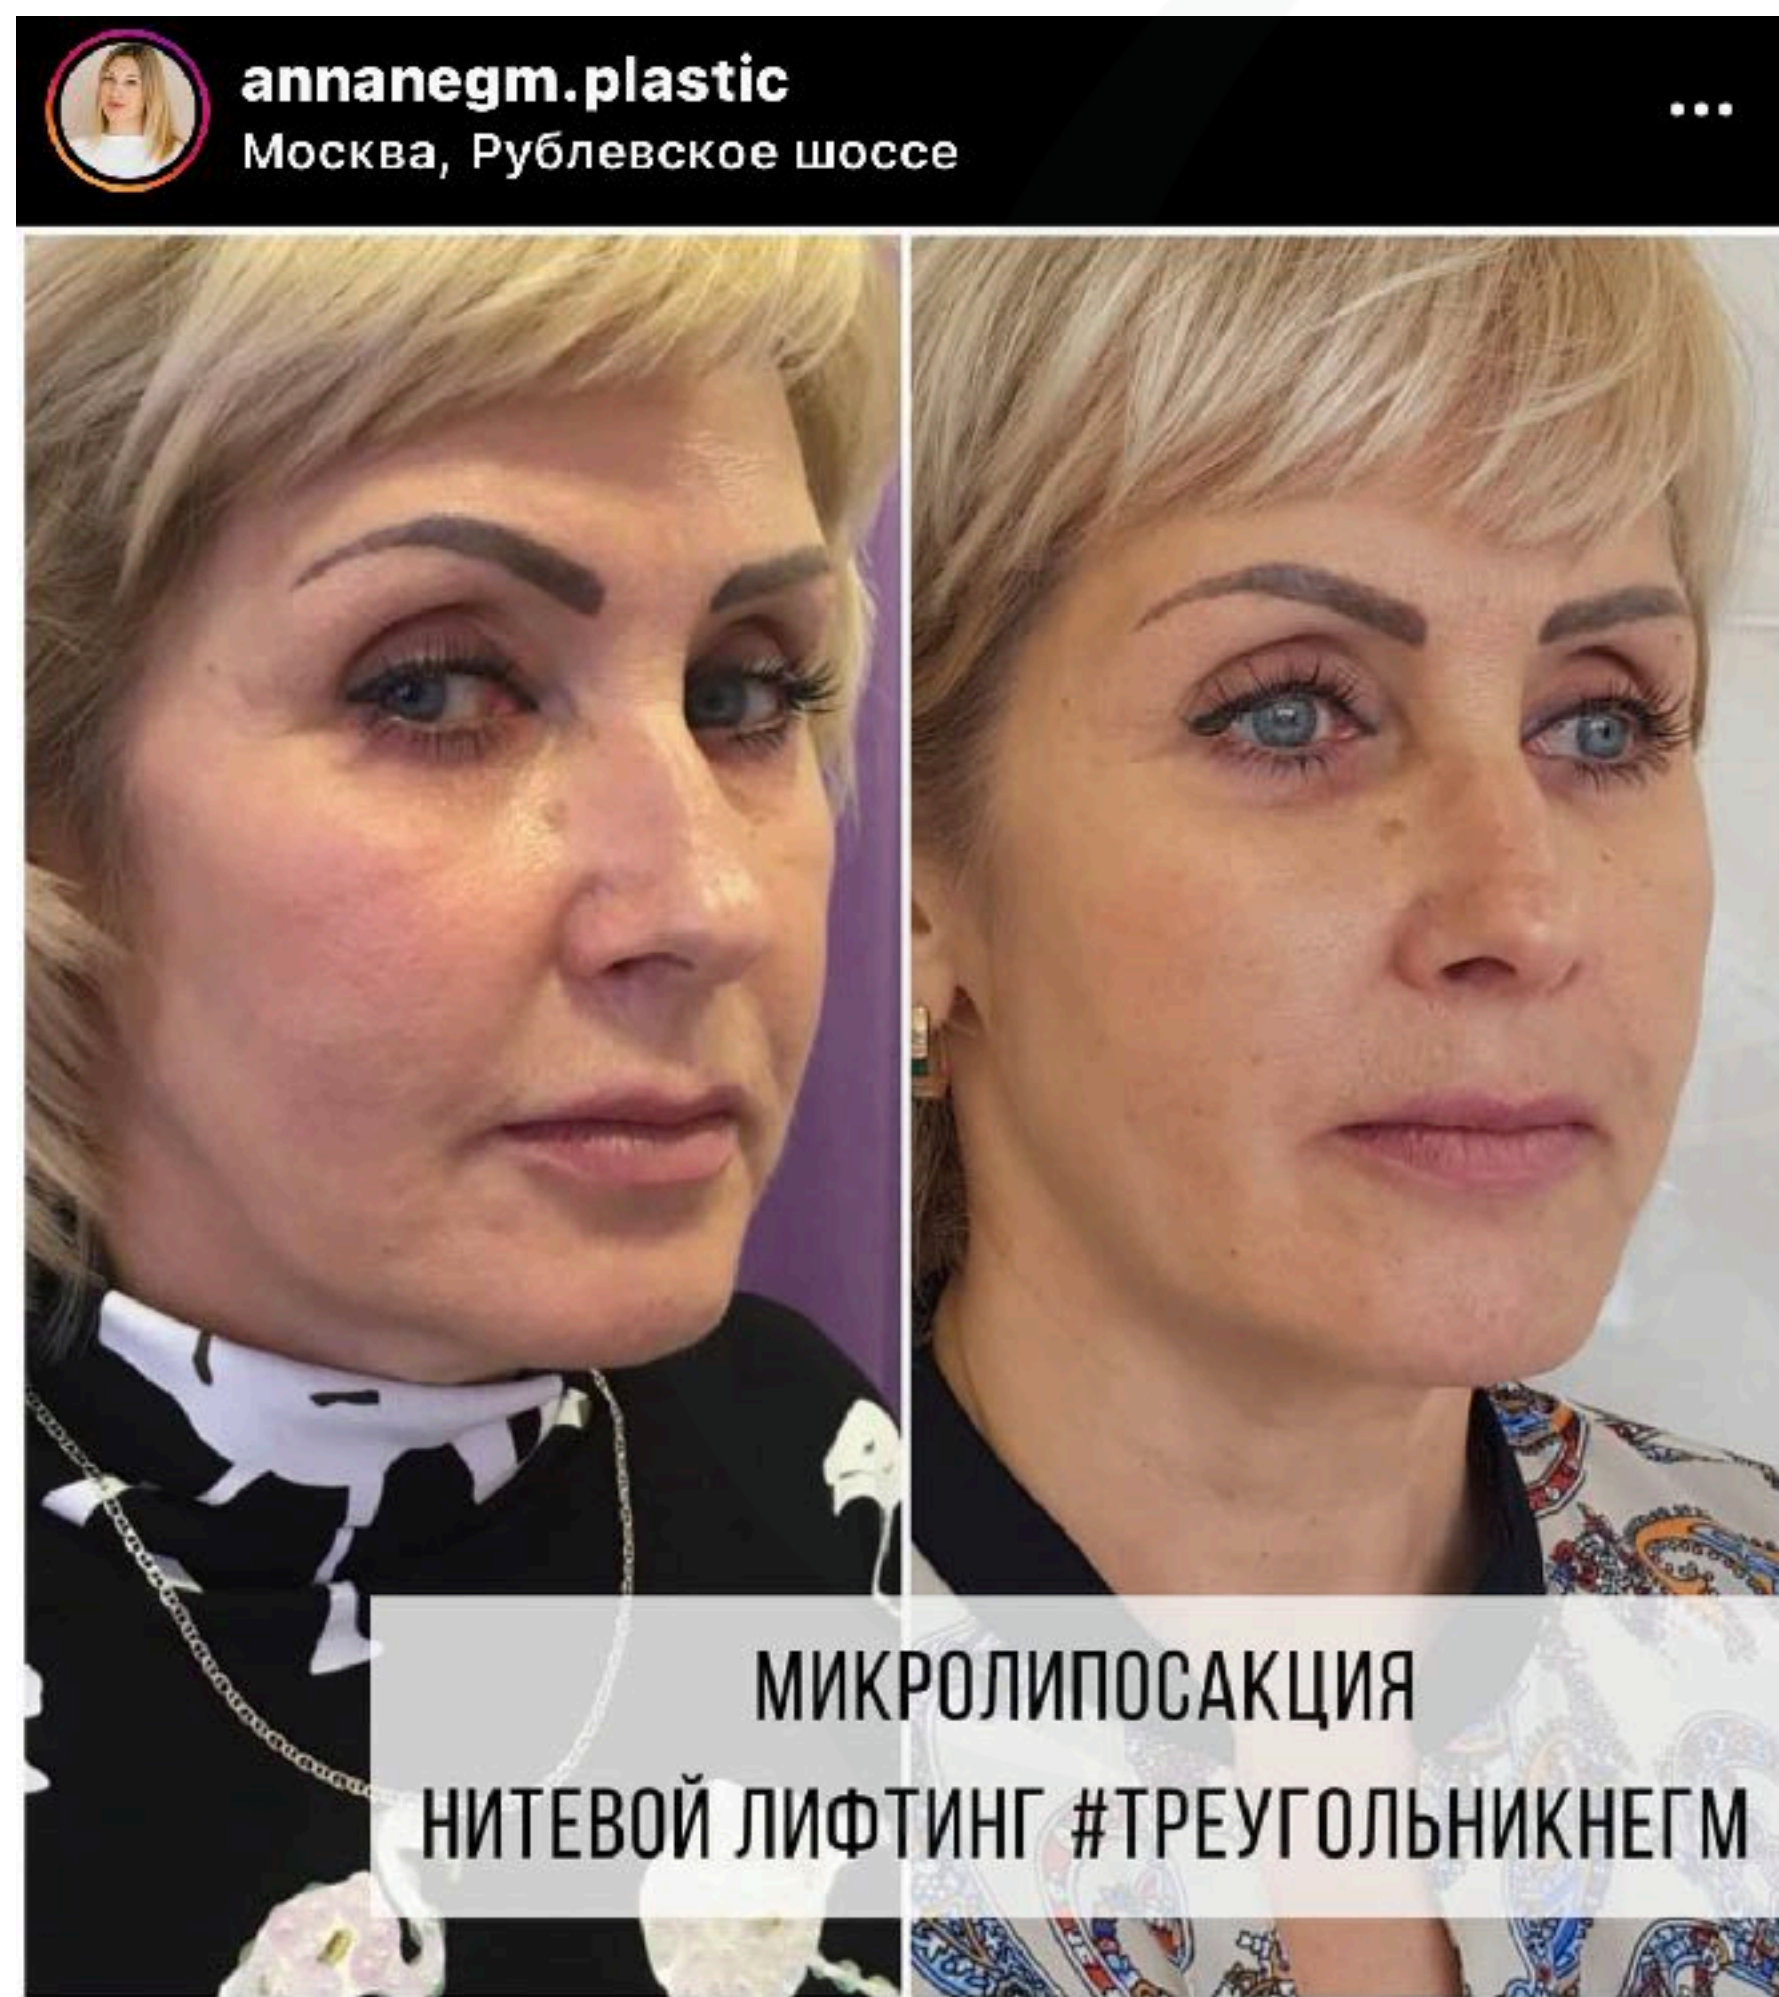

Результаты




Результаты






Наши Instagram

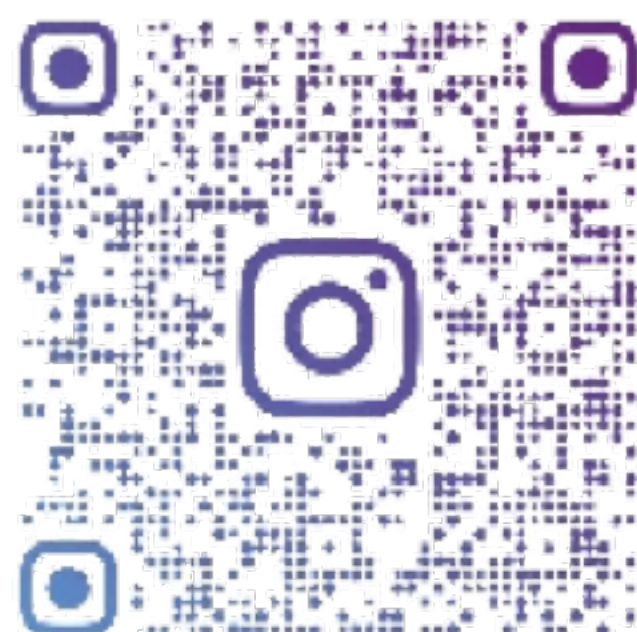

BEAUTY.SOLUTIONS.LLC

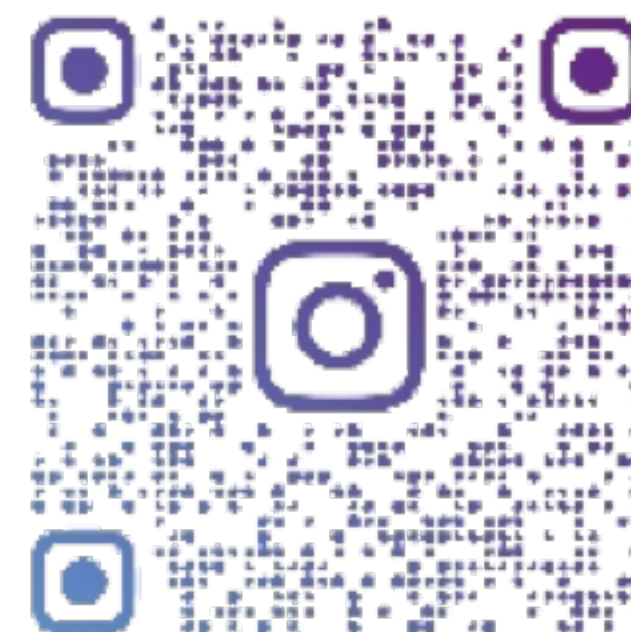

MINTLIFT.RUSSIA



Россия, 117437, г.Москва, ул.Профсоюзная, 108, эт.3, пом.1, офис 15А

+79265983569





Спасибо за внимание!



Лекцию читала:

**Канжа Екатерина
Анатольевна**

Врач высшей категории, специалист по Anti Age медицине и не хирургическим методам омоложения, член национального альянса дерматологов и косметологов, сертифицированный тренер по инъекционным методикам. Сертифицированный тренер по нитевому лифтингу Hans Biomed. Эксперт кадавер-курса «Элитариум» Санкт Петербург . Врач - косметолог . Специалист по anti age медицине Международный спикер конгрессов.

Медицинский директор компании Beauty Solutions